



# Manual of Methods

MD 100 • MD 110 • MD 200

Alkalinity-m | Chlorine | Copper | Cyanuric Acid | Iron | pH

**(EN) Manual of Methods**

Page 4

**(ES) Manual de Métodos**

Página 112

**(IT) Manuale dei Metodi**

Pagina 220

**(NL) Handboek Methoden**

Zijde 328

**(DE) Methodenhandbuch**

Seite 58

**(FR) Méthodes Manuel**




Page 166

**(PT) Métodos Manual**

Página 274

**(ZH) 方法手册**

Page 382





KS4.3 T / 20

**Method name**

**Method number**

**Bar code for the detection of the methods**

**Measuring range**

$K_{S4.3} T$   
0.1 - 4 mmol/l  $K_{S4.3}$

**Chemical Method**

**Instrument specific information**

The test can be performed on the following devices. In addition, the required cuvette and the absorption range of the photometer are indicated.

Instrument Type	Cuvette	$\lambda$	Measuring Range
MD 200, MD 600, MD 610, MD MultiDirect, PM 620, PM 630	$\varnothing$ 24 mm	610 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	$\varnothing$ 24 mm	615 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$

**Display in the MD  
100 / MD 110 /  
MD 200**

**Material**

Required material (partly optional):

Reagents	Packaging Unit	Part Number
Alka-M-Photometer	Tablet / 100	513210BT
Alka-M-Photometer	Tablet / 250	513211BT

**Application List**

- Waste Water Treatment
- Drinking Water Treatment
- Raw Water Treatment

**Notes**

1. The terms Alkalinity-m, m-Value, total alkalinity and Acid demand to  $K_{S4.3}$  are identical.
2. For accurate results, exactly 10 ml of water sample must be used for the test.

**Language codes ISO 639-1**

**Revision status**

EN Handbook of Methods 01/20


**Performing test procedure****Implementation of the provision Acid capacity  $K_{S4.3}$  with Tablet**

Select the method on the device

For this method, no ZERO measurements are to be carried out with the following devices: XD 7000, XD 7500



Fill 24 mm vial with **10 ml** sample.  
Close vial(s).





Place **sample vial** in the sample chamber. • Pay attention to the positioning.

• • •



Dissolve tablet(s) by inverting.  
The result in Acid Capacity  $K_{S4.3}$  appears on the display.



Press the **TEST (XD: START)** button.



Alkalinity-m T

M30

5 - 200 mg/L CaCO<sub>3</sub>

tA

Acid / Indicator

EN

## Material

Required material (partly optional):

Reagents	Packaging Unit	Part Number
Alka-M-Photometer	Tablet / 100	513210BT
Alka-M-Photometer	Tablet / 250	513211BT

## Notes


1. The terms Alkalinity-m, m-Value, total alkalinity and Acid demand to K<sub>S4,3</sub> are identical.
2. For accurate results, exactly 10 ml of water sample must be used for the test.

## Determination of Alkalinity, total = Alkalinity-m = m-Value with Tablet


Select the method on the device.




Fill 24 mm vial with **10 mL sample**.




Close vial(s).




Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.




Press the **ZERO** button.




Remove the vial from the sample chamber.



Add **ALKA-M-PHOTOMETER tablet**.



Crush tablet(s) by rotating slightly.




Close vial(s).


EN




EN



Dissolve tablet(s) by inverting.




Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.



Press the **TEST (XD: START)**button.

The result in Alkalinity-m appears on the display.



## Analyses

The following table identifies the output values can be converted into other citation forms.

Unit	Cite form	Scale Factor
mg/l	CaCO <sub>3</sub>	1
	°dH	0.056
	°eH	0.07
	°fH	0.1
	°aH	0.058
	K <sub>S4.3</sub>	0.02

EN

## Chemical Method

Acid / Indicator

## Appendix

### Derived from

EN ISO 9963-1

**Chlorine T****M100****0.01 - 6.0 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL6****DPD**

EN

## Material

Required material (partly optional):

Reagents	Packaging Unit	Part Number
DPD No.1	Tablet / 100	511050BT
DPD No. 1	Tablet / 250	511051BT
DPD No. 1	Tablet / 500	511052BT
DPD No. 3	Tablet / 100	511080BT
DPD No. 3	Tablet / 250	511081BT
DPD No. 3	Tablet / 500	511082BT
DPD No. 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 100	515740BT
DPD No. 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 250	515741BT
DPD No. 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 500	515742BT
DPD No. 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 100	515730BT
DPD No. 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 250	515731BT
DPD No. 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 500	515732BT
DPD No. 4	Tablet / 100	511220BT
DPD No. 4	Tablet / 250	511221BT
DPD No. 4	Tablet / 500	511222BT
DPD No. 3 Evo	Tablet / 100	511420BT
DPD No. 3 Evo	Tablet / 250	511421BT
DPD No. 3 Evo	Tablet / 500	511422BT
DPD No. 4 Evo	Tablet / 100	511970BT
DPD No. 4 Evo	Tablet / 250	511971BT
DPD No. 4 Evo	Tablet / 500	511972BT

## Available Standards

Title	Packaging Unit	Part Number
ValidCheck Chlorine 1,5 mg/l	1 pc.	48105510



## Sampling

1. When preparing the sample, chlorine outgassing, e.g. through the pipette or shaking, must be avoided.
2. The analysis must take place immediately after taking the sample.

## Preparation

1. Cleaning of vials:  
As many household cleaners (e.g. dishwasher detergent) contain reducing substances, this can lead to lower results with the determination of chlorine. To avoid measurement errors, the glassware used should be free of chlorine consumption. To achieve this, all glassware should be placed in a sodium hypochlorite solution (0.1 g/L) for one hour and then rinsed thoroughly with deionised water.
2. For individual testing of free and total chlorine, the use of different sets of glassware is recommended (EN ISO 7393-2, 5.3)
3. The DPD colour development is carried out at a pH value of 6.2 to 6.5. The reagents therefore contain a buffer for the pH adjustment. Strong alkaline or acidic water samples must therefore be adjusted between pH 6 and pH 7 before the analysis (use 0.5 mol/L sulphuric acid or 1 mol/L sodium hydroxide).

EN

## Notes

1. Evo tablets can be used as an alternative to the corresponding standard tablet (e.g. DPD No.3 Evo instead of DPD No.3).




## Determination of free chlorine with tablet

Select the method on the device.


EN




Fill 24 mm vial with **10 mL** sample.



Close vial(s).




Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.




**Zero**


Press the **ZERO** button.




Remove the vial from the sample chamber.



Empty vial except for a few drops.





Add **DPD No. 1 tablet**.




Crush tablet(s) by rotating slightly.




Fill up vial with **sample** to the **10 mL** mark.



Close vial(s).



Dissolve tablet(s) by inverting.



Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.

EN

## Test

Press the **TEST** (XD:  
**START**)button.


The result in mg/L free chlorine appears on the display.

### Determination of total Chlorine with tablet


Select the method on the device.



Fill 24 mm vial with **10 mL sample**.



Close vial(s).



Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.




# Zero

EN


Press the **ZERO** button.

Remove the vial from the sample chamber.


Empty vial except for a few drops.



Add **DPD No. 1 tablet**.



Add **DPD No. 3 tablet**.




As an alternative to DPD No. 1 and No. 3 tablets, a DPD No. 4 tablet can be added.




Ø 24 mm



Crush tablet(s) by rotating slightly.




Fill up vial with **sample** to the **10 mL mark**.




Close vial(s).




Dissolve tablet(s) by inverting.



Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.



Press the **TEST (XD: START)**button.



Wait for **2 minute(s)** reaction time.

Once the reaction period is finished, the measurement takes place automatically. The result in mg/L total Chlorine appears on the display.



## Chemical Method

DPD

## Appendix

EN

### Interferences

#### Persistent Interferences

- All oxidising agents in the samples react like chlorine, which leads to higher results.

#### Removable Interferences

- Interference from copper and iron (III) are eliminated by the addition of EDTA.
- The use of reagent tablets in samples with high calcium content\* and/or high conductivity\* can lead to turbidity of the sample and therefore incorrect measurements. In this case, the alternative reagent tablet DPD No.1 High Calcium and reagent tablet DPD No.3 High Calcium should be used.  
\*it is not possible to give exact values, because the development of turbidity depends on the composition and nature of the sample.
- Concentrations above 10 mg/L chlorine, in the event of using fluid reagents, can lead to results within the measuring range of up to 0 mg/L. In the event of a high concentration of chlorine, the sample must be diluted with chlorine-free water. 10 mL of the diluted sample should be mixed with the reagent and the measurement taken again (plausibility test).

Interference	from / [mg/L]
CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	0.01
MnO <sub>2</sub>	0.01

## Method Validation

Limit of Detection	0.02 mg/L
Limit of Quantification	0.06 mg/L
End of Measuring Range	6 mg/L
Sensitivity	2.05 mg/L / Abs
Confidence Intervall	0.04 mg/L
Standard Deviation	0.019 mg/L
Variation Coefficient	0.87 %

## Conformity

EN ISO 7393-2



<sup>a)</sup> determination of free, combined and total | <sup>b)</sup> alternative reagent, used instead of DPD No.1/No.3 in case of turbidity in the water sample caused by high concentration of calcium and/or high conductivity

EN

**Chlorine L****M101****0.02 - 4.0 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL6****DPD**

EN

## Material

Required material (partly optional):

Reagents	Packaging Unit	Part Number
DPD 1 Buffer Solution, Blue Bottle	15 mL	471010
DPD 1 Buffer Solution	100 mL	471011
DPD 1 Buffer Solution	1 pc.	471016
DPD 1 Reagent Solution, Green Bottle	15 mL	471020
DPD 1 Reagent Solution	100 mL	471021
DPD 1 Reagent Solution	1 pc.	471026
DPD 3 Solution, Red Bottle	15 mL	471030
DPD 3 Solution	100 mL	471031
DPD 3 Solution	1 pc.	471036
DPD Reagent Set	1 pc.	471056

## Available Standards

Title	Packaging Unit	Part Number
ValidCheck Chlorine 1,5 mg/l	1 pc.	48105510

## Sampling

- When preparing the sample, Chlorine outgassing, e.g. through the pipette or shaking, must be avoided.
- The analysis must take place immediately after taking the sample.



## Preparation

1. Cleaning of vials:  
As many household cleaners (e.g. dishwasher detergent) contain reducing substances, this can lead to lower results with the determination of Chlorine. To avoid measurement errors, the glassware used should be free of chlorine consumption. To achieve this, all glassware should be placed in a sodium hypochlorite solution (0.1 g/L) for one hour and then rinsed thoroughly with deionised water.
2. For individual testing of free and total Chlorine, the use of different sets of glassware is recommended (EN ISO 7393-2, 5.3)
3. The DPD colour development is carried out at a pH value of 6.2 to 6.5. The reagents therefore contain a buffer for the pH adjustment. Strong alkaline or acidic water samples must therefore be adjusted between pH 6 and pH 7 before the analysis (use 0.5 mol/l Sulphuric acid or 1 mol/l Sodium hydroxide).

EN

## Notes

1. After use, ensure the cuvettes are once again closed with the respective same-coloured screw caps.
2. Reagent sets are to be stored in the cool at +6 °C to +10 °C.




## Determination of free chlorine with liquid reagent

Select the method on the device.


EN



Fill 24 mm vial with **10 mL** sample.




Close vial(s).




Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.




Press the **ZERO** button.




Remove the vial from the sample chamber.




Empty vial.



Hold cuvettes vertically and add equal drops by pressing slowly.




Add **6 drops DPD 1 Buffer Solution** to the **sample vial**.




Add **2 drops DPD 1 Reagent Solution** to the **sample vial**.



Fill up vial with **sample** to the **10 mL** mark.




Close vial(s).




Invert several times to mix the contents.

EN



Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.



Press the **TEST (XD: START)**button.


The result in mg/L free chlorine appears on the display.

## Determination of totale Chlorine with liquid reagent


Select the method on the device.




Fill 24 mm vial with **10 mL sample**.



Close vial(s).



Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.



# Zero

EN

Press the **ZERO** button.

Remove the vial from the sample chamber.

Empty vial.



Hold cuvettes vertically and add equal drops by pressing slowly.




Add **6 drops DPD 1 Buffer Solution** to the **sample vial**.



Add **2 drops DPD 1 Reagent Solution** to the **sample vial**.





Add **3 drops DPD 3 Solution** to the **sample vial**.




Fill up vial with **sample** to the **10 mL mark**.




Close vial(s).




Invert several times to mix the contents.



Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.



Press the **TEST (XD: START)**button.



Wait for **2 minute(s)** reaction time.

Once the reaction period is finished, the measurement takes place automatically. The result in mg/L total Chlorine appears on the display.



## Chemical Method

DPD

## Appendix

EN

### Interferences

#### Persistent Interferences

- All oxidising agents in the samples react like chlorine, which leads to higher results.

#### Removable Interferences

- Interference from Copper and Iron (III) are eliminated by the addition of EDTA.
- Concentrations above 4 mg/L Chlorine, in the event of using fluid reagents, can lead to results within the measuring range of up to 0 mg/L. In this case, the sample must be diluted with chlorine-free water. 10 ml of the diluted sample should be mixed with the reagent and the measurement taken again (plausibility test).

Interference	from / [mg/L]
CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	0,01
MnO <sub>2</sub>	0,01

### Conformity

EN ISO 7393-2

<sup>a)</sup> determination of free, combined and total



**Chlorine HR T****M103****0.1 - 10 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL10****DPD**

EN


## Material

Required material (partly optional):

Reagents	Packaging Unit	Part Number
DPD No. 1 HR	Tablet / 100	511500BT
DPD No. 1 HR	Tablet / 250	511501BT
DPD No. 1 HR	Tablet / 500	511502BT
DPD No. 3 HR	Tablet / 100	511590BT
DPD No. 3 HR	Tablet / 250	511591BT
DPD No. 3 HR	Tablet / 500	511592BT
Set DPD No. 1 HR/No. 3 HR 100 Pcs. #	100 each	517791BT
Set DPD No. 1 HR/No. 3 HR 250 Pcs. #	250 each	517792BT
DPD No. 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 100	515740BT
DPD No. 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 250	515741BT
DPD No. 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 500	515742BT
DPD No. 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 100	515730BT
DPD No. 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 250	515731BT
DPD No. 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 500	515732BT
DPD No. 3 HR Evo	Tablet / 100	511920BT
DPD No. 3 HREvo	Tablet / 250	511921BT
DPD No. 3 HREvo	Tablet / 500	511922BT

## Sampling

- When preparing the sample, chlorine outgassing, e.g. through the pipette or shaking, must be avoided.
- The analysis must take place immediately after taking the sample.



## Preparation

1. Cleaning of vials:  
As many household cleaners (e.g. dishwasher detergent) contain reducing substances, this can lead to lower results with the determination of chlorine. To avoid measurement errors, the glassware used should be free of chlorine consumption. To achieve this, all glassware should be placed in a sodium hypochlorite solution (0.1 g/L) for one hour and then rinsed thoroughly with deionised water.
2. For individual testing of free and total chlorine, the use of different sets of glassware is recommended (EN ISO 7393-2, 5.3)
3. The DPD colour development is carried out at a pH value of 6.2 to 6.5. The reagents therefore contain a buffer for the pH adjustment. Strong alkaline or acidic water samples must therefore be adjusted between pH 6 and pH 7 before the analysis (use 0.5 mol/L sulphuric acid or 1 mol/L sodium hydroxide).

EN

## Notes

1. Evo tablets can be used as an alternative to the corresponding standard tablet (e.g. DPD No.3 Evo instead of DPD No.3).




## Determination of free chlorine HR with tablet

Select the method on the device.


EN




Fill 24 mm vial with **10 mL** sample.




Close vial(s).




Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.




Press the **ZERO** button.




Remove the vial from the sample chamber.



Empty vial except for a few drops.





Add **DPD No. 1 HR tablet**.




Crush tablet(s) by rotating slightly.




Fill up vial with **sample** to the **10 mL** mark.



Close vial(s).



Dissolve tablet(s) by inverting.



Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.

EN

## Test

Press the **TEST** (XD:  
**START**)button.


The result in mg/L free chlorine appears on the display.

### Determination of total Chlorine HR with tablet


Select the method on the device.



Fill 24 mm vial with **10 mL sample**.



Close vial(s).



Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.




# Zero

EN


Press the **ZERO** button.

Remove the vial from the sample chamber.

Empty vial except for a few drops.




Add **DPD No. 1 HR tablet**.




Add **DPD No. 3 HR tablet**.




Crush tablet(s) by rotating slightly.





Fill up vial with **sample** to the **10 mL mark**.



Close vial(s).




Dissolve tablet(s) by inverting.



Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.

# Test

Press the **TEST (XD: START)**button.



Wait for **2 minute(s)** reaction time.

Once the reaction period is finished, the measurement takes place automatically.

The result in mg/L total Chlorine appears on the display.

EN



## Chemical Method

DPD

## Appendix

EN

### Interferences

#### Persistent Interferences

- All oxidising agents in the samples react like chlorine, which leads to higher results.

#### Removable Interferences

- Interference from Copper and Iron (III) are eliminated by the addition of EDTA.
- The use of reagent tablets in samples with high Calcium content\* and/or high conductivity\* can lead to turbidity of the sample and therefore incorrect measurements. In this case, the alternative reagent tablet DPD No. 1 High Calcium and reagent tablet DPD No. 3 High Calcium should be used.

\*it is not possible to give exact values, because the development of turbidity depends on the composition and nature of the sample.

### Conformity

EN ISO 7393-2

<sup>a)</sup> determination of free, combined and total | <sup>b)</sup> alternative reagent, used instead of DPD No.1/No.3 in case of turbidity in the water sample caused by high concentration of calcium and/or high conductivity | <sup>c)</sup> including stirring rod, 10 cm



**Copper T****M150****0.05 - 5 mg/L Cu<sup>a)</sup>****Cu****Biquinoline**

EN

## Material

Required material (partly optional):

Reagents	Packaging Unit	Part Number
Copper No. 1	Tablet / 100	513550BT
Copper No. 1	Tablet / 250	513551BT
Copper No. 2	Tablet / 100	513560BT
Copper No. 2	Tablet / 250	513561BT
Set Copper No. 1/No. 2 100 Pc. <sup>#</sup>	100 each	517691BT
Set Copper No. 1/No. 2 250 Pc. <sup>#</sup>	250 each	517692BT

## Preparation

1. Strong alkaline or acidic water samples must be adjusted to pH 4 to 6 before analysis.


## Determination of Copper, free with tablet

Select the method on the device.


In addition, choose the test: free




Fill 24 mm vial with **10 mL sample**.




Close vial(s).




Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.




Press the **ZERO** button.




Remove the vial from the sample chamber.



Add **COPPER No. 1 tablet**.




Crush tablet(s) by rotating slightly.




Close vial(s).

EN




EN

Dissolve tablet(s) by inverting.



# Test

Press the **TEST (XD: START)**button.



Wait for **2 minute(s)** reaction time.

Once the reaction period is finished, the measurement takes place automatically.

The result in mg/L free Copper appears on the display.


## Determination of Copper, total with tablet

Select the method on the device.


In addition, choose the test: total



Fill 24 mm vial with **10 mL sample**.



Close vial(s).




Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.

# Zero


Press the **ZERO** button.

Remove the vial from the sample chamber.


EN




Add **COPPER No. 1 tablet**.




Crush tablet(s) by rotating slightly and dissolve.



Add **COPPER No. 2 tablet**.



Crush tablet(s) by rotating slightly.




Close vial(s).



Dissolve tablet(s) by inverting.




EN



Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.

# Test

Press the **TEST (XD: START)**button.



Wait for **2 minute(s)** reaction time.

Once the reaction period is finished, the measurement takes place automatically.

The result in mg/L total Copper appears on the display.



## Chemical Method

Biquinoline

## Appendix

### Interferences

EN

#### Persistent Interferences

1. Cyanide CN<sup>-</sup> and Silver Ag<sup>+</sup> interfere with the test result.

### Method Validation

<b>Limit of Detection</b>	0.05 mg/L
<b>Limit of Quantification</b>	0.15 mg/L
<b>End of Measuring Range</b>	5 mg/L
<b>Sensitivity</b>	3.8 mg/L / Abs
<b>Confidence Intervall</b>	0.026 mg/L
<b>Standard Deviation</b>	0.011 mg/L
<b>Variation Coefficient</b>	0.42 %

### Bibliography

Photometrische Analyse, Lange/Vedjelek, Verlag Chemie 1980

<sup>a)</sup> determination of free, combined and total | \* including stirring rod, 10 cm

**CyA T****M160****10 - 160 mg/L CyA****CyA****Melamine**

EN

**Material**

Required material (partly optional):


Reagents	Packaging Unit	Part Number
CyA-Test	Tablet / 100	511370BT
CyA-Test	Tablet / 250	511371BT
Deionised Water	100 mL	461275
Deionised Water	250 mL	457022

**Notes**


1. Cyanuric acid causes an extremely fine distributed turbidity with a milky appearance. Individual particles are not attributable to the presence of cyanuric acid.

## Determination of Cyanuric Acid Test with Tablet


Select the method on the device.




Fill 24 mm vial with **5 mL deionised water**.




Put **5 mL sample** in the vial.




Close vial(s).




Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.




Press the **ZERO** button.




Remove the vial from the sample chamber.




Add **CyA-Test tablet**.



Crush tablet(s) by rotating slightly.



Close vial(s).



EN

Invert several times to mix the contents (for at least 60 s until the tablet is completely dissolved).



Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.

## Test

Press the **TEST (XD: START)**button.

The result in mg/L Cyanuric Acid appears on the display.



## Chemical Method

Melamine

## Interferences

### Persistent Interferences

1. Undissolved particles may lead to higher results. Therefore, it is important to dissolve the Tablet completely.

EN

**Iron T****M220****0.02 - 1 mg/L Fe****FE****Ferrozine / Thioglycolate**

EN

## Material

Required material (partly optional):

Reagents	Packaging Unit	Part Number
Iron II LR ( $\text{Fe}^{2+}$ )	Tablet / 100	515420BT
Iron II LR ( $\text{Fe}^{2+}$ )	Tablet / 250	515421BT
Iron LR ( $\text{Fe}^{2+}$ und $\text{Fe}^{3+}$ )	Tablet / 100	515370BT
Iron LR ( $\text{Fe}^{2+}$ und $\text{Fe}^{3+}$ )	Tablet / 250	515371BT


## Preparation

- Water that has been treated with organic compounds such as corrosion inhibitors, must be oxidised where necessary to break down the iron complex. 1 ml of concentrated Sulphuric acid ( $\geq 95\%$ ) and 1 ml concentrated Nitric acid ( $\geq 65\%$ ) is therefore added to 100 ml water sample and boiled down to approximately half the volume. After cooling down, the digestion procedure is continued.


## Notes

- This method is for the determination of total dissolved  $\text{Fe}^{2+}$  and  $\text{Fe}^{3+}$ .
- For the determination of  $\text{Fe}^{2+}$ , the IRON (II) LR Tablet, instead of the IRON LR Tablet is used.


## Digestion




Fill a suitable sample vessel with **100 mL sample**.




Add **1 mL concentrated sulfuric acid ( $\geq 95\%$ )**.




The sample is to be **heated for 10 minutes**, or for as long as it takes for everything to be completely dissolved.



Allow the sample to cool to room temperature.



Adjust **pH-value** of the sample with **ammonia solution (10-25 %)** to 3-5.



Fill the sample with **deionised water to 100 mL**.

This sample is used for the analysis of total solved and dissolved Iron.


## Determination of Iron (II,III), dissolved with Tablet

Select the method on the device.


For testing of **dissolved and undissolved Iron**, carry out the described **digestion**.



Fill **24 mm vial with 10 mL sample**.



**Close vial(s).**



Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.




# Zero


EN

Press the **ZERO** button.


Remove the vial from the sample chamber.




Add **IRON LR** tablet.




Crush tablet(s) by rotating slightly.



Close vial(s).





Dissolve tablet(s) by inverting.



Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.

# Test

Press the **TEST** (XD: **START**)button.



Wait for **5 minute(s)**  
**reaction time.**

Once the reaction period is finished, the measurement takes place automatically.  
The result in mg/L Iron appears on the display.

EN



## Chemical Method

Ferrozine / Thioglycolate

EN

## Appendix

### Interferences

#### Removeable Interferences

1. The presence of copper increases the test result by 10 %. At a concentration of 10 mg/L copper in the sample, the measurement result is increased by 1 mg/L iron.  
The interference can be eliminated by the addition of thiourea

## Method Validation

Limit of Detection	0.01 mg/L
Limit of Quantification	0.016 mg/L
End of Measuring Range	1 mg/L
Sensitivity	0.92 mg/L / Abs
Confidence Intervall	0.013 mg/L
Standard Deviation	0.005 mg/L
Variation Coefficient	1.23 %

### Bibliography

Photometrische Analyse, Lange/ Vjedelek, Verlag Chemie 1980, p. 102



**pH-value T****M330****6.5 - 8.4 pH****PH****Phenol Red**

EN

**Material**

Required material (partly optional):

Reagents	Packaging Unit	Part Number
Phenol Red Photometer	Tablet / 100	511770BT
Phenol Red Photometer	Tablet / 250	511771BT
Phenol Red Photometer	Tablet / 500	511772BT

**Notes**


1. For photometric determination of pH values only use PHENOL RED tablets in black printed foil pack and marked with PHOTOMETER.

## Determination of pH-value with Tablet


Select the method on the device.




Fill 24 mm vial with **10 mL** sample.




Close vial(s).




Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.




Press the **ZERO** button.




Remove the vial from the sample chamber.



Add **PHENOL RED PHOTOMETER tablet**.



Crush tablet(s) by rotating slightly.




Close vial(s).


EN




EN



Dissolve tablet(s) by inverting.




Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.



Press the **TEST (XD: START)**button.

The result in pH value appears on the display.



## Chemical Method

Phenol Red

## Appendix

### Interferences

EN

#### Persistent Interferences

- Water samples with little Carbonate hardness\* can lead to false pH values.  
\* $K_{S4,3} < 0.7 \text{ mmol/l} \leq \text{total alkalinity} < 35 \text{ mg/L CaCO}_3$ .

#### Removable Interferences

- pH values below 6.5 and above 8.4 can produce results outside the measuring range. A plausibility test (pH-meter) is recommended.
- Salt error  
For salt concentrations below 2 g/L, no significant error, is expected due to the salt concentration of the reagent tablet. For higher salt concentrations the measurement values have to be adjusted as follows:

Salt content per sample in g/L	30 (seawater)	60	120	180
Correction	-0.15 <sup>1)</sup>	-0.21 <sup>2)</sup>	-0.26 <sup>2)</sup>	-0.29 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> according to Kolthoff (1922)

<sup>2)</sup> according to Parson and Douglas (1926)

### Bibliography

Colorimetric Chemical Analytical Methods, 9th Edition, London

**pH value L****M331****6.5 - 8.4 pH****PH****Phenol Red**

EN

## Material

Required material (partly optional):

Reagents	Packaging Unit	Part Number
Phenol Red Solution	15 mL	471040
Phenol Red Solution	100 mL	471041
Phenol Red Solution in 6-pack	1 pc.	471046

## Preparation

1. Due to differing drop sizes results can show a discrepancy in accuracy by comparison with tablets.  
This can be minimised by using a pipette (0.18 ml equivalent to 6 drops).

## Notes


1. After use, ensure the cuvette is once again closed with the same-coloured screw caps.
2. Reagents are to be stored in the cool at +6 °C to +10 °C.

## Determination of pH-value with liquid reagent


Select the method on the device.




Fill 24 mm vial with **10 mL** sample.




Close vial(s).




Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.




Press the **ZERO** button.




Remove the vial from the sample chamber.



Hold cuvettes vertically and add equal drops by pressing slowly.



Add **6 drops PHENOL Red-Lösung** to the sample vial.




**6**


Close vial(s).




EN



Invert several times to mix the contents.




Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.



Press the **TEST (XD: START)**button.

The result in pH value appears on the display.



## Chemical Method

Phenol Red

## Appendix

### Interferences

EN

#### Removeable Interferences

1. Salt error Correction of test results (average values) for samples with salt contents of:

Salt content of the sample	Correction
30 g/L (seawater)	-0.15 <sup>1)</sup>
60 g/L	-0.21 <sup>2)</sup>
120 g/L	-0.26 <sup>2)</sup>
180 g/L	-0.29 <sup>2)</sup>
2. When testing chlorinated water the residual chlorine contents can influence the colour reaction of the liquid reagent. This can be avoided by adding a small crystal of Sodiumthiosulphate ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{ H}_2\text{O}$ ) to the sample solution before adding the PHENOL RED solution.

<sup>1)</sup> according to Kolthoff (1922)      <sup>2)</sup> according to Parson and Douglas (1926)

### Bibliography

Colorimetric Chemical Analytical Methods, 9th Edition, London

KS4.3 T / 20



**Methoden Name**

**Methodennummer**

**Barcode zur Methodenerkennung**

**Messbereich**

**K<sub>S4.3</sub> T**  
0,1 - 4 mmol/l K<sub>S4.3</sub>  
Säure / Indikator

**Chemische Methode**

**Instrumentspezifische Informationen**

Der Test kann auf den folgenden Geräten durchgeführt werden. Zusätzlich sind die benötigte Küvette und der Absorptionsbereich der Photometer angegeben.

Geräte	Küvette	$\lambda$	Messbereich
MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	ø 24 mm	610 nm	0,1 - 4 mmol/l K <sub>S4.3</sub>
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	615 nm	0,1 - 4 mmol/l K <sub>S4.3</sub>

**Material**

Benötigtes Material (zum Teil optional):

Reagenzien	Form/Menge	Bestell-Nr.
Alka-M-Photometer	Tablette / 100	513210BT
Alka-M-Photometer	Tablette / 250	513211BT

**Anwendungsbereich**

- Abwasserbehandlung
- Trinkwasseraufbereitung
- Rohwasserbehandlung

**Anmerkungen**

1. Die Begriffe Alkalität-m, m-Wert, Gesamtaalkalität und Säurekapazität K<sub>S4.3</sub> sind identisch.
2. Die exakte Einhaltung des Probenvolumens von 10 ml ist für die Genauigkeit des Analysenergebnisses entscheidend.

**Sprachkürzel nach ISO 639-1**

**Revisionsstand**

DE Methodenhandbuch 01/20



**Durchführung der Messung****Durchführung der Bestimmung Säurekapazität  $K_{S4.3}$  mit Tablette**

Die Methode im Gerät auswählen.

Für diese Methode muss bei folgenden Geräten keine ZERO-Messung durchgeführt werden: XD 7000, XD 7500

24-mm-Küvette mit 10 ml  
Probe füllen.

Küvette(n) verschließen.

Die Probenküvette in  
den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.Tablette(n) durch Um-  
schwenken lösen.Die Probenküvette in  
den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.**Test**Taste TEST (XD: START)  
drücken.In der Anzeige erscheint das Ergebnis als Säurekapazität  $K_{S4.3}$ .

**Alkalität-m T****M30****5 - 200 mg/L CaCO<sub>3</sub>****tA****Säure / Indikator**

DE

**Material**

Benötigtes Material (zum Teil optional):

Reagenzien	Form/Menge	Bestell-Nr.
Alka-M-Photometer	Tablette / 100	513210BT
Alka-M-Photometer	Tablette / 250	513211BT

**Anmerkungen**



1. Die Begriffe Alkalität-m, m-Wert, Gesamtalkalität und Säurekapazität K<sub>S4,3</sub> sind identisch.
2. Die exakte Einhaltung des Probevolumens von 10 ml ist für die Genauigkeit des Analysenergebnisses entscheidend.

## Durchführung der Bestimmung Alkalität, total= Alkaltät-m= m-Wert mit Tablette

Die Methode im Gerät auswählen.




24-mm-Küvette mit **10 mL** Küvette(n) verschließen.  
**Probe** füllen.




Die **Probenküvette** in den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.

DE


# Zero




Taste **ZERO** drücken.




Küvette aus dem Messschacht nehmen.



Eine **ALKA-M-PHOTOMETER** Tablette zugeben.




Tablette(n) unter leichter Drehung zerdrücken.




Küvette(n) verschließen.



DE



Tablette(n) durch  
Umschwenken lösen.




Die **Probenküvette** in  
den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.

# Test

Taste **TEST** (XD: **START**)  
drücken.

In der Anzeige erscheint das Ergebnis als Alkalität-m.



## Auswertung

Die folgende Tabelle gibt an wie die ausgegebenen Werte in andere Zitierformen umgewandelt werden können.

Einheit	Zitierform	Umrechnungsfaktor
mg/l	CaCO <sub>3</sub>	1
	°dH	0.056
	°eH	0.07
	°fH	0.1
	°aH	0.058
	K <sub>S4,3</sub>	0.02

DE

## Chemische Methode

Säure / Indikator

## Appendix

### Abgeleitet von

EN ISO 9963-1

**Chlor T****M100****0,01 - 6,0 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL6****DPD**

DE

**Material**

Benötigtes Material (zum Teil optional):

<b>Reagenzien</b>	<b>Form/Menge</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
DPD No.1	Tablette / 100	511050BT
DPD No. 1	Tablette / 250	511051BT
DPD No. 1	Tablette / 500	511052BT
DPD No. 3	Tablette / 100	511080BT
DPD No. 3	Tablette / 250	511081BT
DPD No. 3	Tablette / 500	511082BT
DPD No. 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablette / 100	515740BT
DPD No. 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablette / 250	515741BT
DPD No. 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablette / 500	515742BT
DPD No. 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablette / 100	515730BT
DPD No. 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablette / 250	515731BT
DPD No. 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablette / 500	515732BT
DPD No. 4	Tablette / 100	511220BT
DPD No. 4	Tablette / 250	511221BT
DPD No. 4	Tablette / 500	511222BT
DPD No. 3 Evo	Tablette / 100	511420BT
DPD No. 3 Evo	Tablette / 250	511421BT
DPD No. 3 Evo	Tablette / 500	511422BT
DPD No.4 Evo	Tablette / 100	511970BT
DPD No. 4 Evo	Tablette / 250	511971BT
DPD No. 4 Evo	Tablette / 500	511972BT

**Verfügbare Standards**

<b>Titel</b>	<b>Verpackungseinheit</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
ValidCheck Chlor 1,5 mg/L	1 St.	48105510



## Probenahme

1. Bei der Probenvorbereitung muss das Ausgasen von Chlor, z.B. durch Pipettieren und Schütteln, vermieden werden.
2. Die Analyse muss unmittelbar nach der Probenahme erfolgen.

## Vorbereitung

1. Reinigung der Küvetten:  
Da viele Haushaltsreiniger (z.B. Geschirrspülmittel) reduzierende Stoffe enthalten, kann es bei der Bestimmung von Chlor zu Minderbefunden kommen. Um diesen Messfehler auszuschließen, sollten die Glasgeräte chlorzehrungsfrei sein. Dazu werden die Glasgeräte für eine Stunde unter Natriumhypochloritlösung (0,1 g/L) aufbewahrt und danach gründlich mit VE-Wasser (Vollentsalztes Wasser) gespült.
2. Für die Einzelbestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor ist es sinnvoll, jeweils einen eigenen Satz Küvetten zu verwenden (siehe EN ISO 7393-2, Abs. 5.3).
3. Die DPD-Farbentwicklung erfolgt bei einem pH-Wert von 6,2 bis 6,5. Die Reagenzien enthalten daher einen Puffer zur pH-Wert Einstellung. Stark alkalische oder saure Wässer müssen jedoch vor der Analyse in einen pH-Bereich zwischen 6 und 7 gebracht werden (mit 0,5 mol/L Schwefelsäure bzw. 1 mol/L Natronlauge).

DE

## Anmerkungen

1. Evo-Tabletten können alternativ zu der entsprechenden Standard-Tablette verwendet werden (z.B. DPD Nr. 3 Evo anstatt DPD Nr. 3).




## Durchführung der Bestimmung freies Chlor mit Tablette


Die Methode im Gerät auswählen.



24-mm-Küvette mit **10 mL** **Probe** füllen.




Küvette(n) verschließen.




Die **Probenküvette** in den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.




Taste **ZERO** drücken.




Küvette aus dem Messschacht nehmen.



Die Küvette bis auf einige Tropfen entleeren.





Eine **DPD No. 1 Tablette** zugeben.




Tablette(n) unter leichter Drehung zerdrücken.




Küvette bis zur **10-mL-Marke** mit der **Probe** auffüllen.




Küvette(n) verschließen.



Tablette(n) durch  
Umschwenken lösen.



Die Probenküvette in  
den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.



Taste TEST (XD: START)  
drücken.


In der Anzeige erscheint das Ergebnis in mg/L freies Chlor.

## Durchführung der Bestimmung gesamt Chlor mit Tablette


Die Methode im Gerät auswählen.



24-mm-Küvette mit **10 mL** Probe  
füllen.



Küvette(n) verschließen.



Die Probenküvette in  
den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.




# Zero

DE


Taste **ZERO** drücken.

Küvette aus dem Messschacht nehmen.


Die Küvette bis auf einige Tropfen entleeren.



Eine **DPD No. 1** Tablette zugeben.




Eine **DPD No. 3** Tablette zugeben.



**Alternativ** zur DPD Nr. 1 und Nr. 3 Tablette kann eine DPD Nr. 4 Tablette zugegeben werden.





Tablette(n) unter leichter Drehung zerdrücken.




Küvette bis zur **10-mL-Marke** mit der **Probe** auffüllen.



Küvette(n) verschließen.




Tablette(n) durch  
Umschwenken lösen.



Die **Probenküvette** in  
den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.

## Test

Taste **TEST (XD: START)**  
drücken.



**2 Minute(n) Reaktionszeit**  
abwarten.

Nach Ablauf der Reaktionszeit erfolgt automatisch die Messung.  
In der Anzeige erscheint das Ergebnis in mg/L Gesamtchlor.



## Chemische Methode

DPD

## Appendix

DE

### Störungen

#### Permanente Störungen

- Alle in den Proben vorhandenen Oxidationsmittel reagieren wie Chlor, was zu Mehrbefunden führt.

#### Ausschließbare Störungen

- Störungen durch Kupfer und Eisen(III) sind durch EDTA zu beseitigen.
- Bei Proben mit hohem Calciumgehalt\* und/oder hoher Leitfähigkeit\* kann es bei der Verwendung der Reagenztabletten zu einer Eintrübung der Probe und damit verbundener Fehlmessung kommen. In diesem Fall sind alternativ die Reagenztablette DPD No. 1 High Calcium und die Reagenztablette DPD No. 3 High Calcium zu verwenden.  
\*exakte Werte können nicht angegeben werden, da die Entstehung einer Trübung von Art und Zusammensetzung des Probenwassers abhängt.
- Konzentrationen über 10 mg/L Chlor, bei Verwendung von Tabletten, können zu Ergebnissen innerhalb des Messbereichs bis hin zu 0 mg/L führen. Bei einer zu hohen Chlorkonzentration muss die Probe mit chlorfreiem Wasser verdünnt werden. 10 mL der verdünnten Probe werden mit Reagenz versetzt und die Messung wiederholt (Plausibilitätstest).

Störung	Stört ab / [mg/L]
$\text{CrO}_4^{2-}$	0.01
$\text{MnO}_2$	0.01

### Methodenvalidierung

Nachweisgrenze	0.02 mg/L
Bestimmungsgrenze	0.06 mg/L
Messbereichsende	6 mg/L
Empfindlichkeit	2.05 mg/L / Abs
Vertrauensbereich	0.04 mg/L
Verfahrensstandardabweichung	0.019 mg/L
Verfahrensvariationskoeffizient	0.87 %

### Konform

EN ISO 7393-2



<sup>a)</sup> Bestimmung von frei, gebunden, gesamt möglich | <sup>b)</sup> Hilfsreagenz, alternativ zur DPD No. 1 / No. 3 bei Eintrübungen der Probe durch hohen Calciumionengehalt und/oder hohe Leitfähigkeit

DE

**Chlor L****M101****0,02 - 4,0 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL6****DPD**

DE

## Material

Benötigtes Material (zum Teil optional):


<b>Reagenzien</b>	<b>Form/Menge</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
DPD 1 Pufferlösung, blaue Flasche	15 mL	471010
DPD 1 Pufferlösung	100 mL	471011
DPD 1 Pufferlösung im 6-er Pack	1 St.	471016
DPD 1 Reagenzlösung, grüne Flasche	15 mL	471020
DPD 1 Reagenzlösung	100 mL	471021
DPD 1 Reagenzlösung im 6-er Pack	1 St.	471026
DPD 3 Lösung, rote Flasche	15 mL	471030
DPD 3 Lösung	100 mL	471031
DPD 3 Lösung im 6-er Pack	1 St.	471036
DPD Reagenzien Set	1 St.	471056

## Verfügbare Standards

<b>Titel</b>	<b>Verpackungseinheit</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
ValidCheck Chlor 1,5 mg/L	1 St.	48105510

## Probenahme

- Bei der Probenvorbereitung muss das Ausgasen von Chlor, z.B. durch Pipettieren und Schütteln, vermieden werden.
- Die Analyse muss unmittelbar nach der Probenahme erfolgen.



## Vorbereitung

1. Reinigung der Küvetten:  
Da viele Haushaltsreiniger (z.B. Geschirrspülmittel) reduzierende Stoffe enthalten, kann es bei der Bestimmung von Chlor zu Minderbefunden kommen. Um diesen Messfehler auszuschließen, sollten die Glasgeräte chlorzehrungsfrei sein. Dazu werden die Glasgeräte für eine Stunde unter Natriumhypochloritlösung (0,1 g/L) aufbewahrt und danach gründlich mit VE-Wasser (Vollentsalztes Wasser) gespült.
2. Für die Einzelbestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor ist es sinnvoll, jeweils einen eigenen Satz Küvetten zu verwenden (siehe EN ISO 7393-2, Abs. 5.3).
3. Die DPD-Farbentwicklung erfolgt bei einem pH-Wert von 6,2 bis 6,5. Die Reagenzien enthalten daher einen Puffer zur pH-Wert Einstellung. Stark alkalische oder saure Wässer müssen jedoch vor der Analyse in einen pH-Bereich zwischen 6 und 7 gebracht werden (mit 0,5 mol/l Schwefelsäure bzw. 1 mol/l Natronlauge).

## Anmerkungen

1. Nach Gebrauch sind die Tropfflaschen mit der jeweils gleichfarbigen Schraubkappe sofort wieder zu verschließen.
2. Den Reagenziensatz bei +6 °C bis +10 °C kühl lagern.




## Durchführung der Bestimmung freies Chlor mit Flüssigreagenz


Die Methode im Gerät auswählen.




24-mm-Küvette mit **10 mL** Probe füllen.




Küvette(n) verschließen.




Die Probenküvette in den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.




Taste **ZERO** drücken.




Küvette aus dem Messschacht nehmen.




Küvette entleeren.




Die Tropfflaschen senkrecht halten und durch langsames Drücken gleich große Tropfen zugeben.




**6 Tropfen DPD**  
1 Puffer-Lösung in die Probenküvette geben.




**2 Tropfen DPD**  
1 Reagenz-Lösung in die Probenküvette geben.



Küvette bis zur 10-mL-Marke mit der Probe auffüllen.




Küvette(n) verschließen.




Inhalt durch Umschwenken mischen.

DE



Die Probenküvette in den Messschacht stellen. Positionierung beachten.



Taste TEST (XD: START) drücken.

In der Anzeige erscheint das Ergebnis in mg/L freies Chlor.

### Durchführung der Bestimmung gesamtes Chlor mit Flüssigreagenz


Die Methode im Gerät auswählen.




24-mm-Küvette mit 10 mL Probe füllen.



Küvette(n) verschließen.



Die Probenküvette in den Messschacht stellen. Positionierung beachten.



# Zero

DE

Taste **ZERO** drücken.Küvette aus dem  
Messschacht nehmen.

Küvette entleeren.



Die Tropfflaschen senkrecht halten und durch langsames Drücken gleich große Tropfen zugeben.



**6** **6 Tropfen DPD 1 Puffer-Lösung** in die **Probenküvette** geben.



**2** **2 Tropfen DPD 1 Reagenz-Lösung** in die **Probenküvette** geben.





**3** **3 Tropfen DPD 3 Lösung** in die **Probenküvette** geben.




Küvette bis zur **10-mL-Marke** mit der **Probe** auffüllen.



Küvette(n) verschließen.




Inhalt durch Umschwenken mischen.



Die **Probenküvette** in den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.

## Test

Taste **TEST (XD: START)** drücken.



**2 Minute(n) Reaktionszeit**  
abwarten.

Nach Ablauf der Reaktionszeit erfolgt automatisch die Messung.

In der Anzeige erscheint das Ergebnis in mg/L Gesamtchlor.



## Chemische Methode

DPD

## Appendix

DE

### Störungen

#### Permanente Störungen

- Alle in den Proben vorhandenen Oxidationsmittel reagieren wie Chlor, was zu Mehrbefunden führt.

#### Ausschließbare Störungen

- Störungen durch Kupfer und Eisen(III) sind durch EDTA zu beseitigen.
- Konzentrationen über 4 mg/L Chlor, bei Verwendung von Flüssigreagenzien, können zu Ergebnissen innerhalb des Messbereichs bis hin zu 0 mg/L führen. In diesem Fall muss die Probe mit chlorfreiem Wasser verdünnt werden. 10 ml der verdünnten Probe werden mit Reagenz versetzt und die Messung wiederholt (Plausibilitätstest).

Störung	Stört ab / [mg/L]
CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	0,01
MnO <sub>2</sub>	0,01

### Konform

EN ISO 7393-2

<sup>a)</sup> Bestimmung von frei, gebunden, gesamt möglich



**Chlor HR T****M103****0,1 - 10 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL10****DPD**

DE

## Material

Benötigtes Material (zum Teil optional):

Reagenzien	Form/Menge	Bestell-Nr.
DPD No. 1 HR	Tablette / 100	511500BT
DPD No. 1 HR	Tablette / 250	511501BT
DPD No. 1 HR	Tablette / 500	511502BT
DPD No.3 HREvo	Tablette / 100	511920BT
DPD No. 3 HREvo	Tablette / 250	511921BT
DPD No. 3 HREvo	Tablette / 500	511922BT
DPD No. 3 HR	Tablette / 100	511590BT
DPD No. 3 HR	Tablette / 250	511591BT
DPD No. 3 HR	Tablette / 500	511592BT
Set DPD No. 1 HR/No. 3 HR #	je 100	517791BT
Set DPD No. 1 HR/No. 3 HR #	je 250	517792BT
DPD No. 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablette / 100	515740BT
DPD No. 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablette / 250	515741BT
DPD No. 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablette / 500	515742BT
DPD No. 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablette / 100	515730BT
DPD No. 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablette / 250	515731BT
DPD No. 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Tablette / 500	515732BT

## Probenahme

- Bei der Probenvorbereitung muss das Ausgasen von Chlor, z.B. durch Pipettieren und Schütteln, vermieden werden.
- Die Analyse muss unmittelbar nach der Probenahme erfolgen.



## Vorbereitung

1. Reinigung der Küvetten:  
Da viele Haushaltsreiniger (z.B. Geschirrspülmittel) reduzierende Stoffe enthalten, kann es bei der Bestimmung von Chlor zu Minderbefunden kommen. Um diesen Messfehler auszuschließen, sollten die Glasgeräte chlorzehrungsfrei sein. Dazu werden die Glasgeräte für eine Stunde unter Natriumhypochloritlösung (0,1 g/L) aufbewahrt und danach gründlich mit VE-Wasser (Vollentsalztes Wasser) gespült.
2. Für die Einzelbestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor ist es sinnvoll, jeweils einen eigenen Satz Küvetten zu verwenden (siehe EN ISO 7393-2, Abs. 5.3).
3. Die DPD-Farbentwicklung erfolgt bei einem pH-Wert von 6,2 bis 6,5. Die Reagenzien enthalten daher einen Puffer zur pH-Wert Einstellung. Stark alkalische oder saure Wässer müssen jedoch vor der Analyse in einen pH-Bereich zwischen 6 und 7 gebracht werden (mit 0,5 mol/L Schwefelsäure bzw. 1 mol/L Natronlauge).

DE

## Anmerkungen

1. Evo-Tabletten können alternativ zu der entsprechenden Standard-Tablette verwendet werden (z.B. DPD Nr. 3 Evo anstatt DPD Nr. 3).




## Durchführung der Bestimmung freies Chlor HR mit Tablette


Die Methode im Gerät auswählen.



24-mm-Küvette mit **10 mL** **Probe** füllen.




Küvette(n) verschließen.




Die **Probenküvette** in den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.




Taste **ZERO** drücken.




Küvette aus dem Messschacht nehmen.



Die Küvette bis auf einige Tropfen entleeren.





Eine **DPD No. 1 HR Tablette** zugeben.




Tablette(n) unter leichter Drehung zerdrücken.



Küvette bis zur **10-mL-Marke** mit der **Probe** auffüllen.



Küvette(n) verschließen.



Tablette(n) durch  
Umschwenken lösen.



Die Probenküvette in  
den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.

## Test


Taste TEST (XD: START)  
drücken.

In der Anzeige erscheint das Ergebnis in mg/L freies Chlor.


### Durchführung der Bestimmung gesamtes Chlor HR mit Tablette

Die Methode im Gerät auswählen.


10 mL




24-mm-Küvette mit **10 mL** Probe  
füllen.



Küvette(n) verschließen.



Die Probenküvette in  
den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.




# Zero

DE


Taste **ZERO** drücken.

Küvette aus dem Messschacht nehmen.

Die Küvette bis auf einige Tropfen entleeren.




Eine **DPD No. 1 HR** Tablette zugeben.



Eine **DPD No. 3 HR** Tablette zugeben.




Tablette(n) unter leichter Drehung zerdrücken.





Küvette bis zur **10-mL-Marke** mit der Probe auffüllen.



Küvette(n) verschließen.




Tablette(n) durch Umschwenken lösen.



Die Probenküvette in den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.

# Test

Taste **TEST** (XD: START)  
drücken.



**2 Minute(n)** Reaktionszeit  
abwarten.

Nach Ablauf der Reaktionszeit erfolgt automatisch die Messung.

In der Anzeige erscheint das Ergebnis in mg/L Gesamtchlor.



## Chemische Methode

DPD

## Appendix

DE

### Störungen

#### Permanente Störungen

- Alle in den Proben vorhandenen Oxidationsmittel reagieren wie Chlor, was zu Mehrbefunden führt.

#### Ausschließbare Störungen

- Störungen durch Kupfer und Eisen(III) sind durch EDTA zu beseitigen.
- Bei Proben mit hohem Calciumgehalt\* und/oder hoher Leitfähigkeit\* kann es bei der Verwendung der Reagenztabletten zu einer Eintrübung der Probe und damit verbundener Fehlmessung kommen. In diesem Fall sind alternativ die Reagenztablette DPD No. 1 High Calcium und die Reagenztablette DPD No. 3 High Calcium zu verwenden.

\*exakte Werte können nicht angegeben werden, da die Entstehung einer Trübung von Art und Zusammensetzung des Probenwassers abhängt.

### Konform

EN ISO 7393-2

<sup>a)</sup> Bestimmung von frei, gebunden, gesamt möglich | <sup>b)</sup> Hilfsreagenz, alternativ zur DPD No. 1 / No. 3 bei Eintrübungen der Probe durch hohen Calciumionengehalt und/oder hohe Leitfähigkeit | <sup>c)</sup> inklusive Rührstab



**Kupfer T****M150****0,05 - 5 mg/L Cu<sup>a)</sup>****Cu****Biquinolin**

DE

## Material

Benötigtes Material (zum Teil optional):

<b>Reagenzien</b>	<b>Form/Menge</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
Copper No. 1	Tablette / 100	513550BT
Copper No. 1	Tablette / 250	513551BT
Copper No. 2	Tablette / 100	513560BT
Copper No. 2	Tablette / 250	513561BT
Set Copper No. 1/No. 2 <sup>#</sup>	je 100	517691BT
Set Copper No. 1/No. 2 <sup>#</sup>	je 250	517692BT

## Vorbereitung

1. Stark alkalische oder saure Wässer sollten vor der Analyse auf einen pH-Wert von 4 bis 6 eingestellt werden.



## Durchführung der Bestimmung Kupfer, frei mit Tablette

Die Methode im Gerät auswählen.

Wählen Sie zudem die Bestimmung: frei



24-mm-Küvette mit **10 mL** Küvette(n) verschließen.  
Probe füllen.





Die **Probenküvette** in  
den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.

DE

# Zero

Taste **ZERO** drücken.


Küvette aus dem  
Messschacht nehmen.




Eine **COPPER No. 1 Tablette** zugeben.

Tablette(n) unter leichter  
Drehung zerdrücken.


Küvette(n) verschließen.

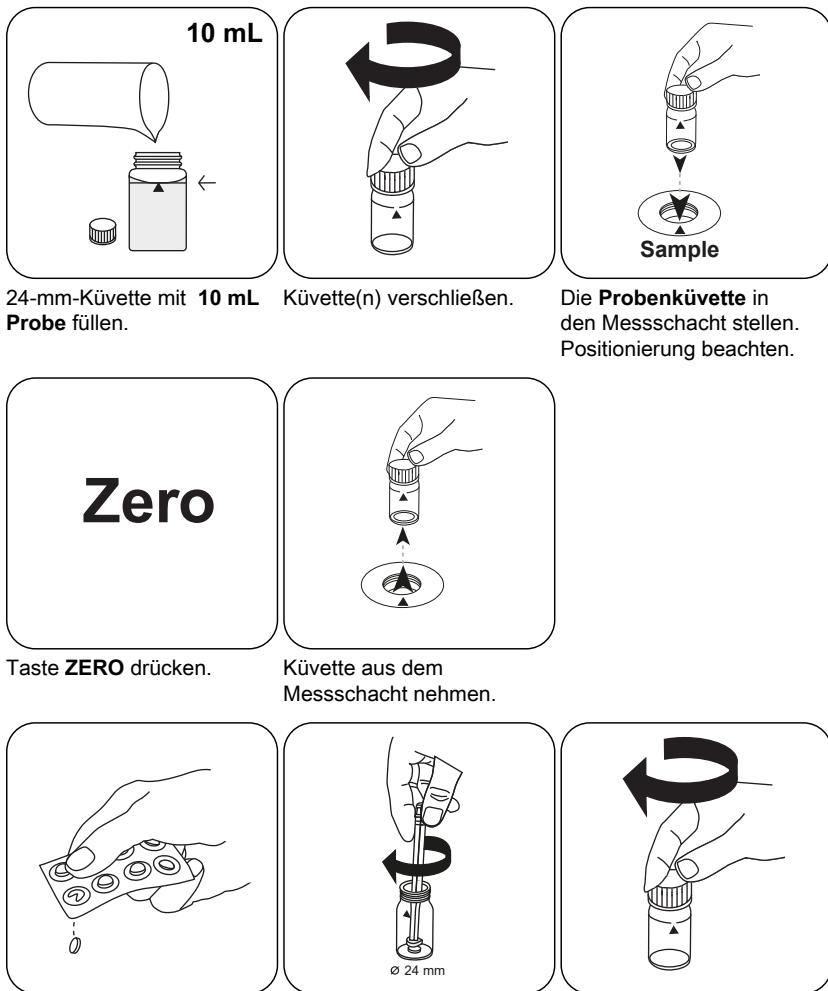




DE

Tablette(n) durch Umschwenken lösen.



## Test

Taste TEST (XD: START) drücken.



**2 Minute(n) Reaktionszeit** abwarten.

Nach Ablauf der Reaktionszeit erfolgt automatisch die Messung.

In der Anzeige erscheint das Ergebnis in mg/L freies Kupfer.

### Durchführung der Bestimmung Kupfer, gesamt mit Tablette

Die Methode im Gerät auswählen.


Wählen Sie zudem die Bestimmung: gesamt




24-mm-Küvette mit **10 mL** Probe füllen.



Küvette(n) verschließen.



Die Probenküvette in den Messschacht stellen. Positionierung beachten.




# Zero

Taste **ZERO** drücken.



DE


Küvette aus dem  
Messschacht nehmen.



Eine **COPPER No.  
1** Tablette zugeben.




Die Tablette(n) unter  
leichter Drehung  
zerdrücken und lösen.



Eine **COPPER No.  
2** Tablette zugeben.




Tablette(n) unter leichter  
Drehung zerdrücken.




Küvette(n) verschließen.



Tablette(n) durch  
Umschwenken lösen.



# Test



DE

Die Probenküvette in den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.

Taste TEST (XD: START) drücken.

2 Minute(n) Reaktionszeit abwarten.

Nach Ablauf der Reaktionszeit erfolgt automatisch die Messung.

In der Anzeige erscheint das Ergebnis in mg/L gesamtes Kupfer.



## Chemische Methode

Biquinolin

## Appendix

### Störungen

DE

#### Permanente Störungen

1. Cyanide  $\text{CN}^-$  und Silber  $\text{Ag}^+$  stören die Bestimmung.

### Methodenvalidierung

<b>Nachweisgrenze</b>	0.05 mg/L
<b>Bestimmungsgrenze</b>	0.15 mg/L
<b>Messbereichsende</b>	5 mg/L
<b>Empfindlichkeit</b>	3.8 mg/L / Abs
<b>Vertrauensbereich</b>	0.026 mg/L
<b>Verfahrensstandardabweichung</b>	0.011 mg/L
<b>Verfahrensvariationskoeffizient</b>	0.42 %

### Literaturverweise

Photometrische Analyse, Lange/Vedjelek, Verlag Chemie 1980

<sup>a)</sup> Bestimmung von frei, gebunden, gesamt möglich | \* inklusive Rührstab

**CyA T****M160****10 - 160 mg/L CyA****CyA****Melamin**

DE

**Material**

Benötigtes Material (zum Teil optional):


Reagenzien	Form/Menge	Bestell-Nr.
CyA-Test	Tablette / 100	511370BT
CyA-Test	Tablette / 250	511371BT
VE-Wasser	100 mL	461275
VE-Wasser	250 mL	457022

**Anmerkungen**

1. Cyanursäure verursacht eine sehr fein verteilte Trübung mit milchigem Aussehen. Einzelne Partikel sind nicht auf das Vorhandensein von Cyanursäure zurückzuführen.

## Durchführung der Bestimmung Cyanursäure-Test mit Tablette


Die Methode im Gerät auswählen.

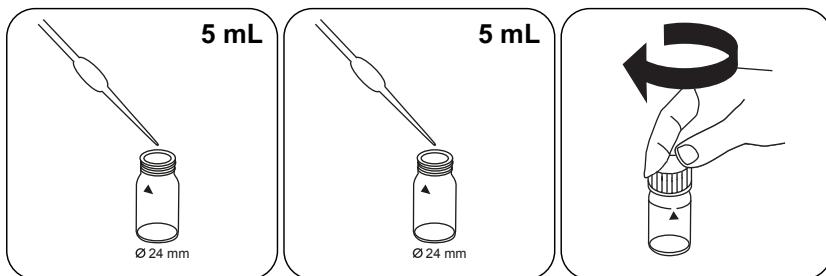

24 mm-Küvette mit **5 mL**  
**VE-Wasser** füllen.

**5 mL Probe** in die Küvette  
geben.


Küvette(n) verschließen.

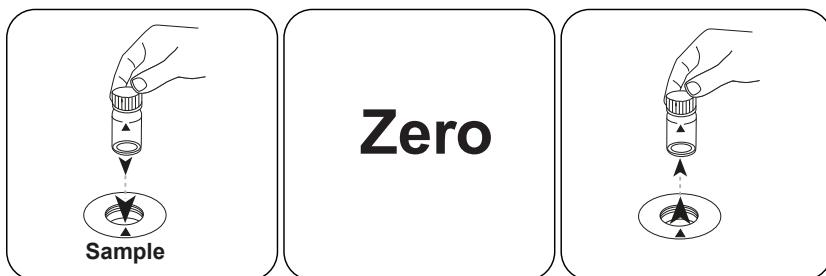

Die **Probenküvette** in  
den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.

Taste **ZERO** drücken.

Küvette aus dem  
Messschacht nehmen.

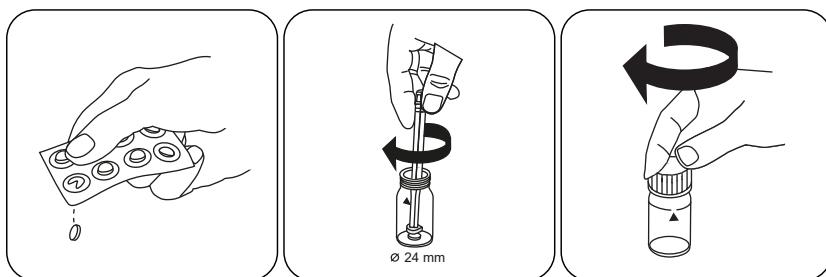

Eine **CyA-Test Tablette**  
zugeben.


Tablette(n) unter leichter  
Drehung zerdrücken.

Küvette(n) verschließen.


DE




DE



Inhalt durch Umschwenken  
mischen (mindestens  
60 s lang, bis die Tablette  
vollständig aufgelöst ist).




Die **Probenküvette** in  
den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.



Taste **TEST** (XD: **START**)  
drücken.

In der Anzeige erscheint das Ergebnis in mg/L Cyanursäure.



## Chemische Methode

Melamin

## Störungen

### Permanente Störungen

1. Nicht aufgelöste Partikel können zu Mehrbefunden führen. Daher ist es wichtig die Tabletten vollständig aufzulösen.

DE

**Eisen T****M220****0,02 - 1 mg/L Fe****FE****Ferrozine / Thioglycolat**

DE

## Material

Benötigtes Material (zum Teil optional):

Reagenzien	Form/Menge	Bestell-Nr.
Iron II LR ( $\text{Fe}^{2+}$ )	Tablette / 100	515420BT
Iron II LR ( $\text{Fe}^{2+}$ )	Tablette / 250	515421BT
Iron LR ( $\text{Fe}^{2+}$ und $\text{Fe}^{3+}$ )	Tablette / 100	515370BT
Iron LR ( $\text{Fe}^{2+}$ und $\text{Fe}^{3+}$ )	Tablette / 250	515371BT


## Vorbereitung

- Wässer, die mit organischen Verbindungen als Korrosionsschutz usw. behandelt worden sind, müssen ggf. oxidiert werden, um die Eisenkomplexe zu zerstören. Dazu wird eine 100 ml Probe mit 1 ml konzentrierter Schwefelsäure ( $\geq 95\%$ ) und 1 ml konzentrierter Salpetersäure ( $\geq 65\%$ ) versetzt und auf die Hälfte eingedampft. Nach dem Abkühlen wird der Aufschluss durchgeführt.


## Anmerkungen

- Bei dieser Methode erfolgt die Bestimmung von gesamt gelösten  $\text{Fe}^{2+}$  und  $\text{Fe}^{3+}$ .
- Zur Bestimmung von  $\text{Fe}^{2+}$  wird die IRON (II) LR Tablette, anstelle der IRON LR Tablette verwendet.


## Aufschluss




Ein geeignetes  
Probengefäß mit **100 mL**  
**Probe** füllen.




**1 mL** konzentrierte  
Schwefelsäure ( $\geq 95\%$ )  
zugeben.




Die Probe für **10 Minuten**  
**erhitzen**, oder so lange, bis  
sich alles vollständig gelöst  
hat.



Die Probe auf  
**Raumtemperatur**  
abkühlen lassen.



Den **pH-Wert** der Probe  
mit **Ammoniaklösung**  
(10-25 %) auf **3-5**  
einstellen.



Die Probe mit **VE-Wasser**  
auf **100 mL** auffüllen.

Diese Probe für die Analyse von gesamten gelösten und ungelösten Eisen verwenden.

### Durchführung der Bestimmung Eisen(II,III), gelöst mit Tablette

Die Methode im Gerät auswählen.

Für die Bestimmung von **gelöstem und ungelöstem Eisen** den beschriebenen  
**Aufschluss** durchführen.


DE




DE



24-mm-Küvette mit **10 mL** Probe füllen.



Küvette(n) verschließen.




Die **Probenküvette** in den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.

**Zero**



Taste **ZERO** drücken.


Küvette aus dem Messschacht nehmen.





Eine **IRON LR Tablette** zugeben.




Tablette(n) unter leichter Drehung zerdrücken.



Küvette(n) verschließen.




Tablette(n) durch  
Umschwenken lösen.



Die **Probenküvette** in  
den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.

## Test

DE



**5 Minute(n) Reaktionszeit**  
abwarten.

Nach Ablauf der Reaktionszeit erfolgt automatisch die Messung.  
In der Anzeige erscheint das Ergebnis in mg/L Eisen.



## Chemische Methode

Ferrozine / Thioglycolat

DE

## Appendix

### Störungen

#### Ausschließbare Störungen

1. Die Anwesenheit von Kupfer erhöht das Messergebnis um 10 %. Bei einer Konzentration von 10 mg/L Kupfer in der Probe wird das Messergebnis um 1 mg/L Eisen erhöht.  
Die Störung kann durch die Zugabe von Thioharnstoff beseitigt werden

### Methodenvalidierung

Nachweisgrenze	0.01 mg/L
Bestimmungsgrenze	0.016 mg/L
Messbereichsende	1 mg/L
Empfindlichkeit	0.92 mg/L / Abs
Vertrauensbereich	0.013 mg/L
Verfahrensstandardabweichung	0.005 mg/L
Verfahrensvariationskoeffizient	1.23 %

### Literaturverweise

Photometrische Analyse, Lange/ Vjedelek, Verlag Chemie 1980, S. 102



**pH-Wert T****M330****6,5 - 8,4 pH****PH****Phenolrot**

DE

**Material**

Benötigtes Material (zum Teil optional):

Reagenzien	Form/Menge	Bestell-Nr.
Phenol Red Photometer	Tablette / 100	511770BT
Phenol Red Photometer	Tablette / 250	511771BT
Phenol Red Photometer	Tablette / 500	511772BT

**Anmerkungen**


1. Für die photometrische pH-Wert Bestimmung sind nur PHENOL RED-Tabletten mit schwarzem Folienaufdruck zu verwenden, die mit dem Begriff PHOTOMETER gekennzeichnet sind.

## Durchführung der Bestimmung pH-Wert mit Tablette


Die Methode im Gerät auswählen.




24-mm-Küvette mit **10 mL** Probe füllen.




Küvette(n) verschließen.




Die Probenküvette in den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.




Taste **ZERO** drücken.




Küvette aus dem Messschacht nehmen.



Eine **PHENOL RED PHOTOMETER** Tablette zugeben.




Tablette(n) unter leichter Drehung zerdrücken.




Küvette(n) verschließen.




DE



Tablette(n) durch  
Umschwenken lösen.




Die **Probenküvette** in  
den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.



Taste **TEST** (XD: **START**)  
drücken.

In der Anzeige erscheint das Ergebnis als pH-Wert.



## Chemische Methode

Phenolrot

## Appendix

### Störungen

DE

#### Permanente Störungen

- Wasserproben mit geringer Carbonathärte\* können falsche pH-Werte ergeben.  
 $*K_{S4,3} < 0,7 \text{ mmol/l} \Leftrightarrow \text{Gesamtalkalität} < 35 \text{ mg/L CaCO}_3$ .

#### Ausschließbare Störungen

- pH-Werte unter 6,5 und über 8,4 können zu Ergebnissen innerhalb des Messbereiches führen. Es wird ein Plausibilitätstest (pH-Meter) empfohlen.
- Salzfehler:  
Bei Salzgehalten bis 2 g/L ist kein nennenswerter Salzfehler aufgrund des Salzgehaltes der Reagenztablette zu erwarten. Bei höheren Salzgehalten sind die Messwerte wie folgt zu korrigieren:

Salzgehalt der Probe in g/L	30 (Meerwasser)	60	120	180
Korrektur	-0,15 <sup>1)</sup>	-0,21 <sup>2)</sup>	-0,26 <sup>2)</sup>	-0,29 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> nach Kolthoff (1922)

<sup>2)</sup> nach Parson und Douglas (1926)

#### Literaturverweise

Colorimetric Chemical Analytical Methods, 9th Edition, London

**pH-Wert L****M331****6,5 - 8,4 pH****PH****Phenolrot**

DE

## Material

Benötigtes Material (zum Teil optional):

Reagenzien	Form/Menge	Bestell-Nr.
Phenolrot Lösung	15 mL	471040
Phenolrot Lösung	100 mL	471041
Phenolrot Lösung im -6er Pack	1 St.	471046

## Vorbereitung


1. Auf Grund unterschiedlicher Tropfengröße kann das Messergebnis größere Abweichungen als bei Verwendung von Tabletten aufweisen.  
Bei Verwendung einer Pipette (0,18 ml entsprechen 6 Tropfen) kann diese Abweichung minimiert werden.

## Anmerkungen

1. Nach Gebrauch ist die Tropfflasche mit der gleichfarbigen Schraubkappe sofort wieder zu verschließen.
2. Das Reagenz bei +6 °C bis +10 °C kühl lagern.

## Durchführung der Bestimmung pH-Wert mit Flüssigreagenz


Die Methode im Gerät auswählen.

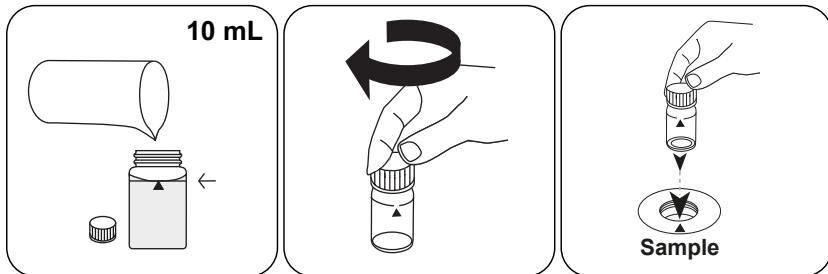

24-mm-Küvette mit **10 mL**  
Probe füllen.


Küvette(n) verschließen.

Die Probenküvette in  
den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.

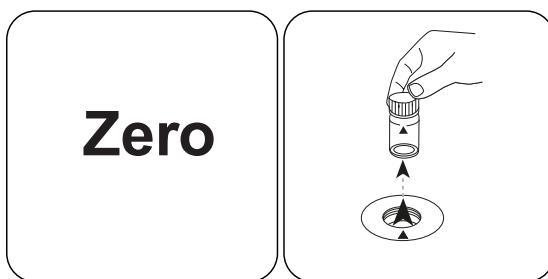

Taste **ZERO** drücken.

Küvette aus dem  
Messschacht nehmen.

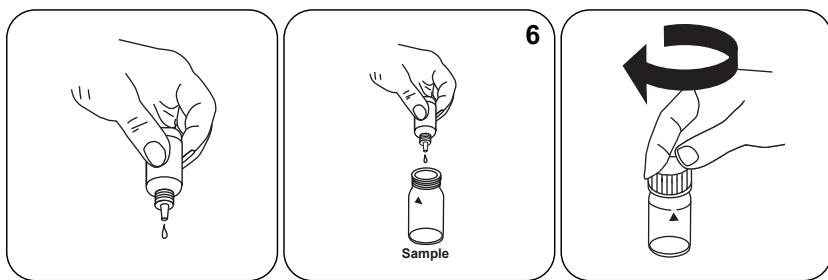

Die Tropfflaschen  
senkrecht halten und durch  
langes Drücken gleich  
große Tropfen zugeben.


**6 Tropfen PHENOL**  
**Red-Lösung** in die  
Probenküvette geben.

Küvette(n) verschließen.


DE




DE



Inhalt durch Umschwenken mischen.




Die **Probenküvette** in den Messschacht stellen.  
Positionierung beachten.



# Test

Taste **TEST** (XD: **START**) drücken.

In der Anzeige erscheint das Ergebnis als pH-Wert.



## Chemische Methode

Phenolrot

## Appendix

### Störungen

DE

#### Ausschließbare Störungen

1. Salzfehler: Korrektur des Messwertes (durchschnittliche Werte) für Proben mit einem Salzgehalt von:

2.	Salzgehalt der Probe	Korrektur
	30 g/L (Meerwasser)	-0,15 <sup>1)</sup>
	60 g/L	-0,21 <sup>2)</sup>
	120 g/L	-0,26 <sup>2)</sup>
	180 g/L	-0,29 <sup>2)</sup>
	<sup>1)</sup> nach Kolthoff (1922)	<sup>2)</sup> nach Parson und Douglas (1926)

3. Bei der Untersuchung von gechlortem Wasser kann der vorhandene Restchlorgehalt die Farbreaktion des Flüssigreagenzes beeinflussen. Dies wird verhindert, indem ein kleiner Kristall Natriumthiosulfat ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{ H}_2\text{O}$ ) in die Probelösung gegeben wird, bevor die PHENOL RED-Lösung zugesetzt wird.

#### Literaturverweise

Colorimetric Chemical Analytical Methods, 9th Edition, London

**KS4.3 T / 20**



**Código de barras para reconocer el método**

**Nombre del método**

**Número de método**

**Rango de medición**

**Método químico**

**Indicación en la pantalla de MD 100 / MD 110 / MD 200**

**K<sub>S4.3</sub> T**  
0.1 - 4 mmol/l K<sub>S4.3</sub>  
Ácido / Indicador

**20**  
**S:4.3**

**Información específica del instrumento**

La prueba puede realizarse en los siguientes dispositivos. Además, se muestran la cubeta requerida y el rango de absorción del fotómetro.

Dispositivos	Cubeta	$\lambda$	Rango de medición
MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	ø 24 mm	610 nm	0.1 - 4 mmol/l K <sub>S4.3</sub>
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	615 nm	0.1 - 4 mmol/l K <sub>S4.3</sub>

**Material**

Material requerido (parcialmente opcional):

Título	Unidad de embalaje	Referencia No
Fotómetro alca-M	Tabletas / 100	513210BT
Fotómetro alca-M	Tabletas / 250	513211BT

**Lista de aplicaciones**

- Tratamiento de aguas residuales
- Tratamiento de aguas potables
- Tratamiento de aguas de aporte

**Notas**

1. Las definiciones de alcalinidad-m, valor-m y capacidad ácida K<sub>S4.3</sub> son idénticas.
2. Añadir un volumen de muestra de exactamente 10 ml, ya que este volumen influye de forma decisiva en la exactitud del resultado.

**Códigos de idioma ISO 639-1**

**Estado de revisión**

ES Manual de Métodos 01/20

**Realización de la determinación**

**Ejecución de la determinación Capacidad ácida  $K_{S4.3}$  con tableta**

Seleccionar el método en el aparato.

Para este método no es necesario realizar medición CERO en los aparatos siguientes:  
XD 7000, XD 7500



Llenar la cubeta de 24 mm con **10 ml de muestra**.




Cerrar la(s) cubeta(s).



Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!

• • •



Añadir **tableta ALKA-M-PHOTOMETER**.



Triturar la(s) tableta(s) giran- Cerrar la(s) cubeta(s).



**Alcalinidad-m T****M30****5 - 200 mg/L CaCO<sub>3</sub>****tA****Ácido / Indicador**

ES

**Material**

Material requerido (parcialmente opcional):

Reactivos	Unidad de embalaje	No. de referencia
Fotómetro alca-M	Tabletas / 100	513210BT
Fotómetro alca-M	Tabletas / 250	513211BT

**Notas**


1. Las definiciones de alcalinidad-m, valor-m y capacidad ácida K<sub>S4.3</sub> son idénticas.
2. Añadir un volumen de muestra de exactamente 10 ml, ya que este volumen influye de forma decisiva en la exactitud del resultado.

## Ejecución de la determinación Alcalinidad, total= alcalinidad-m = valor-m con tableta


Seleccionar el método en el aparato.




Llenar la cubeta de 24 mm con **10 mL de muestra**.




Cerrar la(s) cubeta(s).




Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!




Pulsar la tecla **ZERO**.




Extraer la cubeta del compartimiento de medición.



Añadir **tableta ALKA-M-PHOTOMETER**.




Triturar la(s) tableta(s) girando ligeramente.



Cerrar la(s) cubeta(s).

ES



ES

Disolver la(s) tableta(s) girando.




Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!

## Test

Pulsar la tecla **TEST (XD: START)**.

A continuación se visualizará el resultado como Alcalinidad-m.



## Evaluación

La siguiente tabla muestra cómo los valores de salida se pueden convertir a otros formularios de citas.

Unidad	Conversión	Factor de conversión
mg/l	CaCO <sub>3</sub>	1
	°dH	0.056
	°eH	0.07
	°fH	0.1
	°aH	0.058
	K <sub>S4.3</sub>	0.02

ES

## Método químico

Ácido / Indicador

## Apéndice

Derivado de

EN ISO 9963-1

**Cloro T****M100****0.01 - 6.0 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL6****DPD**

ES

**Material**

Material requerido (parcialmente opcional):

<b>Reactivos</b>	<b>Unidad de embalaje</b>	<b>No. de referencia</b>
DPD nº1	Tabletas / 100	511050BT
DPD nº 1	Tabletas / 250	511051BT
DPD nº 1	Tabletas / 500	511052BT
DPD nº 3	Tabletas / 100	511080BT
DPD nº 3	Tabletas / 250	511081BT
DPD nº 3	Tabletas / 500	511082BT
DPD nº 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Tabletas / 100	515740BT
DPD nº 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Tabletas / 250	515741BT
DPD nº 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Tabletas / 500	515742BT
DPD nº 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Tabletas / 100	515730BT
DPD nº 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Tabletas / 250	515731BT
DPD nº 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Tabletas / 500	515732BT
DPD nº 4	Tabletas / 100	511220BT
DPD nº 4	Tabletas / 250	511221BT
DPD nº 4	Tabletas / 500	511222BT
DPD nº 3 Evo	Tabletas / 100	511420BT
DPD nº 3 Evo	Tabletas / 250	511421BT
DPD nº 3 Evo	Tabletas / 500	511422BT
DPD nº4 Evo	Tabletas / 100	511970BT
DPD nº 4 Evo	Tabletas / 250	511971BT
DPD nº 4 Evo	Tabletas / 500	511972BT

**Standards disponibles**

<b>Título</b>	<b>Unidad de embalaje</b>	<b>No. de referencia</b>
ValidCheck cloro 1,5 mg/l	1 Cantidad	48105510



## Muestreo

1. Evitar durante la preparación de la muestra la desgasificación de cloro, p. ej., al pipetar o agitar.
2. La determinación se ha de realizar inmediatamente después de la toma de la muestra.

## Preparación

ES

1. Limpieza de las cubetas:  
Muchos productos de limpieza (p. ej., detergentes de lavavajillas) poseen componentes reductores, que pueden reducir los resultados en la determinación del cloro. Para evitar estas alteraciones, los aparatos de vidrio deben estar exentos de componentes corrosivos al cloro. Para ello, deberá sumergir los aparatos de vidrio durante una hora en una solución de hipoclorito sódico (0,1 g/L), enjuagándolos minuciosamente a continuación con agua desionizada.
2. Para la determinación individual de cloro libre y cloro total se recomienda utilizar siempre los mismos sets de cubetas respectivamente (véase EN ISO 7393-2, párrafo 5.3).
3. El desarrollo coloreo por DPD se efectúa entre un valor de pH de 6,2 - 6,5. Por ello poseen las tabletas un tampón para la graduación del valor de pH. Sin embargo, las muestras acuosas muy ácidas o muy básicas se deberán neutralizar a un valor de pH entre 6 y 7 antes de realizar el análisis (con 0,5 mol/L de ácido sulfúrico o 1 mol/L de hidróxido sódico).

## Notas

1. Las tabletas Evo pueden utilizarse como alternativa a la tableta estándar correspondiente (por ejemplo, DPD nº 3 Evo en lugar de DPD nº 3).



## Ejecución de la determinación Cloro libre con tableta

Seleccionar el método en el aparato.

**10 mL**



Llenar la cubeta de 24 mm con **10 mL de muestra**.



Cerrar la(s) cubeta(s).



Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!

**Zero**




Pulsar la tecla **ZERO**.

Extraer la cubeta del compartimiento de medición.




Vaciar la cubeta excepto algunas gotas.





Añadir **tableta DPD No. 1**.




Triturar la(s) tableta(s) girando ligeramente.




Llenar la cubeta con la **muestra** hasta la **marca de 10 mL**.



Cerrar la(s) cubeta(s).



Disolver la(s) tableta(s) girando.



Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!

ES

## Test

Pulsar la tecla **TEST** (XD: **START**).


A continuación se visualizará el resultado en mg/L Cloro libre.

### Ejecución de la determinación Cloro total con tableta


Seleccionar el método en el aparato.



Llenar la cubeta de 24 mm con **10 mL de muestra**.



Cerrar la(s) cubeta(s).



Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!




# Zero

ES


Pulsar la tecla **ZERO**.

Extraer la cubeta del compartimiento de medición.


Vaciar la cubeta excepto algunas gotas.



Añadir tableta DPD No. 1.



Añadir tableta DPD No. 3.



Alternativa a la tableta  
DPD No 1 y No 3, se puede  
agregar una tableta DPD  
No. 4.





Triturar la(s) tableta(s)  
girando ligeramente.




Llenar la cubeta con la  
muestra hasta la marca  
de 10 mL .




Cerrar la(s) cubeta(s).




Disolver la(s) tableta(s) girando.



Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!



Pulsar la tecla **TEST** (XD: **START**).



Esperar **2 minutos como periodo de reacción**.

Finalizado el periodo de reacción se realizará la determinación automáticamente.

A continuación se visualizará el resultado en mg/L Cloro total.



## Método químico

DPD

## Apéndice

ES

### Interferencia

#### Interferencias persistentes

- Todos los elementos oxidantes existentes en la muestra reaccionan como el cloro, lo que produce un resultado más elevado.

#### Interferencias extraibles

- Las perturbaciones debido a cobre y hierro (III) deben suprimirse mediante EDTA.
- En las muestras con una elevada concentración de iones de calcio\* y/o alta conductividad\*, se puede producir un enturbiamiento de la muestra con el uso de las tabletas de reactivo, alterando el resultado. En este caso, utilizar alternativamente la tableta reactiva DPD nº 1 High Calcium y la tableta reactiva DPD nº 3 High Calcium. \*no se pueden dar valores exactos, ya que la aparición de enturbiamiento dependerá del tipo y composición de la muestra.
- Las concentraciones de cloro mayores a 10 mg/L, cuando se usan tabletas pueden conducir a resultados de dentro del campo de medición hasta 0 mg/L. Con una concentración de cloro alta, se deberá diluir la muestra con agua sin cloro. Se mezclan 10 mL de muestra diluida con reactivo y se repite la medición (prueba de plausibilidad).

Interferencia	de / [mg/L]
CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	0.01
MnO <sub>2</sub>	0.01

### Validación del método

Límite de detección	0.02 mg/L
Límite de determinación	0.06 mg/L
Límite del rango de medición	6 mg/L
Sensibilidad	2.05 mg/L / Abs
Intervalo de confianza	0.04 mg/L
Desviación estándar	0.019 mg/L
Coeficiente de variación	0.87 %

#### Conforme a

EN ISO 7393-2



<sup>a)</sup> Posible determinación de libre, combinado, total | <sup>b)</sup> Reactivo auxiliar, alternativo a DPD No.1/3 en enturbiamientos de la prueba debido a concentraciones elevadas de calcio y/o elevada conductividad

ES

**Cloro L****M101****0.02 - 4.0 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL6****DPD**

ES

**Material**

Material requerido (parcialmente opcional):

<b>Reactivos</b>	<b>Unidad de embalaje</b>	<b>No. de referencia</b>
Solución de tampón DPD 1, frasco azul	15 mL	471010
Solución de tampón DPD 1	100 mL	471011
Solución de tampón DPD 1 en pack de 6	1 Cantidad	471016
Solución reactiva DPD 1, frasco verde	15 mL	471020
Solución de reactivo DPD 1	100 mL	471021
Solución reactiva DPD 1 en pack de 6	1 Cantidad	471026
Solución DPD 3, frasco rojo	15 mL	471030
Solución DPD 3	100 mL	471031
Solución DPD 3 en pack de 6	1 Cantidad	471036
Juego de reactivos para DPD	1 Cantidad	471056

**Standards disponibles**

<b>Título</b>	<b>Unidad de embalaje</b>	<b>No. de referencia</b>
ValidCheck cloro 1,5 mg/l	1 Cantidad	48105510

**Muestreo**

1. Evitar durante la preparación de la muestra la desgasificación de cloro, p. ej., al pipetar o agitar.
2. La determinación se ha de realizar inmediatamente después de la toma de la muestra.



## Preparación

1. Limpieza de las cubetas:  
Muchos productos de limpieza (p. ej., detergentes de lavavajillas) poseen componentes reductores, que pueden reducir los resultados en la determinación del cloro. Para evitar estas alteraciones, los aparatos de vidrio deben estar exentos de componentes corrosivos al cloro. Para ello, deberá sumergir los aparatos de vidrio durante una hora en una solución de hipoclorito sódico (0,1 g/L), enjuagándolos minuciosamente a continuación con agua desionizada.
2. Para la determinación individual de cloro libre y cloro total se recomienda utilizar siempre los mismos sets de cubetas respectivamente (véase EN ISO 7393-2, párrafo 5.3).
3. El desarrollo coloreo por DPD se efectúa entre un valor de pH de 6,2 - 6,5. Por ello poseen las tabletas un tampón para la graduación del valor de pH. Sin embargo, las muestras acuosas muy ácidas o muy básicas se deberán neutralizar a un valor de pH entre 6 y 7 antes de realizar el análisis (con 0,5 mol/l de ácido sulfúrico o 1 mol/l de hidróxido sódico).

ES

## Notas

1. Después de usarlas, las botellas cuentagotas deben cerrarse de nuevo inmediatamente con la tapa roscada del mismo color, respectivamente.
2. Guardar el set reactivo a una temperatura entre +6 °C y +10 °C.




## Ejecución de la determinación Cloro libre con reactivos líquidos


Seleccionar el método en el aparato.




Llenar la cubeta de 24 mm con **10 mL de muestra**.




Cerrar la(s) cubeta(s).




Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!




Pulsar la tecla **ZERO**.




Extraer la cubeta del compartimiento de medición.




Vaciar la cubeta.




Mantener la botella cuentagotas vertical y añadir gotas del mismo tamaño presionando lentamente.




Añadir **6 gotas de DPD 1 Buffer Solution** en la cubeta con la muestra.




Añadir **2 gotas de DPD 1 Reagent Solution** en la cubeta con la muestra.



Llenar la cubeta con la  
**muestra** hasta la **marca de**  
**10 mL**.




Cerrar la(s) cubeta(s).




Mezclar el contenido girando.

ES



Poner la **cubeta de muestra** en el  
compartimiento de  
medición. ¡Debe tenerse en  
cuenta el posicionamiento!



Pulsar la tecla **TEST** (XD:  
**START**).


A continuación se visualizará el resultado en mg/L Cloro libre.

### Ejecución de la determinación Cloro total con reactivos líquidos


Seleccionar el método en el aparato.




Llenar la cubeta de 24 mm  
con **10 mL de muestra**.



Cerrar la(s) cubeta(s).



Poner la **cubeta de muestra**  
en el compartimiento de  
medición. ¡Debe tenerse en  
cuenta el posicionamiento!



# Zero

ES

Pulsar la tecla **ZERO**.

Extraer la cubeta del compartimiento de medición.

Vaciar la cubeta.



Mantener la botella cuentagotas vertical y añadir gotas del mismo tamaño presionando lentamente.

6



Añadir **6 gotas de DPD 1 Buffer Solution** en la cubeta con la muestra.

2




Añadir **2 gotas de DPD 1 Reagent Solution** en la cubeta con la muestra.





Añadir **3 gotas de DPD 3 Solution** en la cubeta con la muestra.

3


Llenar la cubeta con la muestra hasta la marca de **10 mL**.




Cerrar la(s) cubeta(s).




Mezclar el contenido girando.



Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!



Pulsar la tecla **TEST** (XD: **START**).



Esperar **2 minutos como periodo de reacción**.

Finalizado el periodo de reacción se realizará la determinación automáticamente.

A continuación se visualizará el resultado en mg/L Cloro total.



## Método químico

DPD

## Apéndice

ES

### Interferencia

#### Interferencias persistentes

- Todos los elementos oxidantes existentes en la muestra reaccionan como el cloro, lo que produce un resultado más elevado.

#### Interferencias extraibles

- Las perturbaciones debido a cobre y hierro (III) deben suprimirse mediante EDTA.
- Las concentraciones de cloro mayores a 4 mg/L, cuando se usan reactivos líquidos pueden conducir a resultados de dentro del campo de medición hasta 0 mg/L. En este caso, se deberá diluir la muestra con agua sin cloro. Se mezclan 10 ml de muestra diluida con reactivo y se repite la medición (prueba de plausibilidad).

Interferencia	de / [mg/L]
CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	0,01
MnO <sub>2</sub>	0,01

#### Conforme a

EN ISO 7393-2

<sup>a)</sup> Posible determinación de libre, combinado, total



**Cloro HR T****M103****0.1 - 10 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL10****DPD**

ES

**Material**

Material requerido (parcialmente opcional):

<b>Reactivos</b>	<b>Unidad de embalaje</b>	<b>No. de referencia</b>
DPD nº 1 HR	Tabletas / 100	511500BT
DPD nº 1 HR	Tabletas / 250	511501BT
DPD nº 1 HR	Tabletas / 500	511502BT
DPD nº3 HR Evo	Tabletas / 100	511920BT
DPD nº 3 HR Evo	Tabletas / 250	511921BT
DPD nº 3 HR Evo	Tabletas / 500	511922BT
DPD nº 3 HR	Tabletas / 100	511590BT
DPD nº 3 HR	Tabletas / 250	511591BT
DPD nº 3 HR	Tabletas / 500	511592BT
Juego DPD nº 1 HR/nº 3 HR #	100 cada	517791BT
Juego DPD nº 1 HR/nº 3 HR #	250 cada	517792BT
DPD nº 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Tabletas / 100	515740BT
DPD nº 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Tabletas / 250	515741BT
DPD nº 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Tabletas / 500	515742BT
DPD nº 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Tabletas / 100	515730BT
DPD nº 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Tabletas / 250	515731BT
DPD nº 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Tabletas / 500	515732BT

**Muestreo**

1. Evitar durante la preparación de la muestra la desgasificación de cloro, p. ej., al pipetar o agitar.
2. La determinación se ha de realizar inmediatamente después de la toma de la muestra.



## Preparación

1. Limpieza de las cubetas:  
Muchos productos de limpieza (p. ej., detergentes de lavavajillas) poseen componentes reductores, que pueden reducir los resultados en la determinación del cloro. Para evitar estas alteraciones, los aparatos de vidrio deben estar exentos de componentes corrosivos al cloro. Para ello, deberá sumergir los aparatos de vidrio durante una hora en una solución de hipoclorito sódico (0,1 g/L), enjuagándolos minuciosamente a continuación con agua desionizada.
2. Para la determinación individual de cloro libre y cloro total se recomienda utilizar siempre los mismos sets de cubetas respectivamente (véase EN ISO 7393-2, párrafo 5.3).
3. El desarrollo coloreo por DPD se efectúa entre un valor de pH de 6,2 - 6,5. Por ello poseen las tabletas un tampón para la graduación del valor de pH. Sin embargo, las muestras acuosas muy ácidas o muy básicas se deberán neutralizar a un valor de pH entre 6 y 7 antes de realizar el análisis (con 0,5 mol/L de ácido sulfúrico o 1 mol/L de hidróxido sódico).

ES

## Notas

1. Las tabletas Evo pueden utilizarse como alternativa a la tableta estándar correspondiente (por ejemplo, DPD nº 3 Evo en lugar de DPD nº 3).




## Ejecución de la determinación Cloro HR libre con tableta


Seleccionar el método en el aparato.




Llenar la cubeta de 24 mm con **10 mL de muestra**.



Cerrar la(s) cubeta(s).




Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!




**Zero**


Pulsar la tecla **ZERO**.




Extraer la cubeta del compartimiento de medición.



Vaciar la cubeta excepto algunas gotas.





Añadir **tableta DPD No. 1 HR**.




Triturar la(s) tableta(s) girando ligeramente.




Llenar la cubeta con la **muestra** hasta la **marca de 10 mL**.



Cerrar la(s) cubeta(s).



Disolver la(s) tableta(s)  
girando.



Poner la **cubeta de muestra**  
en el compartimento de  
medición. ¡Debe tenerse en  
cuenta el posicionamiento!

ES

## Test

Pulsar la tecla **TEST** (XD:  
**START**).


A continuación se visualizará el resultado en mg/L Cloro libre.

### Ejecución de la determinación Cloro HR total con tableta


Seleccionar el método en el aparato.



Llenar la cubeta de 24 mm  
con **10 mL de muestra**.



Cerrar la(s) cubeta(s).



Poner la **cubeta de muestra**  
en el compartimento de  
medición. ¡Debe tenerse en  
cuenta el posicionamiento!




# Zero

ES

Pulsar la tecla **ZERO**.

Extraer la cubeta del  
compartimiento de  
medición.

Vaciar la cubeta excepto  
algunas gotas.




Añadir tableta DPD No.  
1 HR .


Añadir tableta DPD No.  
3 HR .




Triturar la(s) tableta(s)  
girando ligeramente.





Llenar la cubeta con la  
muestra hasta la marca  
de 10 mL .



Cerrar la(s) cubeta(s).




Disolver la(s) tableta(s)  
girando.



Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!

## Test

Pulsar la tecla **TEST** (XD: START).




Esperar **2 minutos como periodo de reacción.**

Finalizado el periodo de reacción se realizará la determinación automáticamente.

A continuación se visualizará el resultado en mg/L Cloro total.

ES



## Método químico

DPD

## Apéndice

ES

### Interferencia

#### Interferencias persistentes

- Todos los elementos oxidantes existentes en la muestra reaccionan como el cloro, lo que produce un resultado más elevado.

#### Interferencias extraibles

- Las perturbaciones debido a cobre y hierro (III) deben suprimirse mediante EDTA.
- En las muestras con una elevada concentración de iones de calcio\* y/o alta conductividad\*, se puede producir un enturbiamiento de la muestra con el uso de las tabletas de reactivo, alterando el resultado. En este caso, utilizar alternativamente la tableta reactiva DPD nº 1 High Calcium y la tableta reactiva DPD nº 3 High Calcium.  
\*no se pueden dar valores exactos, ya que la aparición de enturbiamiento dependerá del tipo y composición de la muestra.

### Conforme a

EN ISO 7393-2

<sup>a)</sup> Posible determinación de libre, combinado, total | <sup>b)</sup> Reactivo auxiliar, alternativo a DPD No.1/3 en enturbiamientos de la prueba debido a concentraciones elevadas de calcio y/o elevada conductividad



**Cobre T****M150****0.05 - 5 mg/L Cu<sup>a)</sup>****Cu****Biquinolina**

ES

## **Material**

Material requerido (parcialmente opcional):

<b>Reactivos</b>	<b>Unidad de embalaje</b>	<b>No. de referencia</b>
Cobre nº 1	Tabletas / 100	513550BT
Cobre nº 1	Tabletas / 250	513551BT
Cobre nº 2	Tabletas / 100	513560BT
Cobre nº 2	Tabletas / 250	513561BT
Juego cobre nº 1/nº 2 <sup>#</sup>	100 cada	517691BT
Juego cobre nº 1/nº 2 <sup>#</sup>	250 cada	517692BT

## **Preparación**

1. Las muestras acuosas muy alcalinas o muy ácidas se deberán neutralizar a un valor de pH de 4 a 6.


## Ejecución de la determinación Cobre libre con tableta

Seleccionar el método en el aparato.


Seleccione además la determinación: libre




Llenar la cubeta de 24 mm con **10 mL** de muestra .




Cerrar la(s) cubeta(s).




Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!




Pulsar la tecla **ZERO**.




Extraer la cubeta del compartimiento de medición.



Añadir **tableta COPPER No. 1**.




Triturar la(s) tableta(s) girando ligeramente.




Cerrar la(s) cubeta(s).



ES




Disolver la(s) tableta(s) girando.



Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!

## Test

Pulsar la tecla **TEST (XD: START)**.



Esperar **2 minutos como periodo de reacción**.

Finalizado el periodo de reacción se realizará la determinación automáticamente.

A continuación se visualizará el resultado en mg/L Cobre libre.


### Ejecución de la determinación Cobre total con tableta

Seleccionar el método en el aparato.


Seleccione además la determinación: total




Llenar la cubeta de 24 mm con **10 mL de muestra**.



Cerrar la(s) cubeta(s).




Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!




# Zero

Pulsar la tecla **ZERO**.


Extraer la cubeta del  
compartimiento de  
medición.




Añadir **tableta COPPER No. 1.**




Triturar la(s) tabletas(s)  
girando ligeramente y  
disolver.




Añadir **tableta COPPER No. 2.**




Triturar la(s) tabletas(s)  
girando ligeramente.




Cerrar la(s) cubeta(s).



Disolver la(s) tabletas(s)  
girando.



# Test



ES

Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!

Finalizado el periodo de reacción se realizará la determinación automáticamente.

A continuación se visualizará el resultado en mg/L Cobre total.



## Método químico

Biquinolina

## Apéndice

### Interferencia

ES

#### Interferencias persistentes

1. Cianuro CN<sup>-</sup> y Plata Ag<sup>+</sup> perturban la determinación.

### Validación del método

Límite de detección	0.05 mg/L
Límite de determinación	0.15 mg/L
Límite del rango de medición	5 mg/L
Sensibilidad	3.8 mg/L / Abs
Intervalo de confianza	0.026 mg/L
Desviación estándar	0.011 mg/L
Coeficiente de variación	0.42 %

### Bibliografía

Photometrische Analyse, Lange/Vedjelek, Verlag Chemie 1980

<sup>a)</sup> Posible determinación de libre, combinado, total

**CyA T****M160****10 - 160 mg/L CyA****CyA****Melamina**

ES

**Material**

Material requerido (parcialmente opcional):


Reactivos	Unidad de embalaje	No. de referencia
CyA-Test	Tabletas / 100	511370BT
CyA-Test	Tabletas / 250	511371BT
Agua desionizada	100 mL	461275
Agua desionizada	250 mL	457022

**Notas**


1. El ácido cianúrico provoca un enturbiamiento muy fino de la solución, produciendo un aspecto lechoso. Si hay partículas individuales en la muestra no se deberán a la presencia de ácido cianúrico.

## Ejecución de la determinación Prueba de ácido cianúrico con tableta


Seleccionar el método en el aparato.




Llenar la cubeta de 24 mm con **5 mL de agua desionizada**.




Añadir **5 mL de muestra** en la cubeta.




Cerrar la(s) cubeta(s).




Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!




Pulsar la tecla **ZERO**.




Extraer la cubeta del compartimiento de medición.




Añadir **tableta CyA-Test**.



Triturar la(s) tableta(s) girando ligeramente.



Cerrar la(s) cubeta(s).



## Test

ES

Mezclar el contenido girando (durante al menos 60 s hasta la completa disolución de la tableta).

Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!

Pulsar la tecla **TEST (XD: START)**.

A continuación se visualizará el resultado en mg/L ácido cianúrico .



## Método químico

Melamina

## Interferencia

### Interferencias persistentes

1. Las partículas no disueltas pueden producir resultados mayores. Por ello, es importante que las tabletas se disuelvan completamente.

ES

**Hierro T****M220****0.02 - 1 mg/L Fe****FE****Ferrocina / Tioglicolato**

ES

## Material

Material requerido (parcialmente opcional):

Reactivos	Unidad de embalaje	No. de referencia
Hierro II LR (Fe <sup>2+</sup> )	Tabletas / 100	515420BT
Hierro II LR (Fe <sup>2+</sup> )	Tabletas / 250	515421BT
Hierro LR (Fe <sup>2+</sup> und Fe <sup>3+</sup> )	Tabletas / 100	515370BT
Hierro LR (Fe <sup>2+</sup> und Fe <sup>3+</sup> )	Tabletas / 250	515371BT


## Preparación

1. Las aguas que han sido tratadas con compuestos orgánicos como protección contra la corrosión, etc., pueden oxidarse para destruir los complejos de hierro. Para ello se disuelve una muestra de 100 ml con 1 ml de ácido sulfúrico concentrado y 1 ml de ácido nítrico concentrado y se evapora a la mitad. Después de enfriarse se realiza la disagregación.


## Notas

1. Con este método se realiza la determinación del Fe<sup>2+</sup> y Fe<sup>3+</sup> total disuelto.
2. Para determinar Fe<sup>2+</sup> se utiliza la tableta IRON (II) LR, en lugar de la tableta IRON LR.


## Disgregación




Llenar un recipiente de muestra apropiado con **100 mL de muestra**.




Añadir **1 mL de ácido sulfúrico concentrado**.




**Calentar la muestra durante 10 minutos**, o hasta que se haya disuelto totalmente.



Dejar enfriar la muestra a **temperatura ambiente**.



Ajustar el **valor de pH** de la muestra con **solución amoniacal** a 3-5.



Rellenar la muestra con **agua desionizada** hasta **100 mL**.

Utilizar esta muestra para el análisis de total de hierro disuelto y no disuelto.

### Ejecución de la determinación Hierro (II,III), disuelto con tableta

Seleccionar el método en el aparato.


Para la determinación de **Hierro disuelto y sin disolver** realizar la **disgregación** descrita.




ES



Llenar la cubeta de 24 mm con **10 mL de muestra**.




Cerrar la(s) cubeta(s).




Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!

# Zero




Pulsar la tecla **ZERO**.


Extraer la cubeta del compartimiento de medición.





Añadir **tableta IRON LR**.




Triturar la(s) tableta(s) girando ligeramente.




Cerrar la(s) cubeta(s).




Disolver la(s) tableta(s) girando.



Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!



Pulsar la tecla **TEST** (XD: **START**).



Esperar **5 minutos como periodo de reacción**.

Finalizado el periodo de reacción se realizará la determinación automáticamente.

A continuación se visualizará el resultado en mg/L Hierro.



## Método químico

Ferrocina / Tioglicolato

ES

## Apéndice

### Interferencia

#### Interferencias extraibles

- La presencia de cobre aumenta el resultado de medición un 10 %. Con una concentración de 10 mg/L de cobre en la muestra, el resultado de la medición se aumenta en 1 mg/L de hierro.  
La perturbación puede eliminarse añadiendo tiourea.

## Validación del método

Límite de detección	0.01 mg/L
Límite de determinación	0.016 mg/L
Límite del rango de medición	1 mg/L
Sensibilidad	0.92 mg/L / Abs
Intervalo de confianza	0.013 mg/L
Desviación estándar	0.005 mg/L
Coeficiente de variación	1.23 %

#### Bibliografía

Photometrische Analyse, Lange/ Vjedelek, Verlag Chemie 1980, S. 102



**Valor de pH T****M330****6.5 - 8.4 pH****PH****Rojo de fenol**

ES


**Material**

Material requerido (parcialmente opcional):

Reactivos	Unidad de embalaje	No. de referencia
Rojo de fenol fotómetro	Tabletas / 100	511770BT
Rojo de fenol fotómetro	Tabletas / 250	511771BT
Rojo de fenol fotómetro	Tabletas / 500	511772BT

**Notas**

1. Para la determinación fotométrica del valor de pH solo deben usarse tabletas PHENOL RED selladas en una lámina negra con la palabra adicional PHOTOMETER.




## Ejecución de la determinación Valor de pH con tableta


Seleccionar el método en el aparato.




Llenar la cubeta de 24 mm con **10 mL de muestra**.




Cerrar la(s) cubeta(s).




Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!




Pulsar la tecla **ZERO**.




Extraer la cubeta del compartimiento de medición.



Añadir **tableta PHENOL RED PHOTOMETER**.




Triturar la(s) tableta(s) girando ligeramente.




Cerrar la(s) cubeta(s).




ES



Disolver la(s) tableta(s) girando.




Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!



Pulsar la tecla **TEST (XD: START)**.

A continuación se visualizará el resultado como valor de pH.



## Método químico

Rojo de fenol

## Apéndice

### Interferencia

ES

#### Interferencias persistentes

1. Las muestras de agua con baja dureza de carbonato\* pueden entregar valores de pH falsos.  
\* $K_{S4,3} < 0,7 \text{ mmol/l} \triangleq \text{Alcalinidad total} < 35 \text{ mg/L CaCO}_3$ .

#### Interferencias extraibles

1. Los valores de pH inferiores a 6,5 y superiores a 8,4 pueden conducir a resultados dentro del campo de medición. Se recomienda realizar una prueba de plausibilidad (medidor de pH).
2. Error de sal:  
Con concentraciones de sal de hasta 2 g/L no cabe esperar un error de sal destacable, debido a la concentración de sal de la tableta de reactivo. Cuando las concentraciones de sal son mayores, los valores de medición deben corregirse del modo siguiente:

Concentración salina de la muestra en g/L	30 (agua de mar)	60	120	180
Corrección	-0,15 <sup>1)</sup>	-0,21 <sup>2)</sup>	-0,26 <sup>2)</sup>	-0,29 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>según Kolthoff (1922)

<sup>2)</sup>según Parson y Douglas (1926)

#### Bibliografía

Colorimetric Chemical Analytical Methods, 9th Edition, London

**Valor de pH L****M331****6.5 - 8.4 pH****PH****Rojo de fenol**

ES

## Material

Material requerido (parcialmente opcional):

Reactivos	Unidad de embalaje	No. de referencia
Solución de rojo de fenol	15 mL	471040
Solución de rojo de fenol	100 mL	471041
Solución roja de fenol en pack de 6	1 Cantidad	471046

## Preparación

1. El tamaño de las gotas, al contrario de las tabletas, puede aumentar las desviaciones del resultado.  
Mediante el uso de una pipeta (0,18 ml corresponden a 6 gotas) se pueden minimizar estas desviaciones.

## Notas


1. Despu  s de usarla, la botella cuentagotas debe cerrarse de nuevo inmediatamente con la tapa roscada del mismo color.
2. Guardar el reactivo a una temperatura entre +6 °C y +10 °C.

## Ejecución de la determinación Valor de pH con reactivos líquidos


Seleccionar el método en el aparato.




Llenar la cubeta de 24 mm con **10 mL de muestra**.




Cerrar la(s) cubeta(s).




Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!




Pulsar la tecla **ZERO**.




Extraer la cubeta del compartimiento de medición.



Mantener la botella cuentagotas vertical y añadir gotas del mismo tamaño presionando lentamente.




Añadir **6 gotas de PHENOL Red-Lösung** en la cubeta con la muestra.



**6**

Cerrar la(s) cubeta(s).



ES

Mezclar el contenido girando.




Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!

## Test

Pulsar la tecla **TEST (XD: START)**.

A continuación se visualizará el resultado como valor de pH.



## Método químico

Rojo de fenol

## Apéndice

### Interferencia

ES

#### Interferencias extraibles

1. Error de sal: Corrección de valor analizado (valores medios) para muestras con una concentración salina de:

Concentración salina de la muestra	Corrección
30 g/L (agua de mar)	-0,15 <sup>1)</sup>
60 g/L	-0,21 <sup>2)</sup>
120 g/L	-0,26 <sup>2)</sup>
180 g/L	-0,29 <sup>2)</sup>
<sup>1)</sup> según Kolthoff (1922)	<sup>2)</sup> según Parson y Douglas (1926)

3. En la determinación de muestras acuosas cloradas pueden influir los restos de cloro en la reacción coloreo del reactivo líquido. Esto puede evitarse añadiendo a la muestra un pequeño cristal de tiosulfato sódico ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{ H}_2\text{O}$ ), antes de incorporar el reactivo PHENOL RED.

### Bibliografía

Colorimetric Chemical Analytical Methods, 9th Edition, London

FR

KS4.3 T / 20

**Nom de la méthode**

**Numéro de méthode**

**Code à barres pour reconnaître la méthode**

**Plage de mesure**

$K_{S4.3} \text{ T}$   
0.1 - 4 mmol/l  $K_{S4.3}$   
Acide / Indicateur

**20**  
**S:4.3**

**Affichage dans le MD 100 / MD 110 / MD 200**

**Méthode chimique**

**Informations spécifiques à l'instrument**

Le test peut être effectué sur les appareils suivants. De plus, la cuvette requise et la plage d'absorption du photomètre sont indiquées.

Appareils	Cuvette	$\lambda$	Gamme de mesure
MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	$\varnothing$ 24 mm	610 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	$\varnothing$ 24 mm	615 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$

**Matériel**

Matériel requis (partiellement optionnel):

Titre	Pack contenant	Code
Alka-M-Photometer	Pastilles / 100	513210BT
Alka-M-Photometer	Pastilles / 250	513211BT

**Liste d'applications**

- Traitement des eaux usées
- Traitement de l'eau potable
- Traitement de l'eau brute

**Indication**

1. Les termes Alcalinité-m, Valeur m, Alcalinité totale et Capacité acide  $K_{S4.3}$  sont identiques.
2. L'observation exacte du volume d'échantillon de 10 ml est décisive pour l'exactitude du résultat de l'analyse.

**Codes de langue ISO 639-1**

**État de révision**

FR Méthodes Manuel 01/20

**Procédure du test****Réalisation de la quantification Capacité acide K<sub>S4.3</sub> avec pastille**

Sélectionnez la méthode sur l'appareil.


Cette méthode ne nécessite aucune mesure du zéro sur les appareils suivants : XD 7000, XD 7500



Remplissez une cuvette de 24 mm de 10 ml d'échantillon.




Fermez la(es) cuvette(s).




Placez la cuvette réservée à l'échantillon dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.


• • •




Ajoutez une pastille de ALKA-M-PHOTOMETER.



Écrasez la(es) pastille(s) en la(es) tournant un peu.



Fermez la(es) cuvette(s).

**Alcalinité-m T****M30****5 - 200 mg/L CaCO<sub>3</sub>****tA****Acide / Indicateur**

FR

**Matériel**

Matériel requis (partiellement optionnel):


Réactifs	Pack contenant	Code
Photomètre Alca-M	Pastilles / 100	513210BT
Photomètre Alca-M	Pastilles / 250	513211BT

**Indication**

1. Les termes Alcalinité-m, Valeur m, Alcalinité totale et Capacité acide K<sub>S4,3</sub> sont identiques.
2. L'observation exacte du volume d'échantillon de 10 ml est décisive pour l'exactitude du résultat de l'analyse.

## Réalisation de la quantification Alcalinité, total= Alcalinité-m = valeur-m avec pastille


Sélectionnez la méthode sur l'appareil.

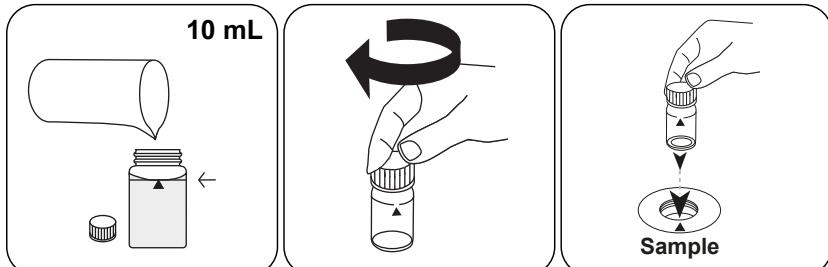

Remplissez une cuvette de 24 mm de **10 mL** d'échantillon.


Fermez la(les) cuvette(s).

Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.

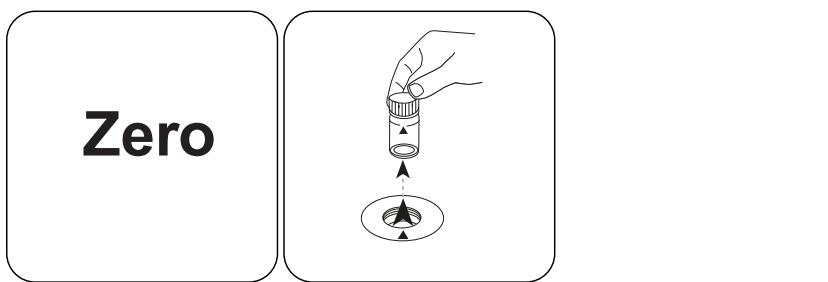

Appuyez sur la touche **ZERO**.

Retirez la cuvette de la chambre de mesure.

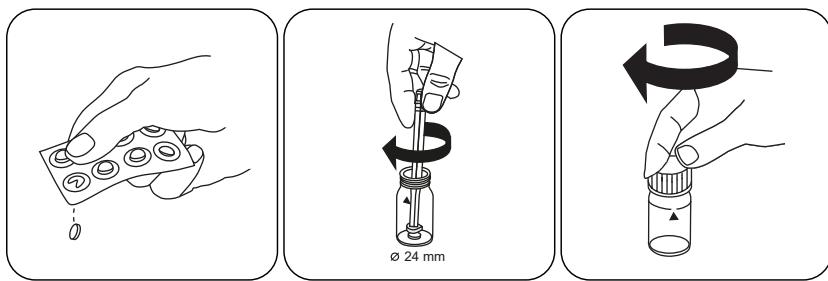


Ajoutez une **pastille de ALKA-M-PHOTOMETER**.

Écrasez la(les) pastille(s) en la(les) tournant un peu.

Fermez la(les) cuvette(s).

FR



## Test


FR

Dissolvez la(les) pastille(s) en mettant le tube plusieurs fois à l'envers.

Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.

Appuyez sur la touche **TEST** (XD: **START**).

Le résultat s'affiche à l'écran en alcalinité-m.



## Analyses

Le tableau suivant identifie les valeurs de sortie qui peuvent être converties en d'autres formes de citation.

Unité	Formes de citation	Facteur de conversion
mg/l	CaCO <sub>3</sub>	1
	°dH	0.056
	°eH	0.07
	°fH	0.1
	°aH	0.058
	K <sub>S4.3</sub>	0.02

FR

## Méthode chimique

Acide / Indicateur

## Appendice

Dérivé de

EN ISO 9963-1

**Chlore T****M100****0.01 - 6.0 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL6****DPD**

FR

**Matériel**

Matériel requis (partiellement optionnel):

Réactifs	Pack contenant	Code
DPD N°1	Pastilles / 100	511050BT
DPD N° 1	Pastilles / 250	511051BT
DPD N° 1	Pastilles / 500	511052BT
DPD N° 3	Pastilles / 100	511080BT
DPD N° 3	Pastilles / 250	511081BT
DPD N° 3	Pastilles / 500	511082BT
DPD N° 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Pastilles / 100	515740BT
DPD N° 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Pastilles / 250	515741BT
DPD N° 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Pastilles / 500	515742BT
DPD N° 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Pastilles / 100	515730BT
DPD N° 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Pastilles / 250	515731BT
DPD N° 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Pastilles / 500	515732BT
DPD N° 4	Pastilles / 100	511220BT
DPD N° 4	Pastilles / 250	511221BT
DPD N° 4	Pastilles / 500	511222BT
DPD N° 3 Evo	Pastilles / 100	511420BT
DPD N° 3 Evo	Pastilles / 250	511421BT
DPD N° 3 Evo	Pastilles / 500	511422BT
DPD N°4 Evo	Pastilles / 100	511970BT
DPD N° 4 Evo	Pastilles / 250	511971BT
DPD N° 4 Evo	Pastilles / 500	511972BT

**Standards disponibles**

Titre	Pack contenant	Code
ValidCheck Chlore 1,5 mg/l	1 Pièces	48105510



## Échantillonnage

1. Lors de la préparation de l'échantillon, il faudra éviter le dégazage du chrome, par ex. par pipetage ou agitation.
2. L'analyse devra avoir lieu immédiatement après le prélèvement de l'échantillon.

## Préparation

1. Nettoyage des cuvettes : Beaucoup de produits de nettoyage domestiques (par ex. liquide vaisselle) contenant des agents réducteurs, il est possible que lors de la quantification du chlore, les résultats soient plus bas. Pour exclure ces erreurs, les instruments en verre utilisés devraient être insensibles aux effets du chlore. Pour ce faire, il convient de laisser les instruments en verre pendant une heure dans une solution d'hypochlorite de sodium (0,1 g/L) et de bien les rincer ensuite à l'eau déminéralisée (eau entièrement dessalée).
2. Pour la quantification individuelle du chlore libre et du chlore total, il est recommandé d'utiliser à chaque fois un nouveau lot de cuvettes (voir EN ISO 7393-2, § 5.3).
3. La coloration due au DPD a lieu à un pH compris entre 6,2 et 6,5. C'est pourquoi les réactifs contiennent un tampon pour l'ajustage du pH. Avant l'analyse, les eaux fortement alcalines ou acides devraient être cependant ajustées sur un pH compris entre 6 et 7 (avec 0,5 mol/L d'acide sulfurique ou 1 mol/L de soude caustique).

FR

## Indication

1. Les pastilles Evo peuvent être utilisées en remplacement de la pastille standard correspondante (par exemple, DPD n° 3 Evo au lieu de DPD n° 3).




## Réalisation de la quantification Chlore libre avec pastilles


Sélectionnez la méthode sur l'appareil.




Remplissez une cuvette de 24 mm de **10 mL** d'échantillon.




Fermez la(les) cuvette(s).




Placez la cuvette réservée à l'échantillon dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.




Appuyez sur la touche **ZERO**.




Retirez la cuvette de la chambre de mesure.



Videz pratiquement la cuvette en y laissant quelques gouttes.





Ajoutez une pastille de DPD No. 1.




Écrasez la(les) pastille(s) en la(les) tournant un peu.




Remplissez la cuvette jusqu'au **repère de 10 mL** en y versant l'échantillon.



Fermez la(les) cuvette(s).



Dissolvez la(les) pastille(s)  
en mettant le tube plusieurs  
fois à l'envers.



Placez la **cuvette réservée**  
à l'échantillon dans la  
chambre de mesure.  
Attention à la positionner  
correctement.

FR

## Test

Appuyez sur la touche  
**TEST** (XD: START).

Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L chlore libre.

### Réalisation de la quantification Chlore total avec pastilles


Sélectionnez la méthode sur l'appareil.



Remplissez une cuvette  
de 24 mm de **10 mL**  
d'échantillon.



Fermez la(les) cuvette(s).



Placez la **cuvette réservée**  
à l'échantillon dans la  
chambre de mesure.  
Attention à la positionner  
correctement.




# Zero

FR


Appuyez sur la touche **ZERO**.

Retirez la cuvette de la chambre de mesure.


Videz pratiquement la cuvette en y laissant quelques gouttes.



Ajoutez une pastille de DPD No. 1.



Ajoutez une pastille de DPD No. 3.



En alternative aux comprimés DPD n° 1 et n° 3, un comprimé DPD n° 4 peut être ajouté.





Écrasez la(les) pastille(s) en la(les) tournant un peu.




Remplissez la cuvette jusqu'au repère de 10 mL en y versant l'échantillon.




Fermez la(les) cuvette(s).




Dissolvez la(les) pastille(s) en mettant le tube plusieurs fois à l'envers.



Placez la cuvette réservée à l'échantillon dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.



Appuyez sur la touche TEST (XD: START).



Attendez la fin du temps de réaction de 2 minute(s).

À l'issue du temps de réaction, la mesure est effectuée automatiquement.

Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L chlore total.



## Méthode chimique

DPD

## Appendice

FR

### Interférences

#### Interférences persistantes

- Les agents oxydants contenus dans les échantillons réagissent tous comme le chlore, ce qui entraîne des résultats plus élevés.

#### Interférences exclues

- Les perturbations causées par le cuivre et le fer (III) seront éliminées par EDTA.
- Dans le cas des échantillons à haute concentration en calcium\* et/ou conductibilité élevée\*, l'utilisation des pastilles de réactif peut causer des turbidités et donc fausser les résultats. Utilisez alors la pastille de réactif DPD N° 1 High Calcium et la pastille de réactif DPD N° 3 High Calcium.  
\*Nous ne pouvons fournir de valeurs exactes, l'apparition d'une turbidité dépendant du type et de la composition de l'eau d'échantillonnage.
- Les concentrations de chlore supérieures à 10 mg/L peuvent donner des résultats dans la plage de mesure allant jusqu'à 0 mg/L en utilisant des pastilles. En cas de concentration trop élevée de chlore, diluez l'échantillon à l'eau déchlorée. Le réactif est ajouté à 10 mL d'échantillon dilué. Ensuite, la mesure est répétée (test de plausibilité).

Interférences	de / [mg/L]
CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	0.01
MnO <sub>2</sub>	0.01

## Méthode Validation

Limite de détection	0.02 mg/L
Limite de détermination	0.06 mg/L
Fin de la gamme de mesure	6 mg/L
Sensibilité	2.05 mg/L / Abs
Intervalle de confiance	0.04 mg/L
Déviation standard	0.019 mg/L
Coefficient de variation	0.87 %

#### Conformité

EN ISO 7393-2



<sup>a)</sup>Détermination du libre, combiné et total | <sup>b)</sup>autre réactif, utilisé à la place de DPD No.1/3 en cas de turbidité dans l'échantillon d'eau due à une concentration élevée de calcium et/ou une conductivité élevée

FR

**Chlore L****M101****0.02 - 4.0 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL6****DPD**

FR

**Matériel**

Matériel requis (partiellement optionnel):

<b>Réactifs</b>	<b>Pack contenant</b>	<b>Code</b>
DPD 1 solution tampon, flacon bleu	15 mL	471010
DPD 1 solution tampon	100 mL	471011
Solution tampon DPD 1 dans un lot de 6	1 Pièces	471016
DPD 1 solution de réactif, flacon vert	15 mL	471020
DPD 1 solution de réactif	100 mL	471021
Solution de réactif DPD 1 dans un lot de 6	1 Pièces	471026
DPD 3 solution, flacon rouge	15 mL	471030
DPD 3 solution	100 mL	471031
Solution DPD 3 dans un lot de 6	1 Pièces	471036
Kit de réactifs DPD	1 Pièces	471056

**Standards disponibles**

<b>Titre</b>	<b>Pack contenant</b>	<b>Code</b>
ValidCheck Chlore 1,5 mg/l	1 Pièces	48105510

**Échantillonnage**

1. Lors de la préparation de l'échantillon, il faudra éviter le dégazage du chrome, par ex. par pipetage ou agitation.
2. L'analyse devra avoir lieu immédiatement après le prélèvement de l'échantillon.



## Préparation

1. Nettoyage des cuvettes : Beaucoup de produits de nettoyage domestiques (par ex. liquide vaisselle) contenant des agents réducteurs, il est possible que lors de la quantification du chlore, les résultats soient plus bas. Pour exclure ces erreurs, les instruments en verre utilisés devraient être insensibles aux effets du chlore. Pour ce faire, il convient de laisser les instruments en verre pendant une heure dans une solution d'hypochlorite de sodium (0,1 g/L) et de bien les rincer ensuite à l'eau déminéralisée (eau entièrement dessalée).
2. Pour la quantification individuelle du chlore libre et du chlore total, il est recommandé d'utiliser à chaque fois un nouveau lot de cuvettes (voir EN ISO 7393-2, § 5.3).
3. La coloration due au DPD a lieu à un pH compris entre 6,2 et 6,5. C'est pourquoi, les réactifs contiennent un tampon pour l'ajustage du pH. Avant l'analyse, les eaux fortement alcalines ou acides devraient être cependant ajustées sur un pH compris entre 6 et 7 (avec 0,5 mol/l d'acide sulfurique ou 1 mol/l de soude caustique).

FR

## Indication

1. Après emploi, refermez immédiatement les flacons compte-goutte en utilisant le capot de même couleur.
2. Conservez le lot de réactif à une température de +6 °C à +10 °C.




## Réalisation de la quantification Chlore libre avec réactifs liquides


Sélectionnez la méthode sur l'appareil.




Remplissez une cuvette de 24 mm de **10 mL** d'échantillon.




Fermez la(les) cuvette(s).




Placez la cuvette réservée à l'échantillon dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.




Appuyez sur la touche **ZERO**.




Retirez la cuvette de la chambre de mesure.




Videz la cuvette.



Tenez les flacons compte-goutte à la verticale et ajoutez des gouttes uniformes en appuyant lentement.




Ajoutez **6 gouttes de DPD 1 Buffer Solution** dans la cuvette réservée à l'échantillon.



Ajoutez **2 gouttes de DPD 1 Reagent Solution** dans la cuvette réservée à l'échantillon.


FR




Remplissez la cuvette jusqu'au **repère de 10 mL** en y versant l'**échantillon**.




Fermez la(les) cuvette(s).



Mélangez le contenu en mettant le tube plusieurs fois à l'envers puis à l'endroit.



Placez la **cuvette réservée** à l'**échantillon** dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.



Appuyez sur la touche **TEST (XD: START)**.

Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L chlore libre.

### Réalisation de la quantification Chlore total avec réactifs liquides


Sélectionnez la méthode sur l'appareil.



Remplissez une cuvette de 24 mm de **10 mL** d'échantillon.



Fermez la(les) cuvette(s).



Placez la **cuvette réservée** à l'**échantillon** dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.



# Zero

FR

Appuyez sur la touche **ZERO**.

Retirez la cuvette de la chambre de mesure.

Videz la cuvette.



Tenez les flacons compte-goutte à la verticale et ajoutez des gouttes uniformes en appuyant lentement.



Ajoutez **6 gouttes de DPD 1 Buffer Solution** dans la cuvette réservée à l'échantillon.

6




Ajoutez **2 gouttes de DPD 1 Reagent Solution** dans la cuvette réservée à l'échantillon.

2




Ajoutez **3 gouttes de DPD 3 Solution** dans la cuvette réservée à l'échantillon.





Remplissez la cuvette jusqu'au repère de **10 mL** en y versant l'échantillon.


3



Fermez la(les) cuvette(s).




Mélangez le contenu en mettant le tube plusieurs fois à l'envers puis à l'endroit.



Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.

## Test

Appuyez sur la touche **TEST** (XD: **START**).



Attendez la fin du **temps de réaction de 2 minute(s)**.

À l'issue du temps de réaction, la mesure est effectuée automatiquement.

Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L chlore total.



## Méthode chimique

DPD

## Appendice

FR

### Interférences

#### Interférences persistantes

- Les agents oxydants contenus dans les échantillons réagissent tous comme le chlore, ce qui entraîne des résultats plus élevés.

#### Interférences exclues

- Les perturbations causées par le cuivre et le fer (III) seront éliminées par EDTA.
- Les concentrations de chlore supérieures à 4 mg/L peuvent donner des résultats dans la plage de mesure allant jusqu'à 0 mg/L en utilisant des réactifs liquides. Dans ce cas, diluez l'échantillon à l'eau déchlorée. Le réactif est ajouté à 10 ml d'échantillon dilué. Ensuite, la mesure est répétée (test de plausibilité).

Interférences	de / [mg/L]
CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	0,01
MnO <sub>2</sub>	0,01

### Conformité

EN ISO 7393-2

<sup>a</sup>Détermination du libre, combiné et total



**Chlore HR T****M103****0.1 - 10 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL10****DPD**

FR

**Matériel**

Matériel requis (partiellement optionnel):

Réactifs	Pack contenant	Code
DPD N° 1 HR	Pastilles / 100	511500BT
DPD N° 1 HR	Pastilles / 250	511501BT
DPD N° 1 HR	Pastilles / 500	511502BT
DPD N° 3 HR	Pastilles / 100	511590BT
DPD N° 3 HR	Pastilles / 250	511591BT
DPD N° 3 HR	Pastilles / 500	511592BT
Kit DPD N° 1 HR/N° 3 HR #	100 chacun	517791BT
Kit DPD N° 1 HR/N° 3 HR #	250 chacun	517792BT
DPD N° 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Pastilles / 100	515740BT
DPD N° 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Pastilles / 250	515741BT
DPD N° 1 High Calcium <sup>e)</sup>	Pastilles / 500	515742BT
DPD N° 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Pastilles / 100	515730BT
DPD N° 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Pastilles / 250	515731BT
DPD N° 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Pastilles / 500	515732BT
DPD N° 3 HR Evo	Pastilles / 100	511920BT
DPD N° 3 HR Evo	Pastilles / 250	511921BT
DPD N° 3 HR Evo	Pastilles / 500	511922BT

**Échantillonnage**

1. Lors de la préparation de l'échantillon, il faudra éviter le dégazage du chrome, par ex. par pipetage ou agitation.
2. L'analyse devra avoir lieu immédiatement après le prélèvement de l'échantillon.



## Préparation

1. Nettoyage des cuvettes : Beaucoup de produits de nettoyage domestiques (par ex. liquide vaisselle) contenant des agents réducteurs, il est possible que lors de la quantification du chlore, les résultats soient plus bas. Pour exclure ces erreurs, les instruments en verre utilisés devraient être insensibles aux effets du chlore. Pour ce faire, il convient de laisser les instruments en verre pendant une heure dans une solution d'hypochlorite de sodium (0,1 g/L) et de bien les rincer ensuite à l'eau déminéralisée (eau entièrement dessalée).
2. Pour la quantification individuelle du chlore libre et du chlore total, il est recommandé d'utiliser à chaque fois un nouveau lot de cuvettes (voir EN ISO 7393-2, § 5.3).
3. La coloration due au DPD a lieu à un pH compris entre 6,2 et 6,5. C'est pourquoi, les réactifs contiennent un tampon pour l'ajustage du pH. Avant l'analyse, les eaux fortement alcalines ou acides devraient être cependant ajustées sur un pH compris entre 6 et 7 (avec 0,5 mol/L d'acide sulfurique ou 1 mol/L de soude caustique).

## Indication

1. Les pastilles Evo peuvent être utilisées en remplacement de la pastille standard correspondante (par exemple, DPD n° 3 Evo au lieu de DPD n° 3).




## Réalisation de la quantification Chlore HR libre avec pastilles


Sélectionnez la méthode sur l'appareil.




Remplissez une cuvette de 24 mm de **10 mL** d'échantillon.




Fermez la(les) cuvette(s).




Placez la cuvette réservée à l'échantillon dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.




Appuyez sur la touche **ZERO**.




Retirez la cuvette de la chambre de mesure.



Videz pratiquement la cuvette en y laissant quelques gouttes.





Ajoutez une pastille de DPD No. 1 HR .




Écrasez la(les) pastille(s) en la(les) tournant un peu.




Remplissez la cuvette jusqu'au **repère de 10 mL** en y versant l'échantillon.



Fermez la(les) cuvette(s).



Dissolvez la(les) pastille(s)  
en mettant le tube plusieurs  
fois à l'envers.



Placez la **cuvette réservée**  
à l'échantillon dans la  
chambre de mesure.  
Attention à la positionner  
correctement.

FR

## Test

Appuyez sur la touche  
**TEST** (XD: START).


Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L chlore libre.

### Réalisation de la quantification Chlore HR total avec pastilles


Sélectionnez la méthode sur l'appareil.



Remplissez une cuvette  
de 24 mm de **10 mL**  
d'échantillon.



Fermez la(les) cuvette(s).



Placez la **cuvette réservée**  
à l'échantillon dans la  
chambre de mesure.  
Attention à la positionner  
correctement.




# Zero

FR


Appuyez sur la touche ZERO.

Retirez la cuvette de la chambre de mesure.

Videz pratiquement la cuvette en y laissant quelques gouttes.




Ajoutez une pastille de DPD No. 1 HR .




Ajoutez une pastille de DPD No. 3 HR .




Écrasez la(les) pastille(s) en la(les) tournant un peu.





Remplissez la cuvette jusqu'au repère de 10 mL en versant l'échantillon.



Fermez la(les) cuvette(s).




Dissolvez la(les) pastille(s) en mettant le tube plusieurs fois à l'envers.




Placez la **cuvette réservée** à l'échantillon dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.

À l'issue du temps de réaction, la mesure est effectuée automatiquement.

Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L chlore total.



Appuyez sur la touche TEST (XD: START).



Attendez la fin du **temps de réaction de 2 minute(s)**.

FR



## Méthode chimique

DPD

## Appendice

FR

### Interférences

#### Interférences persistantes

- Les agents oxydants contenus dans les échantillons réagissent tous comme le chlore, ce qui entraîne des résultats plus élevés.

#### Interférences exclues

- Les perturbations causées par le cuivre et le fer (III) seront éliminées par EDTA.
- Dans le cas des échantillons à haute concentration en calcium\* et/ou conductibilité élevée\*, l'utilisation des pastilles de réactif peut causer des turbidités et donc fausser les résultats. Utilisez alors la pastille de réactif DPD N° 1 High Calcium et la pastille de réactif DPD N° 3 High Calcium.

\*Nous ne pouvons fournir de valeurs exactes, l'apparition d'une turbidité dépendant du type et de la composition de l'eau d'échantillonnage.

### Conformité

EN ISO 7393-2

<sup>a</sup>Détermination du libre, combiné et total | <sup>b</sup>autre réactif, utilisé à la place de DPD No.1/3 en cas de turbidité dans l'échantillon d'eau due à une concentration élevée de calcium et/ou une conductivité élevée | <sup>j</sup># agitateur inclus



**Cuivre T****M150****0.05 - 5 mg/L Cu<sup>a)</sup>****Cu****Biquinoline**

FR

## Matériel

Matériel requis (partiellement optionnel):

Réactifs	Pack contenant	Code
Cuivre N° 1	Pastilles / 100	513550BT
Cuivre N° 1	Pastilles / 250	513551BT
Cuivre N° 2	Pastilles / 100	513560BT
Cuivre N° 2	Pastilles / 250	513561BT
Kit cuivre N° 1/N° 2*	100 chacun	517691BT
Kit cuivre N° 1/N° 2*	250 chacun	517692BT

## Préparation

1. Avant l'analyse, les eaux fortement alcalines ou acides devraient être ajustées sur un pH 4 à 6.


## Réalisation de la quantification Cuivre, libre avec pastille

Sélectionnez la méthode sur l'appareil.


Sélectionnez également la quantification : libre




Remplissez une cuvette de 24 mm de **10 mL** d'échantillon.




Fermez la(es) cuvette(s).




Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.




Appuyez sur la touche **ZERO**.




Retirez la cuvette de la chambre de mesure.



Ajoutez une **pastille de COPPER No. 1**.




Écrasez la(es) pastille(s) en la(es) tournant un peu.




Fermez la(es) cuvette(s).

FR



FR


Dissolvez la(s) pastille(s) en mettant le tube plusieurs fois à l'envers.



Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.

## Test

Appuyez sur la touche **TEST** (XD: **START**).



Attendez la fin du temps de réaction de **2 minute(s)**.



À l'issue du temps de réaction, la mesure est effectuée automatiquement.

Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L Cuivre, libre.

### Réalisation de la quantification Cuivre, total avec pastille

Sélectionnez la méthode sur l'appareil.


Sélectionnez également la quantification : total

**10 mL**

Remplissez une cuvette de 24 mm de **10 mL** d'échantillon.



Fermez la(les) cuvette(s).




Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.

**Zero**

Appuyez sur la touche **ZERO**.


Retirez la cuvette de la chambre de mesure.



Ajoutez une **pastille de COPPER No. 1.**



Écrasez et dissolvez la(les) pastille(s) en la(les) tournant un peu.



Ajoutez une **pastille de COPPER No. 2.**




FR


Écrasez la(les) pastille(s)  
en la(les) tournant un peu.



Fermez la(les) cuvette(s).



Dissolvez la(les) pastille(s)  
en mettant le tube plusieurs  
fois à l'envers.




Placez la **cuvette réservée**  
à l'échantillon dans la  
chambre de mesure.  
Attention à la positionner  
correctement.

# Test

À l'issue du temps de réaction, la mesure est effectuée automatiquement.

Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L Cuivre, total.



Attendez la fin du **temps de  
réaction de 2 minute(s)**.



## Méthode chimique

Biquinoline

## Appendice

### Interférences

FR

#### Interférences persistantes

1. Cyanure CN<sup>-</sup> et Argent Ag<sup>+</sup> perturbent la quantification.

## Méthode Validation

<b>Limite de détection</b>	0.05 mg/L
<b>Limite de détermination</b>	0.15 mg/L
<b>Fin de la gamme de mesure</b>	5 mg/L
<b>Sensibilité</b>	3.8 mg/L / Abs
<b>Intervalle de confiance</b>	0.026 mg/L
<b>Déviation standard</b>	0.011 mg/L
<b>Coefficient de variation</b>	0.42 %

### Bibliographie

Photometrische Analyse, Lange/Vedjelek, Verlag Chemie 1980

<sup>a)</sup>Détermination du libre, combiné et total | <sup>b)</sup># agitateur inclus

**CyA T****M160****10 - 160 mg/L CyA****CyA****Mélamine**

FR

**Matériel**

Matériel requis (partiellement optionnel):


Réactifs	Pack contenant	Code
Test CyA	Pastilles / 100	511370BT
Test CyA	Pastilles / 250	511371BT
Eau purifiée	100 mL	461275
Eau purifiée	250 mL	457022

**Indication**


1. L'acide cyanurique cause une turbidité très fine répartie d'aspect laiteux. Certaines particules ne s'expliquent pas par la présence d'acide cyanurique.

## Réalisation de la quantification Test à l'acide cyanurique avec pastille


Selectionnez la méthode sur l'appareil.




Remplissez une cuvette de 24 mm de **5 mL d'eau déminéralisée**.




Versez **5 mL d'échantillon** dans la cuvette.




Fermez la(les) cuvette(s).




Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.




Appuyez sur la touche **ZERO**.




Retirez la cuvette de la chambre de mesure.



Ajoutez une **pastille de CyA-Test**.






Écrasez la(les) pastille(s) en la(les) tournant un peu.



Fermez la(les) cuvette(s).

FR




FR

Retourner plusieurs fois pour mélanger le contenu (pendant au moins 60 s, jusqu'à ce que la pastille soit complètement dissoute) .

Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L Acide cyanurique.

Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.

Appuyez sur la touche **TEST** (XD: **START**).



## Méthode chimique

Mélamine

## Interférences

### Interférences persistantes

1. Les particules non dissoutes peuvent entraîner des résultats plus élevés. Il est donc important de dissoudre entièrement les pastilles.

FR

**Fer T****M220****0.02 - 1 mg/L Fe****FE****Ferrozine / Thioglycolate**

FR

## Matériel

Matériel requis (partiellement optionnel):


Réactifs	Pack contenant	Code
Fer II LR ( $\text{Fe}^{2+}$ )	Pastilles / 100	515420BT
Fer II LR ( $\text{Fe}^{2+}$ )	Pastilles / 250	515421BT
Fer LR ( $\text{Fe}^{2+}$ und $\text{Fe}^{3+}$ )	Pastilles / 100	515370BT
Fer LR ( $\text{Fe}^{2+}$ und $\text{Fe}^{3+}$ )	Pastilles / 250	515371BT

## Préparation


- Il faudra éventuellement oxyder les eaux auparavant traitées avec des composés organiques pour les protéger de la corrosion etc. afin de détruire les complexes du fer. À un échantillon de 100 ml, on ajoutera 1 ml d'acide sulfurique concentré et 1 ml d'acide nitrique concentré pour réduire le tout de moitié par évaporation. Le fractionnement est effectué après le refroidissement.

## Indication


- Cette méthode permet de quantifier le  $\text{Fe}^{2+}$  total dissous et  $\text{Fe}^{3+}$ .
- Pour la quantification du  $\text{Fe}^{2+}$ , la pastille IRON LR est remplacée par la pastille IRON (II) LR.




## Fractionnement




Versez **100 mL** d'échantillon dans un tube pour échantillon adéquat.




Ajoutez **1 mL** de **d'acide sulfurique concentré**.




Réchauffez l'échantillon pendant **10 minutes**, ou jusqu'à ce que tout soit entièrement dissous.



Laissez refroidir l'échantillon à **température ambiante**.



Réglez le **pH** de l'échantillon avec **solution ammoniaquée** pour obtenir 3-5.



Complétez l'échantillon en ajoutant **d'eau déminéralisée** pour obtenir **100 mL**.

Utilisez cet échantillon pour analyser Fer total résolu et dissous.

### Réalisation de la quantification Fer (II,III), dissous avec pastille

Sélectionnez la méthode sur l'appareil.


Pour la quantification de **Fer dissous et non dissous**, procédez au fractionnement décrit .




FR




Remplissez une cuvette de 24 mm de **10 mL** d'échantillon.




Fermez la(les) cuvette(s).



Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.




Appuyez sur la touche **ZERO**.




Retirez la cuvette de la chambre de mesure.





Ajoutez une **pastille de IRON LR**.




Écrasez la(les) pastille(s) en la(les) tournant un peu.



Fermez la(les) cuvette(s).



Dissolvez la(s) pastille(s) en mettant le tube plusieurs fois à l'envers.




Placez la cuvette réservée à l'échantillon dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.

## Test

FR

Appuyez sur la touche TEST (XD: START).



Attendez la fin du temps de réaction de 5 minute(s) .

À l'issue du temps de réaction, la mesure est effectuée automatiquement.

Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L fer.



## Méthode chimique

Ferrozine / Thioglycolate

FR

## Appendice

### Interférences

#### Interférences exclues

1. La présence de cuivre augmente le résultat de 10 %. À une concentration de cuivre égale à 10 mg/L dans l'échantillon, le résultat augmente de 1 mg/L de fer.  
La perturbation peut être éliminée par un apport de thiocarbamide.

## Méthode Validation

<b>Limite de détection</b>	0.01 mg/L
<b>Limite de détermination</b>	0.016 mg/L
<b>Fin de la gamme de mesure</b>	1 mg/L
<b>Sensibilité</b>	0.92 mg/L / Abs
<b>Intervalle de confiance</b>	0.013 mg/L
<b>Déviation standard</b>	0.005 mg/L
<b>Coefficient de variation</b>	1.23 %

#### Bibliographie

Photometrische Analyse, Lange/ Vjedelek, Verlag Chemie 1980, S. 102



**Valeur du pH T****M330****6.5 - 8.4 pH****PH****Rouge de phénol**

FR

**Matériel**

Matériel requis (partiellement optionnel):

<b>Réactifs</b>	<b>Pack contenant</b>	<b>Code</b>
Rouge de phénol Photomètre	Pastilles / 100	511770BT
Rouge de phénol Photomètre	Pastilles / 250	511771BT
Rouge de phénol Photomètre	Pastilles / 500	511772BT

**Indication**


1. Pour la quantification photométrique du pH, n'utilisez que des pastilles PHENOL RED avec étiquette noire, sur lesquelles le terme PHOTOMER est apposé.

## Réalisation de la quantification Valeur du pH avec pastille


Sélectionnez la méthode sur l'appareil.




Remplissez une cuvette de 24 mm de **10 mL** d'échantillon.




Fermez la(les) cuvette(s).




Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.




Appuyez sur la touche **ZERO**.




Retirez la cuvette de la chambre de mesure.



Ajoutez une **pastille de PHENOL RED PHOTOMETER**.




Écrasez la(les) pastille(s) en la(les) tournant un peu.



Fermez la(les) cuvette(s).

FR



## Test


FR

Dissolvez la(les) pastille(s) en mettant le tube plusieurs fois à l'envers.

Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.

Appuyez sur la touche **TEST** (XD: **START**).

Le résultat s'affiche à l'écran en valeur du pH.



## Méthode chimique

Rouge de phénol

## Appendice

### Interférences

FR

#### Interférences persistantes

1. Les échantillons d'eau avec faible dureté carbonatée\* peuvent fausser les pH.  
\* $K_{S4,3} \leq 0,7 \text{ mmol/l} \triangleq \text{alcalinité totale} \leq 35 \text{ mg/L CaCO}_3$ .

#### Interférences exclues

1. Les pH inférieurs à 6,5 et supérieurs à 8,4 peuvent provoquer des résultats dans la plage de mesure. Il est recommandé d'effectuer un test de plausibilité (appareil de mesure du pH).
2. Erreur de sel :  
À des concentrations du sel jusqu'à 2 g/L, il ne faut s'attendre à aucune erreur digne de ce nom en raison de la concentration en sel de la pastille de réactif. À des concentrations supérieures, les valeurs mesurées seront corrigées comme suit :

Concentration en sel de l'échantillon en g/L	30 (eau de mer)	60	120	180
Correction	-0,15 <sup>1)</sup>	-0,21 <sup>2)</sup>	-0,26 <sup>2)</sup>	-0,29 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>selon Kolthoff (1922)

<sup>2)</sup>selon Parson et Douglas (1926)

#### Bibliographie

Colorimetric Chemical Analytical Methods, 9th Edition, London

**Valeur du pH L****M331****6.5 - 8.4 pH****PH****Rouge de phénol**

FR

**Matériel**

Matériel requis (partiellement optionnel):

<b>Réactifs</b>	<b>Pack contenant</b>	<b>Code</b>
Solution de phénol rouge	15 mL	471040
Solution de phénol rouge	100 mL	471041
Solution de phénol rouge dans un lot de 6	1 Pièces	471046

**Préparation**

1. En raison des différentes tailles de gouttes, le résultat peut présenter des écarts supérieurs à ceux des pastilles.  
Cet écart peut être réduit à un minimum en utilisant une pipette (0,18 ml correspondent à 6 gouttes).

**Indication**


1. Après emploi, refermez immédiatement le flacon compte-goutte en utilisant le capot de même couleur.
2. Conservez le réactif à une température de +6 °C à +10 °C.

## Réalisation de la quantification Valeur du pH avec réactif liquide


Sélectionnez la méthode sur l'appareil.




Remplissez une cuvette de 24 mm de **10 mL** d'échantillon.




Fermez la(les) cuvette(s).




Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.




Appuyez sur la touche **ZERO**.




Retirez la cuvette de la chambre de mesure.



Tenez les flacons compte-goutte à la verticale et ajoutez des gouttes uniformes en appuyant lentement.




Ajoutez **6 gouttes de PHENOL Red-Lösung** dans la cuvette réservée à l'échantillon.



Fermez la(les) cuvette(s).

FR



## Test


FR

Mélangez le contenu en mettant le tube plusieurs fois à l'envers puis à l'endroit.

Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure.  
Attention à la positionner correctement.

Appuyez sur la touche **TEST** (XD: **START**).

Le résultat s'affiche à l'écran en valeur du pH.



## Méthode chimique

Rouge de phénol

## Appendice

### Interférences

FR

#### Interférences exclues

1. Erreur de sel : Correction de la mesure du sel (valeurs moyennes) pour les échantillons présentant une concentration en sel de :

Concentration en sel de l'échantillon	Correction
30 g/L (eau de mer)	-0,15 <sup>1)</sup>
60 g/L	-0,21 <sup>2)</sup>
120 g/L	-0,26 <sup>2)</sup>
180 g/L	-0,29 <sup>2)</sup>
2. <sup>1)</sup>selon Kolthoff (1922) <sup>2)</sup>selon Parson et Douglas (1926)
3. Lors de l'analyse de l'eau chlorée, la concentration résiduelle en chlore peut influencer la coloration du réactif liquide. Ceci est empêché en introduisant un petit cristal de hiosulfate de sodium ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$ ) dans la solution d'échantillonnage avant d'ajouter la solution PHENOL RED.

### Bibliographie

Colorimetric Chemical Analytical Methods, 9th Edition, London

KS4.3 T / 20



**Denominazione metodo**

**Numero metodo**

**Codice a barre per riconoscere il metodo**

**Range di misura**

**K<sub>S4.3</sub> T**  
0.1 - 4 mmol/l K<sub>S4.3</sub>

**Acido/indicatore**

**Metodo chimico**

**Informazioni specifiche dello strumento**

Il test può essere eseguito sui seguenti dispositivi. Inoltre, sono indicate la cuvetta richiesta e il range di assorbimento del fotometro.

Dispositivi	Cuvetta	$\lambda$	Campo di misura
MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	$\varnothing$ 24 mm	610 nm	0.1 - 4 mmol/l K <sub>S4.3</sub>
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	$\varnothing$ 24 mm	615 nm	0.1 - 4 mmol/l K <sub>S4.3</sub>

**Materiale**

Materiale richiesto (in parte facoltativo):

Titolo	Unità di imballaggio	N. ordine
Alka-M-Photometer	Pastiglia / 100	513210BT
Alka-M-Photometer	Pastiglia / 250	513211BT

**Campo di applicazione**

- Trattamento acqua di scarico
- Trattamento acqua potabile
- Trattamento acqua non depurata

**Note**

1. I termini alcalinità M, valore M, alcalinità totale e capacità acida K<sub>S4.3</sub> sono equivalenti.
2. Per l'accuratezza del risultato dell'analisi è fondamentale che il volume del campione misuri esattamente 10 ml.

**ISO 639-1 codici linguistici**

**Stato di revisione**

IT Manuale dei Metodi 01/20

**Svolgimento della misurazione**

**Esecuzione della rilevazione Capacità acida K<sub>S4.3</sub> con pastiglia**

Selezionare il metodo nel dispositivo.

Con i seguenti dispositivi, per questo metodo non è necessario eseguire una misurazione ZERO: XD 7000, XD 7500




Riempire una cuvetta da 24 mm con **10 ml di campione**.



Chiudere la/e cuvetta/e. Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.




• • •




Aggiungere una pastiglia **ALKA-M-PHOTOMETER**.



Frantumare la/e pastiglia/e con una leggera rotazione.



Chiudere la/e cuvetta/e.



Alcalinità M T

M30

5 - 200 mg/L CaCO<sub>3</sub>

tA

Acido/indicatore

IT

**Materiale**

Materiale richiesto (in parte facoltativo):

Reagenti	Unità di imballaggio	N. ordine
Alka-M-Photometer	Pastiglia / 100	513210BT
Alka-M-Photometer	Pastiglia / 250	513211BT

**Note**


1. I termini alcalinità M, valore M, alcalinità totale e capacità acida K<sub>S4,3</sub> sono equivalenti.
2. Per l'accuratezza del risultato dell'analisi è fondamentale che il volume del campione misuri esattamente 10 ml.

## Esecuzione della rilevazione Alcalinità, totale = alcalinità M = valore M con pastiglia


Selezionare il metodo nel dispositivo.




Riempire una cuvetta da 24 mm con **10 mL** di campione.




Chiudere la/e cuvetta/e.



Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.




Premere il tasto **ZERO**.




Prelevare la cuvetta dal vano di misurazione.



Aggiungere una pastiglia **ALKA-M-PHOTOMETER**.




Frantumare la/e pastiglia/e con una leggera rotazione.




Chiudere la/e cuvetta/e.



IT



Far sciogliere la/e pastiglia/e agitando.




Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione.  
Fare attenzione al posizionamento.

## Test

Premere il tasto **TEST** (XD: **START**).

Sul display compare il risultato come alcalinità-m.



## Valutazione

La seguente tabella identifica i valori di output che possono essere convertiti in altre forme di citazione.

Unità di misura	Forma di citazione	Fattore di conversione
mg/l	CaCO <sub>3</sub>	1
	°dH	0.056
	°eH	0.07
	°fH	0.1
	°aH	0.058
	K <sub>S4.3</sub>	0.02

IT

## Metodo chimico

Acido/indicatore

## Appendice

Derivato di

EN ISO 9963-1

**Cloro T****M100****0.01 - 6.0 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL6****DPD**

IT

**Materiale**

Materiale richiesto (in parte facoltativo):

<b>Reagenti</b>	<b>Unità di imballaggio</b>	<b>N. ordine</b>
DPD No.1	Pastiglia / 100	511050BT
DPD No. 1	Pastiglia / 250	511051BT
DPD No. 1	Pastiglia / 500	511052BT
DPD No. 3	Pastiglia / 100	511080BT
DPD No. 3	Pastiglia / 250	511081BT
DPD No. 3	Pastiglia / 500	511082BT
DPD No. 1 Alto Calcio <sup>e)</sup>	Pastiglia / 100	515740BT
DPD No. 1 Alto Calcio <sup>e)</sup>	Pastiglia / 250	515741BT
DPD No. 1 Alto Calcio <sup>e)</sup>	Pastiglia / 500	515742BT
DPD No. 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Pastiglia / 100	515730BT
DPD No. 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Pastiglia / 250	515731BT
DPD No. 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Pastiglia / 500	515732BT
DPD No. 4	Pastiglia / 100	511220BT
DPD No. 4	Pastiglia / 250	511221BT
DPD No. 4	Pastiglia / 500	511222BT
DPD No. 3 Evo	Pastiglia / 100	511420BT
DPD No. 3 Evo	Pastiglia / 250	511421BT
DPD No. 3 Evo	Pastiglia / 500	511422BT
DPD No.4 Evo	Pastiglia / 100	511970BT
DPD No. 4 Evo	Pastiglia / 250	511971BT
DPD No. 4 Evo	Pastiglia / 500	511972BT

**Standards disponibles**

<b>Titolo</b>	<b>Unità di imballaggio</b>	<b>N. ordine</b>
ValidCheck Cloro 1,5 mg/l	1 pz.	48105510



## Prelievo del campione

1. Nella preparazione del campione occorre evitare la degassificazione del cloro, ad es. utilizzando pipette e agitando.
2. L'analisi deve essere eseguita subito dopo il prelievo del campione.

## Preparazione

1. Pulizia delle cuvette:  
Poiché molti detergenti ad uso domestico (ad es. detersivo per piatti) contengono sostanze riducenti, nella rilevazione del cloro si potrebbero ottenere risultati troppo bassi. Per escludere tali errori di misura è necessario che i dispositivi in vetro siano esenti dal consumo di cloro. I dispositivi in vetro inoltre vengono conservati in una soluzione di ipoclorito di sodio (0,1 g/L) per un'ora e successivamente vengono risciacquati abbondantemente con acqua demineralizzata.
2. Per la singola rilevazione del cloro libero e del cloro totale è opportuno utilizzare un apposito kit di cuvette per ciascuna procedura (vedere EN ISO 7393-2, par. 5.3).
3. Lo sviluppo della colorazione del DPD avviene con un valore di pH compreso tra 6,2 e 6,5. I reagenti contengono pertanto un tampone per la regolazione del valore di pH. Le acque fortemente alcaline o acide tuttavia devono essere portate prima dell'analisi entro un range di pH compreso tra 6 e 7 (con 0,5 mol/L di acido solforico o 1 mol/L di liscivia).

IT

## Note

1. Le compresse Evo possono essere utilizzate come alternativa alla corrispondente compressa standard (ad esempio DPD No. 3 Evo invece di DPD No. 3).




## Esecuzione della rilevazione Cloro, libero con compressa

Selezionare il metodo nel dispositivo.


IT




Riempire una cuvetta da 24 mm con **10 mL di campione**.




Chiudere la/e cuvetta/e.




Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.




Premere il tasto **ZERO**.




Prelevare la cuvetta dal vano di misurazione.



Svuotare la cuvetta finché non rimangono alcune gocce.





Aggiungere una pastiglia **DPD No. 1**.




Frantumare la/e pastiglia/e con una leggera rotazione.




Immettere il **campione** nella cuvetta fino a raggiungere la **tacca dei 10 mL**.



Chiudere la/e cuvetta/e.



Far sciogliere la/e pastiglia/e agitando.



Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.

IT

## Test

Premere il tasto **TEST** (XD:  
**START**).


Sul display compare il risultato in mg/L di Cloro libero.

### Esecuzione della rilevazione Cloro, totale con compressa


Selezionare il metodo nel dispositivo.



Riempire una cuvetta da 24 mm con **10 mL** di campione.



Chiudere la/e cuvetta/e.



Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.




# Zero

IT


Premere il tasto **ZERO**.

Prelevare la cuvetta dal vano di misurazione.


Svuotare la cuvetta finché non rimangono alcune gocce.



Aggiungere una pastiglia  
DPD No. 1.



Aggiungere una pastiglia  
DPD No. 3.



In alternativa al DPD No.  
1 e No. 3 tablet, un DPD  
No. 4 tablet può essere  
aggiunto.





Frantumare la/e pastiglia/e  
con una leggera rotazione.




Immettere il **campione**  
nella cuvetta fino a  
raggiungere la **tacca dei**  
**10 mL**.



Chiudere la/e cuvetta/e.




Far sciogliere la/e  
pastiglia/e agitando.



Posizionare la **cuvetta  
del campione** nel  
vano di misurazione.  
Fare attenzione al  
posizionamento.

## Test

Premere il tasto **TEST (XD:  
START)**.



Attendere un **tempo di  
reazione di 2 minuto/i**.

Allo scadere del tempo di reazione viene effettuata automaticamente la misurazione.  
Sul display compare il risultato in mg/L di Cloro totale.



## Metodo chimico

DPD

## Appendice

IT

### Interferenze

#### Interferenze permanenti

- Tutti gli ossidanti presenti nei campioni reagiscono come il cloro dando risultati troppo elevati.

#### Interferenze escludibili

- Le interferenze da parte di rame e ferro(III) devono essere eliminate con EDTA.
- In caso di campioni con un elevato tenore di calcio\* e/o un'elevata conducibilità\*, utilizzando le pastiglie di reagenti potrebbe verificarsi un intorbidimento del campione con conseguenti errori di misurazione. In questo caso si possono utilizzare in alternativa la pastiglia di reagente DPD No. 1 High Calcium e la pastiglia di reagente DPD No. 3 High Calcium.  
\*Non è possibile indicare i valori esatti in quanto l'intorbidimento dipende dal tipo e dalla composizione dell'acqua campione.
- Se si utilizzano pastiglie, le concentrazioni di cloro maggiori di 10 mg/L possono dare risultati entro il range di misura fino a 0 mg/L. Se la concentrazione di cloro è troppo elevata, il campione deve essere diluito con acqua priva di cloro. 10 mL del campione diluito vengono addizionati con il reagente e la misurazione viene ripetuta (test di plausibilità).

Interferenze	da / [mg/L]
CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	0.01
MnO <sub>2</sub>	0.01

### Validazione metodo

Limite di rilevabilità	0.02 mg/L
Limite di quantificazione	0.06 mg/L
Estremità campo di misura	6 mg/L
Sensibilità	2.05 mg/L / Abs
Intervallo di confidenza	0.04 mg/L
Deviazione standard della procedura	0.019 mg/L
Coefficiente di variazione della procedura	0.87 %

**Conforme**

EN ISO 7393-2

<sup>a)</sup>Determinazione di libero, vincolato, totale possibile | <sup>b)</sup>Reagente ausiliario, in alternativa a DPD n. 1 / no 3 in caso di torbidità del campione a causa di alto contenuto di ioni di calcio e / o alta condutività

IT

**Cloro L****M101****0.02 - 4.0 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL6****DPD**

IT

**Materiale**

Materiale richiesto (in parte facoltativo):


<b>Reagenti</b>	<b>Unità di imballaggio</b>	<b>N. ordine</b>
DPD 1 soluzione tampone, bottiglia blu	15 mL	471010
Soluzione tampone DPD 1	100 mL	471011
DPD 1 Soluzione tampone in confezione da 6	1 pz.	471016
DPD 1 soluzione reagente, bottiglia verde	15 mL	471020
Soluzione reagente DPD 1	100 mL	471021
DPD 1 Soluzione reagente in confezione da 6	1 pz.	471026
DPD 3 soluzione, bottiglia rossa	15 mL	471030
Soluzione DPD 3	100 mL	471031
DPD 3 Soluzione in confezione da 6	1 pz.	471036
Set di reagenti DPD	1 pz.	471056

**Standards disponibles**

<b>Titolo</b>	<b>Unità di imballaggio</b>	<b>N. ordine</b>
ValidCheck Cloro 1,5 mg/l	1 pz.	48105510

**Prelievo del campione**

1. Nella preparazione del campione occorre evitare la degassificazione del cloro, ad es. utilizzando pipette e agitando.
2. L'analisi deve essere eseguita subito dopo il prelievo del campione.



## Preparazione

1. Pulizia delle cuvette:  
Poiché molti detergenti ad uso domestico (ad es. detersivo per piatti) contengono sostanze riducenti, nella rilevazione del cloro si potrebbero ottenere risultati troppo bassi. Per escludere tali errori di misura è necessario che i dispositivi in vetro siano esenti dal consumo di cloro. I dispositivi in vetro inoltre vengono conservati in una soluzione di ipoclorito di sodio (0,1 g/L) per un'ora e successivamente vengono risciacquati abbondantemente con acqua demineralizzata.
2. Per la singola rilevazione del cloro libero e del cloro totale è opportuno utilizzare un apposito kit di cuvette per ciascuna procedura (vedere EN ISO 7393-2, par. 5.3).
3. Lo sviluppo della colorazione del DPD avviene con un valore di pH compreso tra 6,2 e 6,5. I reagenti contengono pertanto un tampone per la regolazione del valore di pH. Le acque fortemente alcaline o acide tuttavia devono essere portate prima dell'analisi entro un range di pH compreso tra 6 e 7 (con 0,5 mol/l di acido solforico o 1 mol/l di liscivia).

IT

## Note

1. Dopo l'uso bisogna richiudere immediatamente le boccette contagocce con i rispettivi tappi dello stesso colore.
2. Conservare al fresco il kit di reagenti a una temperatura compresa tra +6 °C e +10 °C.




## Esecuzione della rilevazione Cloro, libero con reagente liquido


Selezionare il metodo nel dispositivo.




Riempire una cuvetta da 24 mm con **10 mL di campione**.




Chiudere la/e cuvetta/e.




Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.




Premere il tasto **ZERO**.




Prelevare la cuvetta dal vano di misurazione.




Svuotare la cuvetta.



Tenere le boccette contagocce in posizione verticale e introdurre, premendo lentamente, gocce della stessa dimensione nella cuvetta.




Introdurre **6 gocce di DPD 1 Buffer Solution** nella cuvetta del campione.




Introdurre **2 gocce di DPD 1 Reagent Solution** nella cuvetta del campione.


IT




Immettere il **campione** nella cuvetta fino a raggiungere la tacca dei **10 mL**.




Chiudere la/e cuvetta/e.



Miscelare il contenuto capovolgendo.



Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.



Premere il tasto **TEST (XD: START)**.


Sul display compare il risultato in mg/L di Cloro libero.

### Esecuzione della rilevazione Cloro, totale con reagente liquido


Selezionare il metodo nel dispositivo.



Riempire una cuvetta da 24 mm con **10 mL** di **campione**.



Chiudere la/e cuvetta/e.



Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.



# Zero

IT

Premere il tasto **ZERO**.

Prelevare la cuvetta dal  
vano di misurazione.

Svuotare la cuvetta.



Tenere le boccette contagocce in posizione  
verticale e introdurre,  
premendo lentamente,  
gocce della stessa  
dimensione nella cuvetta.



Introdurre **6 gocce di DPD**  
**1 Buffer Solution** nella  
cuvetta del campione.




**6**

Introdurre **2 gocce di DPD**  
**1 Reagent Solution** nella  
cuvetta del campione.




**3**



Introdurre **3 gocce di DPD**  
**3 Solution** nella cuvetta  
del campione.




Immettere il **campione**  
nella cuvetta fino a  
raggiungere la **tacca dei**  
**10 mL**.




Chiudere la/e cuvetta/e.




Miscelare il contenuto capovolgendo.



Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione.  
Fare attenzione al posizionamento.



Premere il tasto **TEST** (XD: START).



Attendere un **tempo di reazione di 2 minuto/i**.

Allo scadere del tempo di reazione viene effettuata automaticamente la misurazione.

Sul display compare il risultato in mg/L di Cloro totale.



## Metodo chimico

DPD

## Appendice

IT

### Interferenze

#### Interferenze permanenti

- Tutti gli ossidanti presenti nei campioni reagiscono come il cloro dando risultati troppo elevati.

#### Interferenze escludibili

- Le interferenze da parte di rame e ferro(III) devono essere eliminate con EDTA.
- Se si utilizzano reagenti liquidi, le concentrazioni di cloro maggiori di 4 mg/L possono dare risultati entro il range di misura fino a 0 mg/L. In questo caso il campione deve essere diluito con acqua priva di cloro. 10 ml del campione diluito vengono addizionati con il reagente e la misurazione viene ripetuta (test di plausibilità).

Interferenze	da / [mg/L]
CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	0,01
MnO <sub>2</sub>	0,01

### Conforme

EN ISO 7393-2

<sup>a</sup>Determinazione di libero, vincolato, totale possibile



**Cloro HR T****M103****0.1 - 10 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL10****DPD**

IT


## Materiale

Materiale richiesto (in parte facoltativo):

Reagenti	Unità di imballaggio	N. ordine
DPD No. 1 HR	Pastiglia / 100	511500BT
DPD No. 1 HR	Pastiglia / 250	511501BT
DPD No. 1 HR	Pastiglia / 500	511502BT
DPD No.3 HR Evo	Pastiglia / 100	511920BT
DPD No. 3 HR Evo	Pastiglia / 250	511921BT
DPD No. 3 HR Evo	Pastiglia / 500	511922BT
DPD No. 3 HR	Pastiglia / 100	511590BT
DPD No. 3 HR	Pastiglia / 250	511591BT
DPD No. 3 HR	Pastiglia / 500	511592BT
Set DPD No. 1 HR/No. 3 HR <sup>#</sup>	ciascuna 100	517791BT
Set DPD No. 1 HR/No. 3 HR <sup>#</sup>	ciascuna 250	517792BT
DPD No. 1 Alto Calcio <sup>e)</sup>	Pastiglia / 100	515740BT
DPD No. 1 Alto Calcio <sup>e)</sup>	Pastiglia / 250	515741BT
DPD No. 1 Alto Calcio <sup>e)</sup>	Pastiglia / 500	515742BT
DPD No. 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Pastiglia / 100	515730BT
DPD No. 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Pastiglia / 250	515731BT
DPD No. 3 High Calcium <sup>e)</sup>	Pastiglia / 500	515732BT

## Prelievo del campione

1. Nella preparazione del campione occorre evitare la degassificazione del cloro, ad es. utilizzando pipette e agitando.
2. L'analisi deve essere eseguita subito dopo il prelievo del campione.



## Preparazione

1. Pulizia delle cuvette:  
Poiché molti detergenti ad uso domestico (ad es. detersivo per piatti) contengono sostanze riducenti, nella rilevazione del cloro si potrebbero ottenere risultati troppo bassi. Per escludere tali errori di misura è necessario che i dispositivi in vetro siano esenti dal consumo di cloro. I dispositivi in vetro inoltre vengono conservati in una soluzione di ipoclorito di sodio (0,1 g/L) per un'ora e successivamente vengono risciacquati abbondantemente con acqua demineralizzata.
2. Per la singola rilevazione del cloro libero e del cloro totale è opportuno utilizzare un apposito kit di cuvette per ciascuna procedura (vedere EN ISO 7393-2, par. 5.3).
3. Lo sviluppo della colorazione del DPD avviene con un valore di pH compreso tra 6,2 e 6,5. I reagenti contengono pertanto un tampone per la regolazione del valore di pH. Le acque fortemente alcaline o acide tuttavia devono essere portate prima dell'analisi entro un range di pH compreso tra 6 e 7 (con 0,5 mol/L di acido solforico o 1 mol/L di liscivia).

IT

## Note

1. Le compresse Evo possono essere utilizzate come alternativa alla corrispondente compressa standard (ad esempio DPD No. 3 Evo invece di DPD No. 3).




## Esecuzione della rilevazione Cloro HR, libero con compressa

Selezionare il metodo nel dispositivo.


IT




Riempire una cuvetta da 24 mm con **10 mL di campione**.




Chiudere la/e cuvetta/e.




Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.




Premere il tasto **ZERO**.




Prelevare la cuvetta dal vano di misurazione.



Svuotare la cuvetta finché non rimangono alcune gocce.





Aggiungere **una pastiglia DPD No. 1 HR**.




Frantumare la/e pastiglia/e con una leggera rotazione.




Immettere il **campione** nella cuvetta fino a raggiungere la **tacca dei 10 mL**.



Chiudere la/e cuvetta/e.



Far sciogliere la/e pastiglia/e agitando.



Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.

## Test


Premere il tasto **TEST** (XD:  
**START**).

Sul display compare il risultato in mg/L di Cloro libero.


### Esecuzione della rilevazione Cloro HR, totale con compressa

Selezionare il metodo nel dispositivo.


10 mL




Riempire una cuvetta da 24 mm con **10 mL** di campione.



Chiudere la/e cuvetta/e.



Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.




# Zero

IT


Premere il tasto **ZERO**.

Prelevare la cuvetta dal  
vano di misurazione.

Svuotare la cuvetta finché  
non rimangono alcune  
gocce.




Aggiungere una pastiglia  
DPD No. 1 HR .




Aggiungere una pastiglia  
DPD No. 3 HR .




Frantumare la/e pastiglia/e  
con una leggera rotazione.





Immettere il **campione**  
nella cuvetta fino a  
raggiungere la tacca dei  
**10 mL** .



Chiudere la/e cuvetta/e.




Far sciogliere la/e pastiglia/e  
agitando.



Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione.  
Fare attenzione al posizionamento.

## Test

Premere il tasto **TEST (XD: START)**.



Attendere un **tempo di reazione di 2 minuto/i**.

Allo scadere del tempo di reazione viene effettuata automaticamente la misurazione.  
Sul display compare il risultato in mg/L di Cloro totale.



## Metodo chimico

DPD

## Appendice

IT

### Interferenze

#### Interferenze permanenti

- Tutti gli ossidanti presenti nei campioni reagiscono come il cloro dando risultati troppo elevati.

#### Interferenze escludibili

- Le interferenze da parte di rame e ferro(III) devono essere eliminate con EDTA.
- In caso di campioni con un elevato tenore di calcio\* e/o un'elevata conducibilità\*, utilizzando le pastiglie di reagente potrebbe verificarsi un intorbidimento del campione con conseguenti errori di misurazione. In questo caso si possono utilizzare in alternativa la pastiglia di reagente DPD No. 1 High Calcium e la pastiglia di reagente DPD No. 3 High Calcium.

\*Non è possibile indicare i valori esatti in quanto l'intorbidimento dipende dal tipo e dalla composizione dell'acqua campione.

### Conforme

EN ISO 7393-2

<sup>a</sup>Determinazione di libero, vincolato, totale possibile | <sup>b</sup>Reagente ausiliario, in alternativa a DPD n. 1 / no 3 in caso di torbidità del campione a causa di alto contenuto di ioni di calcio e / o alta conduttività | <sup>c</sup>Bacchetta compresa



**Rame T****M150****0.05 - 5 mg/L Cu<sup>a)</sup>****Cu****Bichinolina**

IT

## Materiale

Materiale richiesto (in parte facoltativo):

<b>Reagenti</b>	<b>Unità di imballaggio</b>	<b>N. ordine</b>
Rame No. 1	Pastiglia / 100	513550BT
Rame No. 1	Pastiglia / 250	513551BT
Rame No. 2	Pastiglia / 100	513560BT
Rame No. 2	Pastiglia / 250	513561BT
Set Rame No. 1/no. 2 <sup>#</sup>	ciascuna 100	517691BT
Set Rame No. 1/no. 2 <sup>#</sup>	ciascuna 250	517692BT

## Preparazione

1. Le acque fortemente alcaline o acide dovrebbero essere regolate prima dell'analisi su un valore di pH da 4 a 6.


## Esecuzione della rilevazione Rame, libero con pastiglia

Selezionare il metodo nel dispositivo.


Selezionare inoltre la determinazione: libero




Riempire una cuvetta da 24 mm con **10 mL di campione**.




Chiudere la/e cuvetta/e.




Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.




Premere il tasto **ZERO**.




Prelevare la cuvetta dal vano di misurazione.



Aggiungere **una pastiglia COPPER No. 1**.




Frantumare la/e pastiglia/e con una leggera rotazione.




Chiudere la/e cuvetta/e.



IT




Far sciogliere la/e pastiglia/e agitando.



Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione.  
Fare attenzione al posizionamento.

## Test

Premere il tasto **TEST** (XD: START).



Attendere un **tempo di reazione** di 2 minuto/i .

Allo scadere del tempo di reazione viene effettuata automaticamente la misurazione.

Sul display compare il risultato in mg/L di Rame libero.


### Esecuzione della rilevazione Rame, totale con pastiglia

Selezionare il metodo nel dispositivo.


Selezionare inoltre la determinazione: totale




Riempire una cuvetta da 24 mm con **10 mL** di campione.



Chiudere la/e cuvetta/e.



Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.




# Zero

Premere il tasto **ZERO**.

Prelevare la cuvetta dal  
vano di misurazione.


IT



Aggiungere **una pastiglia COPPER No. 1.**




Frantumare e far sciogliere  
la/e pastiglia/e con una  
leggera rotazione.




Aggiungere **una pastiglia COPPER No. 2.**



Frantumare la/e pastiglia/e  
con una leggera rotazione.






Chiudere la/e cuvetta/e.



Far sciogliere la/e pastiglia/e  
agitando.



IT



Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione.  
Fare attenzione al posizionamento.

Premere il tasto **TEST** (XD: START).

Attendere un **tempo di reazione di 2 minuto/i**.

Allo scadere del tempo di reazione viene effettuata automaticamente la misurazione.

Sul display compare il risultato in mg/L di Rame totale.



## Metodo chimico

Bichinolina

## Appendice

### Interferenze

IT

#### Interferenze permanenti

1. Cianuro CN<sup>-</sup> e Argento Ag<sup>+</sup> interferiscono con la rilevazione.

### Validazione metodo

<b>Limite di rilevabilità</b>	0.05 mg/L
<b>Limite di quantificazione</b>	0.15 mg/L
<b>Estremità campo di misura</b>	5 mg/L
<b>Sensibilità</b>	3.8 mg/L / Abs
<b>Intervallo di confidenza</b>	0.026 mg/L
<b>Deviazione standard della procedura</b>	0.011 mg/L
<b>Coefficiente di variazione della procedura</b>	0.42 %

#### Riferimenti bibliografici

Photometrische Analyse, Lange/Vedjelek, Verlag Chemie 1980

<sup>a)</sup>Determinazione di libero, vincolato, totale possibile | <sup>b)</sup>Bacchetta compresa



CYA T

M160

10 - 160 mg/L CyA

CyA

Melammina

IT

## Materiale

Materiale richiesto (in parte facoltativo):


Reagenti	Unità di imballaggio	N. ordine
Test CyA	Pastiglia / 100	511370BT
Test CyA	Pastiglia / 250	511371BT
Acqua demineralizzata	100 mL	461275
Acqua demineralizzata	250 mL	457022

## Note


1. L'acido cianurico provoca un intorbidimento distribuito molto finemente dall'aspetto lattiginoso. Singole particelle non sono imputabili alla presenza di acido cianurico.

## Esecuzione della rilevazione Test acido cianurico con pastiglia


Selezionare il metodo nel dispositivo.




Riempire una cuvetta da 24 mm con **5 mL** di acqua demineralizzata.




Immettere **5 mL** di campione nella cuvetta.




Chiudere la/e cuvetta/e.




Posizionare la cuvetta del campione nel vano di misurazione.  
Fare attenzione al posizionamento.




Premere il tasto **ZERO**.




Prelevare la cuvetta dal vano di misurazione.



Aggiungere una pastiglia CyA-Test.




Frantumare la/e pastiglia/e con una leggera rotazione.



Chiudere la/e cuvetta/e.




IT



Miscelare il contenuto capovolgendo (per almeno 60 s fino al completo scioglimento della pastiglia).

Sul display compare il risultato in mg/L di acido cianurico .



Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione.  
Fare attenzione al posizionamento.

## Test

Premere il tasto **TEST (XD: START)**.



## Metodo chimico

Melammina

## Interferenze

### Interferenze permanenti

1. Le particelle non disciolte possono portare a risultati troppo elevati. Pertanto è importante sciogliere completamente le pastiglie.

**Ferro T****M220****0.02 - 1 mg/L Fe****FE****Ferrozine / acido tioglicolico**

IT

## Materiale

Materiale richiesto (in parte facoltativo):

Reagenti	Unità di imballaggio	N. ordine
Ferro II LR ( $\text{Fe}^{2+}$ )	Pastiglia / 100	515420BT
Ferro II LR ( $\text{Fe}^{2+}$ )	Pastiglia / 250	515421BT
Ferro LR ( $\text{Fe}^{2+}$ und $\text{Fe}^{3+}$ )	Pastiglia / 100	515370BT
Ferro LR ( $\text{Fe}^{2+}$ und $\text{Fe}^{3+}$ )	Pastiglia / 250	515371BT


## Preparazione

- Le acque che sono state trattate con composti organici che proteggono dalla corrosione devono essere eventualmente ossidate per disgregare i complessi di ferro. A tale scopo si addiziona un campione da 100 ml con 1 ml di acido solforico concentrato e 1 ml di acido nitrico concentrato e lo si fa evaporare fino alla metà. Dopo il raffreddamento viene eseguita la digestione.


## Note

- Con questo metodo viene rilevato il totale del  $\text{Fe}^{2+}$  e del  $\text{Fe}^{3+}$  disciolti.
- Per rilevare il  $\text{Fe}^{2+}$  si utilizza, invece della pastiglia IRON LR, la pastiglia IRON (II) LR.


## Digestione




Riempire un recipiente per campioni adeguato con **100 mL di campione**.




Aggiungere **1 mL di acido solforico concentrato**.




**Riscaldare il campione per 10 minuti** o finché non si sarà sciolto completamente.



Lasciar raffreddare il campione a **temperatura ambiente**.



Regolare il **valore di pH** del campione con **soluzione di ammoniaca su 3-5**.



Aggiungere al campione **acqua demineralizzata fino a raggiungere i 100 mL**.

Utilizzare questo campione per l'analisi di Ferro soluto e disciolto totale.

### Esecuzione della rilevazione Ferro(II,III), disciolto con pastiglia

Selezionare il metodo nel dispositivo.


Per la determinazione di **Ferro disciolto e non disciolto** eseguire la **digestione** descritta.




IT



Riempire una cuvetta da 24 mm con **10 mL** di campione.




Chiudere la/e cuvetta/e.




Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.

# Zero




Premere il tasto **ZERO**.


Prelevare la cuvetta dal vano di misurazione.





Aggiungere una pastiglia **IRON LR**.




Frantumare la/e pastiglia/e con una leggera rotazione.



Chiudere la/e cuvetta/e.




Far sciogliere la/e  
pastiglia/e agitando.



Posizionare la **cuvetta  
del campione** nel  
vano di misurazione.  
Fare attenzione al  
posizionamento.

## Test

Premere il tasto **TEST (XD:  
START)**.



Attendere un **tempo di  
reazione di 5 minuto/i**.

Allo scadere del tempo di reazione viene effettuata automaticamente la misurazione.  
Sul display compare il risultato in mg/L di Ferro.



## Metodo chimico

Ferrozine / acido tioglicolico

IT

## Appendice

### Interferenze

#### Interferenze escludibili

- La presenza di rame aumenta il risultato della misurazione del 10 %. Con una concentrazione di 10 mg/L di rame nel campione il risultato della misurazione viene aumentato di 1 mg/L di ferro.  
L'interferenza può essere eliminata con l'aggiunta di tiourea.

### Validazione metodo

<b>Limite di rilevabilità</b>	0.01 mg/L
<b>Limite di quantificazione</b>	0.016 mg/L
<b>Estremità campo di misura</b>	1 mg/L
<b>Sensibilità</b>	0.92 mg/L / Abs
<b>Intervallo di confidenza</b>	0.013 mg/L
<b>Deviazione standard della procedura</b>	0.005 mg/L
<b>Coefficiente di variazione della procedura</b>	1.23 %

#### Riferimenti bibliografici

Photometrische Analyse, Lange/Vjedelek, Verlag Chemie 1980, pag. 102



**Valore pH T****M330****6.5 - 8.4 pH****PH****Rosso fenolo**

IT


**Materiale**

Materiale richiesto (in parte facoltativo):

Reagenti	Unità di imballaggio	N. ordine
Fotometro rosso fenolo	Pastiglia / 100	511770BT
Fotometro rosso fenolo	Pastiglia / 250	511771BT
Fotometro rosso fenolo	Pastiglia / 500	511772BT

**Note**

1. Per la rilevazione fotometrica del valore di pH si devono utilizzare soltanto pastiglie PHENOL RED con etichetta nera contrassegnate con il termine PHOTOMETER.




## Esecuzione della rilevazione Valore pH con pastiglia


Selezionare il metodo nel dispositivo.




Riempire una cuvetta da 24 mm con **10 mL** di campione.




Chiudere la/e cuvetta/e.




Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.




Premere il tasto **ZERO**.




Prelevare la cuvetta dal vano di misurazione.



Aggiungere una pastiglia **PHENOL RED PHOTOMETER**.




Frantumare la/e pastiglia/e con una leggera rotazione.




Chiudere la/e cuvetta/e.



IT



Far sciogliere la/e pastiglia/e agitando.




Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione.  
Fare attenzione al posizionamento.

## Test

Premere il tasto **TEST** (XD: **START**).

Sul display compare il risultato come valore pH.



## Metodo chimico

Rosso fenolo

## Appendice

### Interferenze

IT

#### Interferenze permanenti

- I campioni di acqua con una bassa durezza carbonatica\* possono far ottenere valori di pH errati.  
\* $K_{S4,3} < 0,7 \text{ mmol/l} \triangleq$  alcalinità totale < 35 mg/L CaCO<sub>3</sub>.

#### Interferenze escludibili

- I valori di pH minori di 6,5 e maggiori di 8,4 possono dare risultati entro il range di misura. Si consiglia un test di plausibilità (misuratore di pH).
- Errore salino:  
Con una salinità fino a 2 g/L non è previsto alcun errore salino significativo dovuto alla salinità della pastiglia di reagente. Con salinità maggiori è necessario correggere i valori di misura nel modo seguente:

Salinità del campione in g/L	30 (acqua di mare)	60	120	180
Correzione	-0,15 <sup>1)</sup>	-0,21 <sup>2)</sup>	-0,26 <sup>2)</sup>	-0,29 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> secondo Kolthoff (1922)

<sup>2)</sup> secondo Parson e Douglas (1926)

#### Riferimenti bibliografici

Colorimetric Chemical Analytical Methods, 9th Edition, London

**Valore pH L****M331****6.5 - 8.4 pH****PH****Rosso fenolo**

IT

## **Materiale**

Materiale richiesto (in parte facoltativo):

<b>Reagenti</b>	<b>Unità di imballaggio</b>	<b>N. ordine</b>
Soluzione di rosso fenolo	15 mL	471040
Soluzione di rosso fenolo	100 mL	471041
Soluzione di rosso fenolo in confezione da 6	1 pz.	471046

## **Preparazione**

1. Per via della dimensione variabile delle gocce, il risultato della misurazione può presentare divergenze maggiori di quanto avvenga con l'uso delle pastiglie. Utilizzando una pipetta (0,18 ml corrispondono a 6 gocce) si può ridurre al minimo questa divergenza.

## **Note**


1. Dopo l'uso bisogna richiudere immediatamente la boccetta contagocce con il relativo tappo dello stesso colore.
2. Conservare al fresco il reagente a una temperatura compresa tra +6 °C e +10 °C.

## Esecuzione della rilevazione Valore pH con reagente liquido


Selezionare il metodo nel dispositivo.




Riempire una cuvetta da 24 mm con **10 mL** di campione.




Chiudere la/e cuvetta/e.




Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.




Premere il tasto **ZERO**.




Prelevare la cuvetta dal vano di misurazione.



Tenere le boccette contagocce in posizione verticale e introdurre, premendo lentamente, gocce della stessa dimensione nella cuvetta.



Introdurre **6 gocce di PHENOL Red-Lösung** nella cuvetta del campione.




**6**


Chiudere la/e cuvetta/e.



IT



Miscelare il contenuto capovolgendo.




Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione.  
Fare attenzione al posizionamento.

## Test

Premere il tasto **TEST** (XD: START).

Sul display compare il risultato come valore pH.



## Metodo chimico

Rosso fenolo

## Appendice

### Interferenze

IT

#### Interferenze escludibili

1. Errore salino: Correzione del valore di misura (valori medi) per i campioni con una salinità di:

Salinità del campione	Correzione
30 g/L (acqua di mare)	-0,15 <sup>1)</sup>
60 g/L	-0,21 <sup>2)</sup>
120 g/L	-0,26 <sup>2)</sup>
180 g/L	-0,29 <sup>2)</sup>
2. <sup>1)</sup>secondo Kolthoff (1922) <sup>2)</sup>secondo Parson e Douglas (1926)
3. Nell'analisi di acqua clorurata, il tenore di cloro residuo può influenzare la reazione cromatica del reagente liquido. Tale interferenza viene evitata immettendo un piccolo cristallo di tiosolfato di sodio ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$ ) nella soluzione campione prima di aggiungere la soluzione PHENOL RED.

#### Riferimenti bibliografici

Colorimetric Chemical Analytical Methods, 9th Edition, London

KS4.3 T / 20



**Nome do método**

**Número do método**

**Código de barras para a detecção dos métodos**

**Área de medição**

**Método Químico**

**Informação específica do instrumento**

O teste pode ser realizado nos seguintes dispositivos. Além disso, a cubeta necessária e a faixa de absorção do fotômetro são indicadas.

Dispositivos	Cubeta	$\lambda$	Faixa de Medição
MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	$\varnothing$ 24 mm	610 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	$\varnothing$ 24 mm	615 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$

**Indicado no display: MD 100  
MD 110 / MD 200**

**Material**

Material necessário (parcialmente opcional):

Título	Unidade de Embalagem	Artigo No
Alka-M-Photometer	Pastilhas / 100	513210BT
Alka-M-Photometer	Pastilhas / 250	513211BT

**Lista de Aplicações**

- Tratamento de Esgotos
- Tratamento de Água Potável
- Tratamento de Água Bruta

**Notas**

- Os termos alcalinidade-m, m-valor, alcalinidade total e capacidade de acidez  $K_{S4.3}$  são idênticos.
- O cumprimento exato do volume da amostra de 10 ml é decisivo para a precisão do resultado de análise.

**Códigos de idioma ISO 639-1**

**Nível de revisão**

PT Métodos Manual 01/20

**Efetuar a medição****Realização da determinação Capacidade de acidez  $K_{S4.3}$  com pastilha**

Escolher o método no equipamento.


Para este método não tem de ser efetuada uma medição ZERO nos seguintes equipamentos: XD 7000, XD 7500




Encher a célula de 24 mm com 10 ml de amostra .



Fechar a(s) célula(s).



Colocar a célula de amostra no compartimento de medição. Observar o posicionamento.



Pastilha ALKA-M-PHOTO- METER.



Esmagar a(s) pastilha(s) rodando ligeiramente.



Fechar a(s) célula(s).

**Alcalinidade-m T****M30****5 - 200 mg/L CaCO<sub>3</sub>****tA****Ácido / Indicador**

PT

**Material**

Material necessário (parcialmente opcional):

Reagentes	Unidade de Embalagem	Código do Produto
Alca-M-fotómetro	Pastilhas / 100	513210BT
Alca-M-fotómetro	Pastilhas / 250	513211BT

**Notas**


1. Os termos alcalinidade-m, m-valor, alcalinidade total e capacidade de acidez K<sub>S4.3</sub> são idênticos.
2. O cumprimento exato do volume da amostra de 10 ml é decisivo para a precisão do resultado de análise.

## Realização da determinação Alcalinidade, total= alcalinidade-m= m-valor com pastilha


Escolher o método no equipamento.




Encher a célula de 24 mm com **10 mL de amostra**.




Fechar a(s) célula(s).




Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.




Premir a tecla **ZERO**.




Retirar a célula do compartimento de medição.



**Pastilha ALKA-M-PHOTOMETER.**



Esmagar a(s) pastilha(s) rodando ligeiramente.




Fechar a(s) célula(s).


PT



PT



Dissolver a(s) pastilha(s) girando.




Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.

## Test

Premir a tecla **TEST (XD: START)**.

No visor aparece o resultado como Alcalinidade-m.



## Análises

A tabela a seguir identifica os valores de saída que podem ser convertidos em outras formas de citação.

Unidade	Forma de citação	Fator de conversão
mg/l	CaCO <sub>3</sub>	1
	°dH	0.056
	°eH	0.07
	°fH	0.1
	°aH	0.058
	K <sub>S4,3</sub>	0.02

PT

## Método Químico

Ácido / Indicador

## Apêndice

Derivado de

EN ISO 9963-1

**Cloro T****M100****0.01 - 6.0 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL6****DPD**

PT

**Material**

Material necessário (parcialmente opcional):

<b>Reagentes</b>	<b>Unidade de Embalagem</b>	<b>Código do Produto</b>
DPD Nº. 1	Pastilhas / 100	511050BT
DPD Nº. 1	Pastilhas / 250	511051BT
DPD Nº. 1	Pastilhas / 500	511052BT
DPD Nº. 3	Pastilhas / 100	511080BT
DPD Nº. 3	Pastilhas / 250	511081BT
DPD Nº. 3	Pastilhas / 500	511082BT
DPD Nº. 1 Alto Cálcio <sup>a)</sup>	Pastilhas / 100	515740BT
DPD Nº. 1 Alto Cálcio <sup>a)</sup>	Pastilhas / 250	515741BT
DPD Nº. 1 Alto Cálcio <sup>a)</sup>	Pastilhas / 500	515742BT
DPD Nº. 3 Alto Cálcio <sup>a)</sup>	Pastilhas / 100	515730BT
DPD Nº. 3 Alto Cálcio <sup>a)</sup>	Pastilhas / 250	515731BT
DPD Nº. 3 Alto Cálcio <sup>a)</sup>	Pastilhas / 500	515732BT
DPD Nº. 4	Pastilhas / 100	511220BT
DPD Nº. 4	Pastilhas / 250	511221BT
DPD Nº. 4	Pastilhas / 500	511222BT
DPD Nº. 3 Evo	Pastilhas / 100	511420BT
DPD Nº. 3 Evo	Pastilhas / 250	511421BT
DPD Nº. 3 Evo	Pastilhas / 500	511422BT
DPD Nº. 4 Evo	Pastilhas / 100	511970BT
DPD Nº. 4 Evo	Pastilhas / 250	511971BT
DPD Nº. 4 Evo	Pastilhas / 500	511972BT

**Padrões disponíveis**

<b>Título</b>	<b>Unidade de Embalagem</b>	<b>Código do Produto</b>
ValidCheck Cloro 1,5 mg/l	1 pc.	48105510



## Amostragem

1. Na preparação da amostra é preciso evitar a libertação de gases de cloro, p. ex. através da pipetagem e agitação.
2. A análise tem de ser efetuada logo após a recolha da amostra.

## Preparação

- PT
1. Limpeza das células:  
Uma vez que muitos produtos de limpeza domésticos (p. ex. lava-louça) contêm substâncias redutoras, na determinação de cloro pode haver demasiadas reduções. Para excluir este erro de medição, os equipamentos de vidro não deviam ter a capacidade de absorção de cloro. Para esse efeito, os equipamentos de vidro são guardados por uma hora sob solução de hipoclorito de sódio (0,1 g/L) e depois devem ser bem enxaguados com água desmineralizada.
  2. Para a determinação individual de cloro livre e cloro total é conveniente usar respetivamente um conjunto próprio de células (ver EN ISO 7393-2, alínea 5.3).
  3. A formação de cores DPD ocorre com um valor pH entre 6,2 e 6,5. Os reagentes contêm, por isso, um tampão para ajustar o valor pH. As águas fortemente alcalinas ou ácidas devem, porém, antes da análise, ser ajustadas para um valor pH entre 6 e 7 (com 0,5 mol/L de ácido sulfúrico ou 1 mol/L soda cáustica).

## Notas


1. Os pastilhas Evo podem ser utilizadas como alternativa à pastilha padrão correspondente (por exemplo, DPD Nº 3 Evo em vez da DPD Nº 3).



## Realização da determinação Cloro livre com pastilha

Escolher o método no equipamento.

**10 mL**



Encher a célula de 24 mm com **10 mL de amostra**.



Fechar a(s) célula(s).



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.

**Zero**




Premir a tecla **ZERO**.

Retirar a célula do compartimento de medição.



Esvaziar a célula até ficarem apenas algumas gotas.




**Pastilha DPD No. 1.**




Esmagar a(s) pastilha(s) rodando ligeiramente.




Encher a célula até à **marca de 10 mL** com a **amostra**.



Fechar a(s) célula(s).



Dissolver a(s) pastilha(s) girando.



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.

## Test


Premir a tecla TEST (XD: START).

No visor aparece o resultado em mg/L Cloro livre.


### Realização da determinação Cloro total com pastilha

Escolher o método no equipamento.


10 mL



Encher a célula de 24 mm com **10 mL de amostra**.



Fechar a(s) célula(s).



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.




# Zero

PT


Premir a tecla **ZERO**.

Retirar a célula do  
compartimento de  
medição.


Esvaziar a célula até ficarem  
apenas algumas gotas.



**Pastilha DPD No. 1.**



**Pastilha DPD No. 3.**



**Como alternativa aos  
comprimidos DPD No. 1 e  
No. 3, pode ser adicionado  
1 comprimido DPD No. 4.**





Esmagar a(s) pastilha(s)  
rodando ligeiramente.




Encher a célula até à  
marca de 10 mL com a  
amostra .




Fechar a(s) célula(s).




Dissolver a(s) pastilha(s) girando.



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.



Premir a tecla **TEST (XD: START)**.



Aguardar **2 minuto(s) de tempo de reação**.

Decorrido o tempo de reação, a medição é efetuada automaticamente.

No visor aparece o resultado em mg/L Cloro total.



## Método Químico

DPD

## Apêndice

PT

### Texto de Interferências

#### Interferências Persistentes

- Todos os oxidantes presentes nas amostras reagem como o cloro, o que leva a resultados demasiado altos.

#### Interferências Removíveis

- As interferências por cobre e ferro(III) devem ser eliminadas por EDTA.
- Nas amostras com elevado teor de cálcio\* e/ou elevada condutividade\* pode ocorrer, se forem usadas as pastilhas de reagente, uma turvação da amostra e, por conseguinte, a medição pode ficar errada. Neste caso, deve usar em alternativa a pastilha de reagente DPD No. 1 High Calcium e a pastilha de reagente DPD No. 3 High Calcium.  
\*não podem ser indicados valores exatos, uma vez que a formação de uma turvação depende do tipo e da composição da água da amostra.
- Concentrações de cloro superiores a 10 mg/L, se forem usadas pastilhas, podem causar resultados dentro da área de medição até 0 mg/L. No caso de uma concentração demasiado alta de cloro, deve diluir a amostra com água sem cloro. 10 mL da amostra diluída é colocada em reagente e a medição é repetida (teste de plausibilidade).

Interferências	a partir de / [mg/L]
<chem>CrO4^2-</chem>	0.01
<chem>MnO2</chem>	0.01

### Validação de método

Limite de Detecção	0.02 mg/L
Limite de Determinação	0.06 mg/L
Fim da Faixa de Medição	6 mg/L
Sensibilidade	2.05 mg/L / Abs
Faixa de Confiança	0.04 mg/L
Desvio Padrão	0.019 mg/L
Coeficiente de Variação	0.87 %

### Conformidade

EN ISO 7393-2



<sup>a)</sup>Determinação do possível livre, vinculado, total | <sup>b)</sup>Reagente auxiliar, alternativamente ao DPD no. 1 / não 3 quando a amostra é nublada devido ao alto teor de íons de cálcio e / ou alta condutividade

PT

**Cloro L****M101****0.02 - 4.0 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL6****DPD**

PT

## **Material**

Material necessário (parcialmente opcional):


<b>Reagentes</b>	<b>Unidade de Embalagem</b>	<b>Código do Produto</b>
DPD 1 solução tampão, frasco azul	15 mL	471010
Solução tampão DPD 1	100 mL	471011
DPD 1 solução tampão em embalagem de 6	1 pc.	471016
Solução de reagente DPD 1, frasco verde	15 mL	471020
Solução de reagente DPD 1	100 mL	471021
Solução de reagente DPD 1 numa embalagem de 6 unidades	1 pc.	471026
DPD 3 Solução, frasco vermelho	15 mL	471030
Solução DPD 3	100 mL	471031
Solução DPD 3 numa embalagem de 6 unidades	1 pc.	471036
Kit de reagentes DPD	1 pc.	471056

## **Padrões disponíveis**

<b>Título</b>	<b>Unidade de Embalagem</b>	<b>Código do Produto</b>
ValidCheck Cloro 1,5 mg/l	1 pc.	48105510

## **Amostragem**

1. Na preparação da amostra é preciso evitar a libertação de gases de cloro, p. ex. através da pipetagem e agitação.
2. A análise tem de ser efetuada logo após a recolha da amostra.



## Preparação

1. Limpeza das células:  
Uma vez que muitos produtos de limpeza domésticos (p. ex. lava-louça) contêm substâncias redutoras, na determinação de cloro pode haver demasiadas reduções. Para excluir este erro de medição, os equipamentos de vidro não deviam ter a capacidade de absorção de cloro. Para esse efeito, os equipamentos de vidro são guardados por uma hora sob solução de hipoclorito de sódio (0,1 g/L) e depois devem ser bem enxaguados com água desmineralizada.
2. Para a determinação individual de cloro livre e cloro total é conveniente usar respetivamente um conjunto próprio de células (ver EN ISO 7393-2, alínea 5.3).
3. A formação de cores DPD ocorre com um valor pH entre 6,2 e 6,5. Os reagentes contêm, por isso, um tampão para ajustar o valor pH. As águas fortemente alcalinas ou ácidas devem, porém, antes da análise, ser ajustadas para um valor pH entre 6 e 7 (com 0,5 mol/l de ácido sulfúrico ou 1 mol/l soda cáustica).

## Notas

1. Depois de usados, os frascos conta-gotas devem ser novamente fechados com a respetiva tampa de enroscar à cor.
2. Guardar o conjunto de reagentes em local fresco entre +6 °C e +10 °C.




## Realização da determinação Cloro livre com reagente líquido

Escolher o método no equipamento.


PT




Encher a célula de 24 mm com **10 mL de amostra**.




Fechar a(s) célula(s).




Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.




Premir a tecla **ZERO**.




Retirar a célula do compartimento de medição.




Esvaziar a célula.




Manter os frascos conta gotas na vertical e pressionar lentamente para adicionar gotas de igual dimensão.




Adicionar **6 gotas DPD 1 Buffer Solution** à célula de amostra.




Adicionar **2 gotas DPD 1 Reagent Solution** à célula de amostra.




Encher a célula até à marca de 10 mL com a amostra.




Fechar a(s) célula(s).



Misturar o conteúdo girando.



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.



Premir a tecla TEST (XD: START).


No visor aparece o resultado em mg/L Cloro livre.

### Realização da determinação Cloro total com reagente líquido


Escolher o método no equipamento.




Encher a célula de 24 mm com **10 mL de amostra**.



Fechar a(s) célula(s).



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.



# Zero

PT

Premir a tecla **ZERO**.Retirar a célula do  
compartimento de  
medição.

Esvaziar a célula.



Manter os frascos conta gotas na vertical e pressionar lentamente para adicionar gotas de igual dimensão.

Adicionar **6 gotas DPD 1 Buffer Solution** à célula de amostra.


**6**

Adicionar **2 gotas DPD 1 Reagent Solution** à célula de amostra.



**2**

Adicionar **3 gotas DPD 3 Solution** à célula de amostra.


Encher a célula até à marca de **10 mL** com a amostra .

**3**


Fechar a(s) célula(s).




Misturar o conteúdo girando.



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.



Premir a tecla **TEST (XD: START)**.



Aguardar **2 minuto(s) de tempo de reação**.

Decorrido o tempo de reação, a medição é efetuada automaticamente.

No visor aparece o resultado em mg/L Cloro total.



## Método Químico

DPD

## Apêndice

PT

### Texto de Interferências

#### Interferências Persistentes

- Todos os oxidantes presentes nas amostras reagem como o cloro, o que leva a resultados demasiado altos.

#### Interferências Removíveis

- As interferências por cobre e ferro(III) devem ser eliminadas por EDTA.
- Concentrações de cloro superiores a 4 mg/L, se forem usados reagentes líquidos, podem causar resultados dentro da área de medição até 0 mg/L. Neste caso, deve diluir a amostra com água sem cloro. 10 ml da amostra diluída é colocada em reagente e a medição é repetida (teste de plausibilidade).

Interferências	a partir de / [mg/L]
CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	0,01
MnO <sub>2</sub>	0,01

#### Conformidade

EN ISO 7393-2

<sup>a</sup>Determinação do possível livre, vinculado, total



**Cloro HR T****M103****0.1 - 10 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL10****DPD**

PT

## Material

Material necessário (parcialmente opcional):

Reagentes	Unidade de Embalagem	Código do Produto
DPD Nº. 1 HR	Pastilhas / 100	511500BT
DPD Nº. 1 HR	Pastilhas / 250	511501BT
DPD Nº. 1 HR	Pastilhas / 500	511502BT
DPD Nº.3 HR Evo	Pastilhas / 100	511920BT
DPD Nº. 3 HR Evo	Pastilhas / 250	511921BT
DPD Nº. 3 HR Evo	Pastilhas / 500	511922BT
DPD Nº. 3 HR	Pastilhas / 100	511590BT
DPD Nº. 3 HR	Pastilhas / 250	511591BT
DPD Nº. 3 HR	Pastilhas / 500	511592BT
Definir N.º DPD 1 HR/No. 3 HR <sup>#</sup>	cada 100	517791BT
Definir N.º DPD 1 HR/No. 3 HR <sup>#</sup>	cada 250	517792BT
DPD Nº. 1 Alto Cálcio <sup>(e)</sup>	Pastilhas / 100	515740BT
DPD Nº. 1 Alto Cálcio <sup>(e)</sup>	Pastilhas / 250	515741BT
DPD Nº. 1 Alto Cálcio <sup>(e)</sup>	Pastilhas / 500	515742BT
DPD Nº. 3 Alto Cálcio <sup>(e)</sup>	Pastilhas / 100	515730BT
DPD Nº. 3 Alto Cálcio <sup>(e)</sup>	Pastilhas / 250	515731BT
DPD Nº. 3 Alto Cálcio <sup>(e)</sup>	Pastilhas / 500	515732BT

## Amostragem

- Na preparação da amostra é preciso evitar a libertação de gases de cloro, p. ex. através da pipetagem e agitação.
- A análise tem de ser efetuada logo após a recolha da amostra.



## Preparação

1. Limpeza das células:  
Uma vez que muitos produtos de limpeza domésticos (p. ex. lava-louça) contêm substâncias redutoras, na determinação de cloro pode haver demasiadas reduções. Para excluir este erro de medição, os equipamentos de vidro não deviam ter a capacidade de absorção de cloro. Para esse efeito, os equipamentos de vidro são guardados por uma hora sob solução de hipoclorito de sódio (0,1 g/L) e depois devem ser bem enxaguados com água desmineralizada.
2. Para a determinação individual de cloro livre e cloro total é conveniente usar respetivamente um conjunto próprio de células (ver EN ISO 7393-2, alínea 5.3).
3. A formação de cores DPD ocorre com um valor pH entre 6,2 e 6,5. Os reagentes contêm, por isso, um tampão para ajustar o valor pH. As águas fortemente alcalinas ou ácidas devem, porém, antes da análise, ser ajustadas para um valor pH entre 6 e 7 (com 0,5 mol/L de ácido sulfúrico ou 1 mol/L soda cáustica).

## Notas

1. Os pastilhas Evo podem ser utilizadas como alternativa à pastilha padrão correspondente (por exemplo, DPD Nº 3 Evo em vez da DPD Nº 3).



## Realização da determinação Cloro HR livre com pastilha

Escolher o método no equipamento.


**10 mL**



Encher a célula de 24 mm com **10 mL de amostra**.



Fechar a(s) célula(s).



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.

**Zero**




Premir a tecla **ZERO**.

Retirar a célula do compartimento de medição.



Esvaziar a célula até ficarem apenas algumas gotas.





**Pastilha DPD No. 1 HR .**




Esmagar a(s) pastilha(s) rodando ligeiramente.




Encher a célula até à marca de **10 mL** com a **amostra**.



Fechar a(s) célula(s).



Dissolver a(s) pastilha(s) girando.



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.

## Test


Premir a tecla TEST (XD:  
**START**).

No visor aparece o resultado em mg/L Cloro livre.

### Realização da determinação Cloro HR total com pastilha

Escolher o método no equipamento.


10 mL



Encher a célula de 24 mm com **10 mL de amostra**.



Fechar a(s) célula(s).



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.




# Zero

PT


Premir a tecla **ZERO**.

Retirar a célula do  
compartimento de  
medição.

Esvaziar a célula até ficarem  
apenas algumas gotas.




**Pastilha DPD No. 1 HR .**




**Pastilha DPD No. 3 HR .**




Esmagar a(s) pastilha(s)  
rodando ligeiramente.





Encher a célula até à  
marca de **10 mL** com a  
amostra .



Fechar a(s) célula(s).




Dissolver a(s) pastilha(s)  
girando.



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.

## Test

Premir a tecla **TEST** (XD: **START**).



Aguardar **2 minuto(s)** de tempo de reação.

Decorrido o tempo de reação, a medição é efetuada automaticamente.

No visor aparece o resultado em mg/L Cloro total.

PT



## Método Químico

DPD

## Apêndice

PT

### Texto de Interferências

#### Interferências Persistentes

- Todos os oxidantes presentes nas amostras reagem como o cloro, o que leva a resultados demasiado altos.

#### Interferências Removíveis

- As interferências por cobre e ferro(III) devem ser eliminadas por EDTA.
- Nas amostras com elevado teor de cálcio\* e/ou elevada condutividade\* pode ocorrer, se forem usadas as pastilhas de reagente, uma turvação da amostra e, por conseguinte, a medição pode ficar errada. Neste caso, deve usar em alternativa a pastilha de reagente DPD No. 1 High Calcium e a pastilha de reagente DPD No. 3 High Calcium.

\*não podem ser indicados valores exatos, uma vez que a formação de uma turvação depende do tipo e da composição da água da amostra.

### Conformidade

EN ISO 7393-2

<sup>a</sup>Determinação do possível livre, vinculado, total | <sup>b</sup>Reagente auxiliar, alternativamente ao DPD no. 1 / não 3 quando a amostra é nublada devido ao alto teor de íons de cálcio e / ou alta condutividade | <sup>c</sup>Incluindo vareta de agitação



**Cobre T****M150****0.05 - 5 mg/L Cu<sup>a)</sup>****Cu****Biquinoline**

PT

## Material

Material necessário (parcialmente opcional):

Reagentes	Unidade de Embalagem	Código do Produto
Cobre Não. 1	Pastilhas / 100	513550BT
Cobre Não. 1	Pastilhas / 250	513551BT
Cobre Não. 2	Pastilhas / 100	513560BT
Cobre Não. 2	Pastilhas / 250	513561BT
Definir número de cobre 1/Não. 2 <sup>#</sup>	cada 100	517691BT
Definir número de cobre 1/Não. 2 <sup>#</sup>	cada 250	517692BT

## Preparação

- As águas fortemente alcalinas ou ácidas deviam, antes da análise, ser ajustadas para um valor pH de 4 a 6.


## Realização da determinação Cobre, livre com pastilha

Escolher o método no equipamento.


Escolha ainda a determinação: livre




Encher a célula de 24 mm com **10 mL de amostra**.




Fechar a(s) célula(s).




Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.




Premir a tecla **ZERO**.




Retirar a célula do compartimento de medição.




**Pastilha COPPER No. 1.**



Esmagar a(s) pastilha(s) rodando ligeiramente.



Fechar a(s) célula(s).




PT

Dissolver a(s) pastilha(s) girando.



## Test

Premir a tecla TEST (XD: START).



Aguardar 2 minuto(s) de tempo de reação.

Decorrido o tempo de reação, a medição é efetuada automaticamente.

No visor aparece o resultado em mg/L Cobre livre.


### Realização da determinação Cobre, total com pastilha

Escolher o método no equipamento.


Escolha ainda a determinação: total




Encher a célula de 24 mm com 10 mL de amostra .



Fechar a(s) célula(s).



Colocar a célula de amostra no compartimento de medição. Observar o posicionamento.




# Zero

Premir a tecla **ZERO**.

Retirar a célula do  
compartimento de medição.


PT




**Pastilha COPPER No. 1.**




Esmagar a(s) pastilha(s)  
rodando ligeiramente e  
dissolver.




**Pastilha COPPER No. 2.**




Esmagar a(s) pastilha(s)  
rodando ligeiramente.




Fechar a(s) célula(s).



Dissolver a(s) pastilha(s)  
girando.




PT



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.

# Test

Premir a tecla **TEST** (XD: **START**).



Aguardar **2 minuto(s)** de tempo de reação.

Decorrido o tempo de reação, a medição é efetuada automaticamente.

No visor aparece o resultado em mg/L Cobre total.



## Método Químico

Biquinoline

## Apêndice

### Texto de Interferências

PT

#### Interferências Persistentes

1. Cianeto CN<sup>-</sup> e Prata Ag<sup>+</sup> interferem a determinação.

### Validação de método

<b>Limite de Detecção</b>	0.05 mg/L
<b>Limite de Determinação</b>	0.15 mg/L
<b>Fim da Faixa de Medição</b>	5 mg/L
<b>Sensibilidade</b>	3.8 mg/L / Abs
<b>Faixa de Confiança</b>	0.026 mg/L
<b>Desvio Padrão</b>	0.011 mg/L
<b>Coeficiente de Variação</b>	0.42 %

### Bibliografia

Análise fotométrica, Lange/Vjedelek, Verlag Chemie 1980

<sup>a)</sup>Determinação do possível livre, vinculado, total | \*incluindo vareta de agitação



CyA T

M160

10 - 160 mg/L CyA

CyA

Melamine

PT

## Material

Material necessário (parcialmente opcional):


Reagentes	Unidade de Embalagem	Código do Produto
Teste CyA	Pastilhas / 100	511370BT
Teste CyA	Pastilhas / 250	511371BT
água desmineralizada	100 mL	461275
água desmineralizada	250 mL	457022

## Notas


1. O ácido cianúrico causa uma turvação muito finamente distribuída com aspecto leitoso. A presença de algumas partículas não remete para a presença de ácido cianúrico.

## Realização da determinação Teste de ácido cianúrico com pastilha


Escolher o método no equipamento.




Encher a célula de 24 mm com **5 mL** de água desmineralizada.




Adicionar **5 mL** de amostra à célula.




Fechar a(s) célula(s).




Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.




Premir a tecla **ZERO**.




Retirar a célula do compartimento de medição.



**Pastilha CyA-Test.**



Esmagar a(s) pastilha(s) rodando ligeiramente.




Fechar a(s) célula(s).

PT




PT



Misturar o conteúdo girando (durante pelo menos 60 s até que o pastilha esteja completamente dissolvido).


No visor aparece o resultado em mg/L ácido cianúrico.



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.

## Test

Premir a tecla **TEST (XD: START)**.



## Método Químico

Melamine

### Texto de Interferências

#### Interferências Persistentes

1. Partículas não dissolvidas podem causar resultados demasiado altos. Por isso, é importante dissolver totalmente as pastilhas.

PT

**Ferro T****M220****0.02 - 1 mg/L Fe****FE****Ferrozine / Thioglycolate**

PT

## Material

Material necessário (parcialmente opcional):


Reagentes	Unidade de Embalagem	Código do Produto
Iron II LR ( $\text{Fe}^{2+}$ )	Pastilhas / 100	515420BT
Iron II LR ( $\text{Fe}^{2+}$ )	Pastilhas / 250	515421BT
Iron LR ( $\text{Fe}^{2+}$ und $\text{Fe}^{3+}$ )	Pastilhas / 100	515370BT
Iron LR ( $\text{Fe}^{2+}$ und $\text{Fe}^{3+}$ )	Pastilhas / 250	515371BT

## Preparação


- As águas que foram tratadas com compostos orgânicos como proteção anticorrosiva, etc. têm de ser eventualmente oxidadas para destruir os complexos de ferro. Para isso, transfere-se uma amostra de 100 ml com 1 ml de ácido sulfúrico concentrado e 1 ml de ácido nítrico concentrado e evaporada para metade. Depois de arrefecer, passa-se à digestão.

## Notas


- Neste método ocorre a determinação de  $\text{Fe}^{2+}$  e  $\text{Fe}^{3+}$  totalmente dissolvido.
- Para determinar  $\text{Fe}^{2+}$  usa-se a pastilha IRON (II) LR, em vez da pastilha IRON LR.




## Digestão




Encher um recipiente de amostra adequado com **100 mL de amostra**.




Adicionar **1 mL ácido sulfúrico concentrado**.




A amostra deve aquecer durante **10 minutos**, ou até tudo se ter totalmente dissolvido.



Deixar a amostra arrefecer até à **temperatura ambiente**.



Ajustar o **valor pH da amostra com solução amoniacal para 3-5**.




Encher a amostra com **água desmineralizada até 100 mL**.

Usar esta amostra para a análise de total de ferro solvido e dissolvido.

## Realização da determinação Ferro(II,III), dissolvido com pastilha

Escolher o método no equipamento.

Para a determinação de **Ferro dissolvido e não dissolvido** deve realizar a **digestão** descrita.

**10 mL**

PT

Encher a célula de 24 mm com **10 mL de amostra**.



Fechar a(s) célula(s).




Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.

**Zero**

Premir a tecla **ZERO**.


Retirar a célula do compartimento de medição.





**Pastilha IRON LR.**




Esmagar a(s) pastilha(s) rodando ligeiramente.




Fechar a(s) célula(s).




Dissolver a(s) pastilha(s) girando.



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.



Premir a tecla **TEST (XD: START)**.



Aguardar **5 minuto(s) de tempo de reação**.

Decorrido o tempo de reação, a medição é efetuada automaticamente.

No visor aparece o resultado em mg/L Ferro.

PT



## Método Químico

Ferrozine / Thioglycolate

PT

## Apêndice

### Texto de Interferências

#### Interferências Removíveis

1. A presença de cobre aumenta o resultado de medição em 10 %. Numa concentração de 10 mg/L de cobre na amostra, o resultado de medição aumenta em 1 mg/L de ferro.  
A interferência pode ser eliminada com a adição de tioureia

### Validação de método

<b>Limite de Detecção</b>	0.01 mg/L
<b>Limite de Determinação</b>	0.016 mg/L
<b>Fim da Faixa de Medição</b>	1 mg/L
<b>Sensibilidade</b>	0.92 mg/L / Abs
<b>Faixa de Confiança</b>	0.013 mg/L
<b>Desvio Padrão</b>	0.005 mg/L
<b>Coeficiente de Variação</b>	1.23 %

### Bibliografia

Análise fotométrica, Lange/ Vjedelek, Verlag Chemie 1980, S. 102



**Valor pH T****M330****6.5 - 8.4 pH****PH****Phenol Red**

PT


## Material

Material necessário (parcialmente opcional):

Reagentes	Unidade de Embalagem	Código do Produto
Fotómetro Fenol Vermelho	Pastilhas / 100	511770BT
Fotómetro Fenol Vermelho	Pastilhas / 250	511771BT
Fotómetro Fenol Vermelho	Pastilhas / 500	511772BT

## Notas

1. Para a determinação fotométrica do valor pH deve usar somente pastilhas PHENOL RED com impressão de película preta, que estão identificadas com o termo PHOTOMETER.




## Realização da determinação Valor pH com pastilha


Escolher o método no equipamento.




Encher a célula de 24 mm com **10 mL de amostra**.




Fechar a(s) célula(s).




Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.




Premir a tecla **ZERO**.




Retirar a célula do compartimento de medição.



**Pastilha PHENOL RED PHOTOMETER.**




Esmagar a(s) pastilha(s) rodando ligeiramente.




Fechar a(s) célula(s).




PT



Dissolver a(s) pastilha(s) girando.




Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.



Premir a tecla **TEST (XD: START)**.

No visor aparece o resultado como valor pH.



## Método Químico

Phenol Red

## Apêndice

### Texto de Interferências

PT

#### Interferências Persistentes

- As amostras de água com baixa dureza de carbonato\* podem obter valores pH incorretos.  
 $K_{S4,3} < 0,7 \text{ mmol/l} \triangleq \text{Alcalinidade total} < 35 \text{ mg/L CaCO}_3$ .

#### Interferências Removíveis

- Os valores pH inferiores a 6,5 e superiores a 8,4 podem causar resultados dentro da área de medição. Recomenda-se um teste de plausibilidade (medidor de pH).
- Ero de sal:  
No caso de teores de sal até 2 g/L não é expectável nenhum erro de sal significativo devido ao teor de sal da pastilha de reagente. No caso de teores de sal superiores, deve corrigir os valores de medição do seguinte modo:

Teor de sal da amostra emg/L	30 (água do mar)	60	120	180
Correção	-0,15 <sup>1)</sup>	-0,21 <sup>2)</sup>	-0,26 <sup>2)</sup>	-0,29 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> segundo Kolthoff (1922)

<sup>2)</sup> segundo Parson e Douglas (1926)

#### Bibliografia

Colorimetric Chemical Analytical Methods, 9th Edition, London

**Valor pH L****M331****6.5 - 8.4 pH****PH****Phenol Red**

PT

## **Material**

Material necessário (parcialmente opcional):


<b>Reagentes</b>	<b>Unidade de Embalagem</b>	<b>Código do Produto</b>
Solução de vermelho fenol	15 mL	471040
Solução de vermelho fenol	100 mL	471041
Solução de vermelho fenol em embalagem de -6	1 pc.	471046

## **Preparação**

1. Devido aos diferentes tamanhos de gotas, o resultado de medição pode apresentar desvios maiores do que ao utilizar pastilhas.  
Se utilizar uma pipeta (0,18 ml corresponde a 6 gotas) pode reduzir este desvio.

## **Notas**

1. Depois de usado, o frasco conta-gotas deve ser novamente fechado com a respetiva tampa de enroscar à cor.
2. Guardar o reagente em local fresco entre +6 °C e +10 °C.




## Realização da determinação Valor pH com reagente líquido


Escolher o método no equipamento.




Encher a célula de 24 mm com **10 mL de amostra**.




Fechar a(s) célula(s).




Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.




Premir a tecla **ZERO**.




Retirar a célula do compartimento de medição.



Manter os frascos conta gotas na vertical e pressionar lentamente para adicionar gotas de igual dimensão.




Adicionar **6 gotas PHENOL Red-Lösung** à célula de amostra.




Fechar a(s) célula(s).



PT



Misturar o conteúdo girando.




Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.

## Test

Premir a tecla **TEST (XD: START)**.

No visor aparece o resultado como valor pH.



## Método Químico

Phenol Red

## Apêndice

### Texto de Interferências

PT

#### Interferências Removíveis

1. Erro de sal: Correção do valor de medição (valores médios) para amostras com um teor de sal de:

2.	Teor de sal da amostra	Correção
	30 g/L (água do mar)	-0,15 <sup>1)</sup>
	60 g/L	-0,21 <sup>2)</sup>
	120 g/L	-0,26 <sup>2)</sup>
	180 g/L	-0,29 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> segundo Kolthoff (1922)

<sup>2)</sup> segundo Parson e Douglas (1926)

3. Na análise de água clorada, o teor de cloro residual existente pode influenciar a reação de cor do reagente líquido. Isto é evitado, na medida em que se insere um pequeno cristal de tiossulfato de sódio ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$ ) na solução de amostra antes de ser adicionada a solução PHENOL RED.

#### Bibliografia

Colorimetric Chemical Analytical Methods, 9th Edition, London

**KS4.3 T / 20**

**Naam van de methode**

**Nummer methode**

**Streeppjescode ter identificatie van de methode**

**Meetbereik**

$K_{S4.3} T$   
0.1 - 4 mmol/l  $K_{S4.3}$

**Zuur / Indicator**

**Chemische methode**

**Instrumentspecifieke informatie**

De test kan op de volgende apparaten worden uitgevoerd. Bovendien worden de vereiste cuvette en het absorptiebereik van de fotometer aangegeven.

Toestellen	Cuvet	$\lambda$	Meetbereik
MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	ø 24 mm	610 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	615 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$

**Uitlezing in MD 100 MD 110 / MD 200**

**Reagentia**

Benodigd materiaal (deels optioneel):

Titel	Verpakkingseenheid	Bestelnr.
Alka-M-Photometer	Tablet / 100	513210BT
Alka-M-Photometer	Tablet / 250	513211BT

**Toepassingsbereik**

- Afvalwaterzuivering
- Behandeling drinkwater
- Zuivering vervuild water

**Aantekeningen**

- De termen alkalisiteit-m, m-waarde, totale alkaliteit en zuurcapaciteit<sub>K<sub>S4.3</sub></sub> zijn identiek.
- De exacte naleving van het monstervolume van 10 ml is bepalend voor de nauwkeurigheid van het analyseresultaat.

**Beknopte naam conform de norm ISO 639-1**

**Herziene versie**


NL Handboek van Methoden 01/20

**Uitvoering van de meting****Uitvoering van de bepaling Zuurcapaciteit  $K_{S4.3}$  met tablet**

De methode in het apparaat selecteren.

Voor deze methode moet bij de volgende apparaten geen nulmeting worden uitgevoerd:  
XD 7000, XD 7500Spoelbakje van 24 mm  
met 10 ml staal vullen.

De spoelbakjes afsluiten.

Het staalspoelbakje in de  
meetschacht plaatsen. Op  
de positionering letten.Tabletten oplossen door om  
te draaien Het staalspoelbakje in de  
meetschacht plaatsen. Op  
de positionering letten.De display toont het resultaat als Zuurcapaciteit  $K_{S4.3}$ .**Test**De toets TEST (XD: START)  
indrukken.



Alkaliteit-m T

M30

5 - 200 mg/L CaCO<sub>3</sub>

tA

Zuur / Indicator

NL

## Reagentia

Benodigd materiaal (deels optioneel):

Reagentia	Verpakkingseenheid	Bestelnr.
Alka-M-fotometer	Tablet / 100	513210BT
Alka-M-fotometer	Tablet / 250	513211BT

## Aantekeningen


1. De termen alkaliteit-m, m-waarde, totale alkaliteit en zuurcapaciteit<sub>KS4.3</sub> zijn identiek.
2. De exacte naleving van het monstervolume van 10 ml is bepalend voor de nauwkeurigheid van het analyseresultaat.

## Uitvoering van de bepaling Alkaliteit, totaal= alkaliteit-m= m-waarde met tablet


De methode in het apparaat selecteren.




Spoelbakje van 24 mm met **10 mL staal** vullen.




De spoelbakjes afsluiten.




Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.




De toets **NUL** indrukken.




Het spoelbakje uit de meetschacht nemen.




Een **ALKA-M-FOTOMETER** tablet toevoegen.



De tabletten onder lichte rotatie verpletteren.




De spoelbakjes afsluiten.



NL

Tabletten oplossen door om te draaien




Het staalspoelbakje in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.

## Test

De toets **TEST** (XD: **START**) indrukken.

De display toont het resultaat als Alkaliteit-m.



## Evaluatie

De volgende tabel geeft aan dat de uitvoerwaarden kunnen worden geconverteerd naar andere citatievormen.

Eenheid	Dagvaardingsformulier	Omrekeningsfactor
mg/l	CaCO <sub>3</sub>	1
°dH		0.056
°eH		0.07
°fH		0.1
°aH		0.058
K <sub>S4,3</sub>		0.02

NL

## Chemische methode

Zuur / Indicator

## Aanhangsel

### Afgeleid van

EN ISO 9963-1

**Chloor T****M100****0.01 - 6.0 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL6****DPD**

NL

**Reagentia**

Benodigd materiaal (deels optioneel):

<b>Reagentia</b>	<b>Verpakkingseenheid</b>	<b>Bestelnr.</b>
DPD Nr.1	Tablet / 100	511050BT
DPD Nr. 1	Tablet / 250	511051BT
DPD Nr. 1	Tablet / 500	511052BT
DPD Nr. 3	Tablet / 100	511080BT
DPD Nr. 3	Tablet / 250	511081BT
DPD Nr. 3	Tablet / 500	511082BT
DPD Nr. 1 hoog calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 100	515740BT
DPD Nr. 1 hoog calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 250	515741BT
DPD Nr. 1 hoog calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 500	515742BT
DPD Nr. 3 hoog calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 100	515730BT
DPD Nr. 3 hoog calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 250	515731BT
DPD Nr. 3 hoog calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 500	515732BT
DPD Nr. 4	Tablet / 100	511220BT
DPD Nr. 4	Tablet / 250	511221BT
DPD Nr. 4	Tablet / 500	511222BT
DPD No. 3 Evo	Tablet / 100	511420BT
DPD No. 3 Evo	Tablet / 250	511421BT
DPD No. 3 Evo	Tablet / 500	511422BT
DPD Nr.4 Evo	Tablet / 100	511970BT
DPD Nr. 4 Evo	Tablet / 250	511971BT
DPD Nr. 4 Evo	Tablet / 500	511972BT

**Beschikbare standaarden**

<b>Omschrijving</b>	<b>Verpakkingseenheid</b>	<b>Bestelnr.</b>
ValidCheck Chloor 1,5 mg/l	1 St.	48105510



## Bemonstering

1. Tijdens de monstervoorbereiding moet worden vermeden dat het chloor wordt uitgestoten, bijvoorbeeld door pipetteren en schudden.
2. De analyse moet onmiddellijk na de bemonstering worden uitgevoerd.

## Voorbereiding

1. Het schoonmaken van de spoelbakjes:  
Aangezien veel huishoudelijke reinigingsmiddelen (bijv. afwasmiddelen) minder schadelijke stoffen bevatten, kan de bepaling van chloor leiden tot minder goede resultaten. Om deze meetfout uit te sluiten, moeten de glasapparaten chloorvrij zijn. Hiertoe wordt het glaswerk gedurende één uur onder natriumhypochlorietoplossing (0,1 g/L) bewaard en vervolgens grondig gespoeld met gedeioniseerd water.
2. Voor de individuele bepaling van vrij chloor en totaal chloor is het zinvol om een aparte set spoelbakjes te gebruiken (zie EN ISO 7393-2, paragraaf 5.3).
3. De DPD-kleurontwikkeling vindt plaats bij een pH-waarde van 6,2 tot 6,5. De reagentia bevatten daarom een buffer voor de aanpassing van de pH-waarde. Sterk alkalisch of zuur water moet echter vóór de analyse in een pH-gebied tussen 6 en 7 (met 0,5 mol/L-zwavelzuur of 1 mol/L-natriumhydroxideoplossing) worden geplaatst.

NL

## Aantekeningen

1. Evo-tabletten kunnen worden gebruikt als alternatief voor de overeenkomstige standaardtabletten (bv. DPD nr. 3 Evo in plaats van DPD nr. 3).




## Uitvoering van de bepaling vrij chloor met tablet

De methode in het apparaat selecteren.


NL




Spoelbakje van 24 mm met **10 mL staal** vullen.




De spoelbakjes afsluiten.




Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.




De toets **NUL** indrukken.




Het spoelbakje uit de meetschacht nemen.



Het spoelbakje tot op enkele druppels ledigen.





**Een DPD Nr. 1 tablet** toevoegen.




De tabletten onder lichte rotatie verpletteren.




Het spoelbakje tot aan de **markering van 10 mL** met het **staal** vullen.



De spoelbakjes afsluiten.



Tabletten oplossen door om te draaien



Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.

NL

## Test

De toets **TEST** (XD:  
**START**) indrukken.


De display toont het resultaat in mg/L vrij chloor.

### Uitvoering van de bepaling totaal chloor met tablet


De methode in het apparaat selecteren.



Spoelbakje van 24 mm met **10 mL staal** vullen.



De spoelbakjes afsluiten.



Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.




# Zero

NL


De toets **NUL** indrukken.

Het spoelbakje uit de  
meetschacht nemen.


Het spoelbakje tot op enkele  
druppels ledigen.



Een DPD Nr. 1 tablet  
toevoegen.




Een DPD Nr. 3 tablet  
toevoegen.




Als alternatief voor DPD  
nr. 1 en nr. 3 tabletten kan  
1 DPD nr. 4 tablet worden  
toegevoegd.





De tabletten onder lichte  
rotatie verpletteren.




Het spoelbakje tot aan de  
**markering van 10 mL** met  
het **staal** vullen.



De spoelbakjes afsluiten.




Tabletten oplossen door om te draaien



Het **staalspoelbakje** in de  
meetschacht plaatsen. Op  
de positionering letter.

## Test

De toets **TEST** (XD: **START**)  
indrukken.



De reactietijd van  
**2 minuten** wachten.

Na afloop van de reactietijd wordt de meting automatisch uitgevoerd.

De display toont het resultaat in mg/L Totaal chloor.



## Chemische methode

DPD

## Aanhangsel

NL

### Verstoringen

#### Permanente verstoringen

- Alle oxidatiemiddelen in de monsters reageren als chloor, wat tot extra resultaten leidt.

#### Uit te sluiten verstoringen

- Storingen veroorzaakt door koper en ijzer(III) worden door EDTA geëlimineerd.
- Bij monsters met een hoog calciumgehalte\* en/of een hoge geleidbaarheid\* kan het gebruik van reagenstabletten leiden tot vertroebeling van het monster en de daarmee samenhangende onjuiste meting. In dit geval zijn de reagenstabletten DPD-nr. 1 High Calcium en het reagenstablet DPD-nr. 3 High Calcium te gebruiken.  
\*exacte waarden kunnen niet worden gegeven omdat de troebelheidsvorming afhankelijk is van de aard en samenstelling van het monsterwater.
- Concentraties van meer dan 10 mg/L chloor, bij gebruik van tabletten, kunnen leiden tot resultaten binnen het meetbereik tot 0 mg/L. Als de chloorconcentratie te hoog is, moet het monster worden verduld met chloorvrij water. Voeg reagens toe aan 10 mL van het verdunde monster en herhaal de meting (plausibiliteitstest).

Verstoringen	verstoort vanaf
CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	0.01
MnO <sub>2</sub>	0.01

### Validatie van de methodes

Aantoonbaarheidsgrens	0.02 mg/L
Bepaalbaarheidsgrens	0.06 mg/L
Einde meetbereik	6 mg/L
Gevoeligheid	2.05 mg/L / Abs
Betrouwbaarheidsgrenzen	0.04 mg/L
Standaardafwijking procedure	0.019 mg/L
Variatiecoefficient procedure	0.87 %

### Conform

EN ISO 7393-2



<sup>a)</sup> bepaling van de vrije, gebonden, totaal mogelijke | <sup>b)</sup> hulpreagens, alternatief voor DPD-nr. 1 / nr. 3 in geval van troebelheid van het monster als gevolg van een hoog calciumionengehalte en/of een hoge geleidbaarheid

NL

**Chloor L****M101****0.02 - 4.0 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL6****DPD**

NL

**Reagentia**

Benodigd materiaal (deels optioneel):

<b>Reagentia</b>	<b>Verpakkingseenheid</b>	<b>Bestelnr.</b>
DPD 1 bufferoplossing, blauw flesje	15 mL	471010
DPD 1-bufferoplossing	100 mL	471011
DPD 1 bufferoplossing in verpakking van 6 stuks	1 St.	471016
DPD 1 reagensoplossing, groen flesje	15 mL	471020
DPD 1-reagensoplossing	100 mL	471021
DPD 1 reagensoplossing in verpakking van 6 stuks	1 St.	471026
DPD 3 oplossing, rood flesje	15 mL	471030
DPD 3 oplossing	100 mL	471031
DPD 3 oplossing in verpakking van 6 stuks	1 St.	471036
DPD reagentia set	1 St.	471056

**Beschikbare standaarden**

<b>Omschrijving</b>	<b>Verpakkingseenheid</b>	<b>Bestelnr.</b>
ValidCheck Chloor 1,5 mg/l	1 St.	48105510

**Bemonstering**

1. Tijdens de monstervoorbereiding moet worden vermeden dat het chloor wordt uitgestoten, bijvoorbeeld door pipetteren en schudden.
2. De analyse moet onmiddellijk na de bemonstering worden uitgevoerd.



## Voorbereiding

1. Het schoonmaken van de spoelbakjes:  
Aangezien veel huishoudelijke reinigingsmiddelen (bijv. afwasmiddelen) minder schadelijke stoffen bevatten, kan de bepaling van chloor leiden tot minder goede resultaten. Om deze meetfout uit te sluiten, moeten de glasapparaten chloorvrij zijn. Hiertoe wordt het glaswerk gedurende één uur onder natriumhypochlorietoplossing (0,1 g/L) bewaard en vervolgens grondig gespoeld met gedeioniseerd water.
2. Voor de individuele bepaling van vrij chloor en totaal chloor is het zinvol om een aparte set spoelbakjes te gebruiken (zie EN ISO 7393-2, paragraaf 5.3).
3. De DPD-kleurontwikkeling vindt plaats bij een pH-waarde van 6,2 tot 6,5. De reagentia bevatten daarom een buffer voor de aanpassing van de pH-waarde. Sterk alkalisch of zuur water moet echter vóór de analyse in een pH-gebied tussen 6 en 7 (met 0,5 mol/l-zwavelzuur of 1 mol/l-natriumhydroxideoplossing) worden geplaatst.

## Aantekeningen

1. Na gebruik moeten de druppelflacons onmiddellijk worden gesloten met de schroefdop van dezelfde kleur.
2. Bewaar het reagens ingesteld op +6 °C tot +10 °C op een koele plaats.




## Uitvoering van de bepaling vrij chloor met vloeibaar reagens

De methode in het apparaat selecteren.


NL




Spoelbakje van 24 mm met **10 mL staal** vullen.




De spoelbakjes afsluiten.




Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.




De toets **NUL** indrukken.




Het spoelbakje uit de meetschacht nemen.




Het spoelbakje ledigen.




De druppelflessen verticaal houden en even grote druppels toevoegen door langzaam te drukken.




**6 druppels DPD**  
1 bufferoplossing in het staalspoelbakje doen.




**2 druppels DPD**  
1 reagensoplossing in het staalspoelbakje doen.




Het spoelbakje tot aan de **markering van 10 mL** met het **staal** vullen.




De spoelbakjes afsluiten.



De inhoud mengen door om te draaien.



Het **staalspoelbakje** in de meet schacht plaatsen. Op de positionering letten.



De toets **TEST** (XD: **START**) indrukken.


De display toont het resultaat in mg/L vrij chloor.

### Uitvoering van de bepaling totaal chloor met vloeibaar reagens


De methode in het apparaat selecteren.



Spoelbakje van 24 mm met **10 mL staal** vullen.



De spoelbakjes afsluiten.



Het **staalspoelbakje** in de meet schacht plaatsen. Op de positionering letten.



# Zero

NL

De toets **NUL** indrukken.

Het spoelbakje uit de  
meetschacht nemen.

Het spoelbakje ledigen.



De druppelflessen verticaal houden en even grote druppels toevoegen door langzaam te drukken.



**6**  
6 druppels DPD  
1 bufferoplossing in het staalspoelbakje doen.



**2**  
2 druppels DPD  
1 reagensoplossing in het staalspoelbakje doen.





**3**  
3 druppels DPD  
3 oplossing in het staalspoelbakje doen.




**3**  
Het spoelbakje tot aan de **markering van 10 mL** met het **staal** vullen.




De spoelbakjes afsluiten.




De inhoud mengen door om te draaien.



Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letteren.



De toets **TEST** (XD: **START**) indrukken.



De reactietijd van  
**2 minuten** afwachten.

Na afloop van de reactietijd wordt de meting automatisch uitgevoerd.

De display toont het resultaat in mg/L Totaal chloor.



## Chemische methode

DPD

## Aanhangsel

NL

### Verstoringen

#### Permanente verstoringen

- Alle oxidatiemiddelen in de monsters reageren als chloor, wat tot extra resultaten leidt.

#### Uit te sluiten verstoringen

- Storingen veroorzaakt door koper en ijzer(III) worden door EDTA geëlimineerd.
- Concentraties van meer dan 4 mg/L chloor, bij gebruik van vloeibare reagentia, kunnen leiden tot resultaten binnen het meetbereik tot 0 mg/L. In dit geval moet het monster worden verduld met chloorvrij water. Voeg reagens toe aan 10 ml van het verdunde monster en herhaal de meting (plaatselijkheidstest).

Verstoringen	verstoort vanaf
CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	0,01
MnO <sub>2</sub>	0,01

### Conform

EN ISO 7393-2

<sup>a)</sup> bepaling van de vrije, gebonden, totaal mogelijke



**Chloor HR T****M103****0.1 - 10 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL10****DPD**

NL


## **Reagentia**

Benodigd materiaal (deels optioneel):

<b>Reagentia</b>	<b>Verpakkingseenheid</b>	<b>Bestelnr.</b>
DPD Nr. 1 HR	Tablet / 100	511500BT
DPD Nr. 1 HR	Tablet / 250	511501BT
DPD Nr. 1 HR	Tablet / 500	511502BT
DPD Nr.3 HR Evo	Tablet / 100	511920BT
DPD Nr. 3 HR Evo	Tablet / 250	511921BT
DPD Nr. 3 HR Evo	Tablet / 500	511922BT
DPD Nr. 3 HR	Tablet / 100	511590BT
DPD Nr. 3 HR	Tablet / 250	511591BT
DPD Nr. 3 HR	Tablet / 500	511592BT
Set DPD nr. 1 HR/nr. 3 HR #	per 100	517791BT
Set DPD nr. 1 HR/nr. 3 HR #	per 250	517792BT
DPD Nr. 1 hoog calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 100	515740BT
DPD Nr. 1 hoog calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 250	515741BT
DPD Nr. 1 hoog calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 500	515742BT
DPD Nr. 3 hoog calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 100	515730BT
DPD Nr. 3 hoog calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 250	515731BT
DPD Nr. 3 hoog calcium <sup>e)</sup>	Tablet / 500	515732BT

## **Bemonstering**

1. Tijdens de monstervoorbereiding moet worden vermeden dat het chloor wordt uitgestoten, bijvoorbeeld door pipetteren en schudden.
2. De analyse moet onmiddellijk na de bemonstering worden uitgevoerd.



## Voorbereiding

1. Het schoonmaken van de spoelbakjes:  
Aangezien veel huishoudelijke reinigingsmiddelen (bijv. afwasmiddelen) minder schadelijke stoffen bevatten, kan de bepaling van chloor leiden tot minder goede resultaten. Om deze meetfout uit te sluiten, moeten de glasapparaten chloorvrij zijn. Hiertoe wordt het glaswerk gedurende één uur onder natriumhypochlorietoplossing (0,1 g/L) bewaard en vervolgens grondig gespoeld met gedeïoniseerd water.
2. Voor de individuele bepaling van vrij chloor en totaal chloor is het zinvol om een aparte set spoelbakjes te gebruiken (zie EN ISO 7393-2, paragraaf 5.3).
3. De DPD-kleurontwikkeling vindt plaats bij een pH-waarde van 6,2 tot 6,5. De reagentia bevatten daarom een buffer voor de aanpassing van de pH-waarde. Sterk alkalisch of zuur water moet echter vóór de analyse in een pH-gebied tussen 6 en 7 (met 0,5 mol/L-zwavelzuur of 1 mol/L-natriumhydroxideoplossing) worden geplaatst.

## Aantekeningen

1. Evo-tabletten kunnen worden gebruikt als alternatief voor de overeenkomstige standaardtabletten (bv. DPD nr. 3 Evo in plaats van DPD nr. 3).



## Uitvoering van de bepaling vrij chloor HR met tablet

De methode in het apparaat selecteren.

**10 mL**



Spoelbakje van 24 mm met **10 mL staal** vullen.




De spoelbakjes afsluiten.



Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.

**Zero**




De toets **NUL** indrukken.

Het spoelbakje uit de meetschacht nemen.




Het spoelbakje tot op enkele druppels ledigen.





Een DPD Nr. 1 HR tablet toevoegen.




De tabletten onder lichte rotatie verpletteren.




Het spoelbakje tot aan de **markering van 10 mL** met het **staal** vullen.




De spoelbakjes afsluiten.



Tabletten oplossen door om te draaien



Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.



De toets **TEST** (XD:  
**START**) indrukken.


De display toont het resultaat in mg/L vrij chloor.

## Uitvoering van de bepaling totaal chloor HR met tablet


De methode in het apparaat selecteren.




Spoelbakje van 24 mm met **10 mL staal** vullen.



De spoelbakjes afsluiten.




Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.



# Zero

NL


De toets **NUL** indrukken.




Het spoelbakje uit de  
meetschacht nemen.



Het spoelbakje tot op enkele  
druppels ledigen.



Een DPD Nr. 1 HR tablet  
toevoegen.




Een DPD Nr. 3 HR tablet  
toevoegen.




De tabletten onder lichte  
rotatie verpletteren.





Het spoelbakje tot aan de  
**markering van 10 mL** met  
het **staal** vullen.




De spoelbakjes afsluiten.



Tabletten oplossen door om  
te draaien



## Test



Het **staalspoelbakje** in de  
meetschacht plaatsen. Op  
de positionering letten.

De toets **TEST** (XD:  
**START**) indrukken.

De reactietijd van  
**2 minuten** afwachten.

Na afloop van de reactietijd wordt de meting automatisch uitgevoerd.

De display toont het resultaat in mg/L Totaal chloor.

NL



## Chemische methode

DPD

## Aanhangsel

NL

### Verstoringen

#### Permanente verstoringen

- Alle oxidatiemiddelen in de monsters reageren als chloor, wat tot extra resultaten leidt.

#### Uit te sluiten verstoringen

- Storingen veroorzaakt door koper en ijzer(III) worden door EDTA geëlimineerd.
- Als de reagenstabletten worden gebruikt voor monsters met een hoog calciumgehalte\* en/of een hoge geleidbaarheid\*, kan het monster troebel worden en kan de meting onjuist zijn. In dit geval is het DPD-nummer een alternatief. 1 High Calcium en het reagenstablet DPD-nr. 3 High Calcium te gebruiken.  
\*exacte waarden kunnen niet worden gegeven omdat de troebelheidsvorming afhankelijk is van de aard en samenstelling van het monsterwater.

### Conform

EN ISO 7393-2

\* bepaling van de vrije, gebonden, totaal mogelijke | ° hulpreagens, alternatief voor DPD-nr. 1 / nr. 3 in geval van troebelheid van het monster als gevolg van een hoog calciumionengehalte en/of een hoge geleidbaarheid | " met inbegrip van de mengstaaf



**Koper T****M150****0.05 - 5 mg/L Cu<sup>a)</sup>****Cu****Biquinoline**

NL

## Reagentia

Benodigd materiaal (deels optioneel):

Reagentia	Verpakkingseenheid	Bestelnr.
Koper Nr. 1	Tablet / 100	513550BT
Koper Nr. 1	Tablet / 250	513551BT
Koper Nr. 2	Tablet / 100	513560BT
Koper Nr. 2	Tablet / 250	513561BT
Set koper nr. 1/Nr. 2 <sup>#</sup>	per 100	517691BT
Set koper nr. 1/Nr. 2 <sup>#</sup>	per 250	517692BT

## Voorbereiding

1. Sterk alkalisch of zuur water moet vóór de analyse op een pH-waarde van 4 tot 6 worden ingesteld.


## Uitvoering van de bepaling Koper, vrij met tablet

De methode in het apparaat selecteren.


Selecteer bovendien de bepaling: vrij




Spoelbakje van 24 mm met **10 mL staal** vullen.




De spoelbakjes afsluiten.




Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.




De toets **NUL** indrukken.




Het spoelbakje uit de meetschacht nemen.



Een **COPPER Nr. 1** tablet toevoegen.




De tabletten onder lichte rotatie verpletteren.




De spoelbakjes afsluiten.

NL



NL


Tabletten oplossen door om te draaien



Het staalspoelbakje in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.

## Test

De toets TEST (XD: START) indrukken.



De reactietijd van  
2 minuten afwachten.

Na afloop van de reactietijd wordt de meting automatisch uitgevoerd.

De display toont het resultaat in mg/L vrij koper.


### Uitvoering van de bepaling Koper, totaal met tablet

De methode in het apparaat selecteren.


Selecteer bovendien de bepaling: totaal




Spoelbakje van 24 mm met  
**10 mL staal** vullen.



De spoelbakjes afsluiten.




Het staalspoelbakje in de  
meetschacht plaatsen. Op de  
positionering letten.



# Zero

De toets **NUL** indrukken.


Het spoelbakje uit de  
meetschacht nemen.



Een COPPER Nr. 1 tablet  
toevoegen.




De tabletten onder lichte  
rotatie verpletteren en  
oplossen.




Een COPPER Nr. 2 tablet  
toevoegen.






De tabletten onder lichte  
rotatie verpletteren.



De spoelbakjes afsluiten.



Tabletten oplossen door om  
te draaien



NL

Het **staalspoelbakje** in de  
meetschacht plaatsen. Op  
de positionering letten.

De toets **TEST** (XD:  
**START**) indrukken.

De reactietijd van  
**2 minuten** afwachten.

Na afloop van de reactietijd wordt de meting automatisch uitgevoerd.

De display toont het resultaat in mg/L totaal koper.



## Chemische methode

Biquinoline

## Aanhangsel

## Verstoringen

NL

### Permanente verstoringen

1. Cyanide CN<sup>-</sup> en Zilver Ag<sup>+</sup> beïnvloeden de bepaling.

## Validatie van de methodes

Aantoonbaarheidsgrens	0.05 mg/L
Bepaalbaarheidsgrens	0.15 mg/L
Einde meetbereik	5 mg/L
Gevoeligheid	3.8 mg/L / Abs
Betrouwbaarheidsgrenzen	0.026 mg/L
Standaardafwijking procedure	0.011 mg/L
Variatiecoefficient procedure	0.42 %

## Literatuurverwijzing

Photometrische Analyse, Lange/Vedjelek, Verlag Chemie 1980

<sup>a)</sup> bepaling van de vrije, gebonden, totaal mogelijke | # met inbegrip van de mengstaaf

**CyA T****M160****10 - 160 mg/L CyA****CyA****Melamine**

NL

**Reagentia**

Benodigd materiaal (deels optioneel):




Reagentia	Verpakkingseenheid	Bestelnr.
CyA-test	Tablet / 100	511370BT
CyA-test	Tablet / 250	511371BT
VE-water	100 mL	461275
VE-water	250 mL	457022

**Aantekeningen**




1. Cyanuurzuur veroorzaakt een zeer fijn verdeelde troebelheid met een melkachtig uiterlijk. Individuele deeltjes zijn niet te wijten aan de aanwezigheid van cyanuurzuur.

## Uitvoering van de bepaling Cyanozuurtest met tablet

De methode in het apparaat selecteren.






Spoelbakje van 24 mm met **5 mL gedeioniseerd water** vullen. **5 mL staal** aan het spoelbakje toevoegen.



Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering lettert.

De toets **NUL** indrukken.

Het spoelbakje uit de meetschacht nemen.




**Een CyA-test tablet** toevoegen.

De tabletten onder lichte rotatie verpletteren.

De spoelbakjes afsluiten.

NL



# Test

NL

De inhoud mengen door om te draaien (gedurende minstens 60 s tot de tablet volledig is opgelost).

De display toont het resultaat in mg/L Cyanuurzuur.

Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.

De toets **TEST** (XD: **START**) indrukken.



## Chemische methode

Melamine

## Verstoringen

### Permanente verstoringen

1. Onopgeloste deeltjes kunnen tot meerdere resultaten leiden. Daarom is het belangrijk om de tabletten volledig op te lossen.

NL

**IJzer T****M220****0.02 - 1 mg/L Fe****FE****Ferrozine / Thioglycolaat**

NL

## Reagentia

Benodigd materiaal (deels optioneel):

Reagentia	Verpakkingseenheid	Bestelnr.
IJzer II LR ( $\text{Fe}^{2+}$ )	Tablet / 100	515420BT
IJzer II LR ( $\text{Fe}^{2+}$ )	Tablet / 250	515421BT
IJzer LR ( $\text{Fe}^{2+}$ und $\text{Fe}^{3+}$ )	Tablet / 100	515370BT
IJzer LR ( $\text{Fe}^{2+}$ und $\text{Fe}^{3+}$ )	Tablet / 250	515371BT


## Voorbereiding

- Water dat is behandeld met organische verbindingen als corrosiebescherming e.d. moet mogelijk worden geoxideerd worden om de ijzercomplexen te vernietigen. Hiertoe wordt een monster van 100 ml gemengd met 1 ml geconcentreerd zwavelzuur ( $\geq 95\%$ ) en 1 ml geconcentreerd salpeterzuur ( $\geq 65\%$ ) en op de helft ingedamt. Na afkoeling wordt de vertering uitgevoerd.


## Aantekeningen

- Deze methode bepaalt het totaal opgeloste  $\text{Fe}^{2+}$  en  $\text{Fe}^{3+}$ .
- Voor de bepaling van  $\text{Fe}^{2+}$  wordt het IRON (II) LR-tablet gebruikt in plaats van het IRON LR-tablet.


## Ontsluiting




Een geschikte staalbeker met **100 mL staal** vullen.




**1 mL geconcentreerd zwavelzuur ( $\geq 95\%$ ) toevoegen.**




Het staal gedurende **10 minuten verwarmen**, of zolang tot alles volledig is opgelost.



Het staal laten afkoelen tot **kamertemperatuur**.



De **pH-waarde** van het staal met **Ammoniakoplossing (10-25 %)** afstellen op 3-5.



Het staal met **gedeïoniseerd water tot 100 mL** vullen.

Dit staal gebruiken voor de analyse van totaal opgelost en niet-opgelost ijzer.

### Uitvoering van de bepaling IJzer (II,III), opgelost met tablet

De methode in het apparaat selecteren.

Voor de bepaling van **opgelost en niet-opgelost ijzer** de beschreven **ontsluiting** uitvoeren.



NL

**10 mL**



NL

Spoelbakje van 24 mm met  
**10 mL** staal vullen.


De spoelbakjes afsluiten.

**Sample**Het **staalspoelbakje** in de  
meetschacht plaatsen. Op  
de positionering letten.**Zero**De toets **NUL** indrukken.Het spoelbakje uit de  
meetschacht nemen.**Een IRON LR tablet**  
toevoegen.De tabletten onder lichte  
rotatie verpletteren.

De spoelbakjes afsluiten.




Tabletten oplossen door om te draaien



Het **staalspoelbakje** in de  
meetschacht plaatsen. Op  
de positionering letteren.

## Test

De toets **TEST** (XD: **START**)  
indrukken.



De reactietijd van  
**5 minuten** afwachten.

Na afloop van de reactietijd wordt de meting automatisch uitgevoerd.

De display toont het resultaat in mg/L IJzer.



## Chemische methode

Ferrozine / Thioglycolaat

## Aanhangsel

NL

### Verstoringen

#### Uit te sluiten verstoringen

1. De aanwezigheid van koper verhoogt het meetresultaat met 10 %. Bij een concentratie van 10 mg/L koper in het monster wordt het resultaat verhoogd met 1 mg/L ijzer.  
De verstoring kan worden geëlimineerd door toevoeging van thioureum

### Validatie van de methodes

Aantoonbaarheidsgrens	0.01 mg/L
Bepaalbaarheidsgrens	0.016 mg/L
Einde meetbereik	1 mg/L
Gevoelighed	0.92 mg/L / Abs
Betrouwbaarheidsgrenzen	0.013 mg/L
Standaardafwijking procedure	0.005 mg/L
Variatiecoefficient procedure	1.23 %

#### Literatuurverwijzing

Photometrische Analyse, Lange/ Vjedelek, Verlag Chemie 1980, S. 102



**pH-waarde T****M330****6.5 - 8.4 pH****PH****Fenolrood**

NL

**Reagentia**

Benodigd materiaal (deels optioneel):

Reagentia	Verpakkingseenheid	Bestelnr.
Fenolrood fotometer	Tablet / 100	511770BT
Fenolrood fotometer	Tablet / 250	511771BT
Fenolrood fotometer	Tablet / 500	511772BT

**Aantekeningen**


1. Voor de fotometrische pH-bepaling mogen alleen PHENOL RED-tabletten met een zwarte foliedruk en de term PHOTOMETER worden gebruikt.

## Uitvoering van de bepaling pH-waarde met tablet


De methode in het apparaat selecteren.




Spoelbakje van 24 mm met **10 mL staal** vullen.




De spoelbakjes afsluiten.




Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.




De toets **NUL** indrukken.




Het spoelbakje uit de meetschacht nemen.



Een **FENOLROOD FOTOMETER** tablet toevoegen.




De tabletten onder lichte rotatie verpletteren.



De spoelbakjes afsluiten.

NL



NL

Tabletten oplossen door om te draaien




Het **staalspoelbakje** in de  
meetschacht plaatsen. Op  
de positionering letten.

## Test

De toets **TEST** (XD: **START**)  
indrukken.

De display toont het resultaat als pH-waarde.



## Chemische methode

Fenolrood

## Aanhangsel

## Verstoringen

NL

### Permanente verstoringen

- Watermonsters met een lage carbonaathardheid\* kunnen leiden tot onjuiste pH-waarden.  
\*  $K_{S4,3} < 0,7 \text{ mmol/l} \Leftrightarrow \text{Totale alkaliteit} < 35 \text{ mg/L CaCO}_3$ .

### Uit te sluiten verstoringen

- pH-waarden onder 6,5 en boven 8,4 kunnen leiden tot resultaten binnen het meetbereik. Een plausibiliteitstest (pH-meter) wordt aanbevolen.
- Zoutgebrek:  
Voor zoutgehalten tot 2 g/L kan geen significante zoutfout worden verwacht als gevolg van het zoutgehalte van het reagenstablet. Indien het zoutgehalte hoger is, worden de gemeten waarden als volgt gecorrigeerd:

zoutgehalte van het monster (in g/L)	30	60	120	180
Correctie	-0,15 <sup>1)</sup>	-0,21 <sup>2)</sup>	-0,26 <sup>2)</sup>	-0,29 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> na Kolthoff (1922)

<sup>2)</sup> na Parson en Douglas (1926)

### Literatuurverwijzing

Colorimetric Chemical Analytical Methods, 9th Edition, London

**pH-waarde L****M331****6.5 - 8.4 pH****PH****Fenolrood**

NL

## **Reagentia**

Benodigd materiaal (deels optioneel):

<b>Reagentia</b>	<b>Verpakkingseenheid</b>	<b>Bestelnr.</b>
Fenolrood oplossing	15 mL	471040
Fenolrood oplossing	100 mL	471041
Fenolrood oplossing in verpakking van 6 stuks	1 St.	471046

## **Voorbereiding**

- Door de verschillende druppelgroottes kan het meetresultaat grotere afwijkingen vertonen dan bij gebruik van tabletten.  
Bij gebruik van een pipet (0,18 ml komt overeen met 6 druppels) kan deze afwijking worden geminimaliseerd.

## **Aantekeningen**


- Na gebruik moet de druppelfles meteen onmiddellijk worden gesloten met de schroefdop van dezelfde kleur.
- Bewaar het reagens bij +6 °C tot +10 °C op een koele plaats.

## Uitvoering van de bepaling pH-waarde met vloeibaar reagens


De methode in het apparaat selecteren.




Spoelbakje van 24 mm met **10 mL staal** vullen.




De spoelbakjes afsluiten.




Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.




De toets **NUL** indrukken.




Het spoelbakje uit de meetschacht nemen.



De druppelflessen verticaal houden en even grote druppels toevoegen door langzaam te drukken.




**6 druppels FENOLROOD-oplossing** in het staalspoelbakje doen.



**6**

De spoelbakjes afsluiten.



NL

De inhoud mengen door om te draaien.




Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.

## Test

De toets **TEST** (XD: **START**) indrukken.

De display toont het resultaat als pH-waarde.



## Chemische methode

Fenolrood

## Aanhangsel

## Verstoringen

NL

### Uit te sluiten verstoringen

1. Zoutgebrek: correctie van de gemeten waarde (gemiddelde waarden) voor monsters met een zoutgehalte van:

Zoutgehalte van het monster	Correctie
30 g/L (zeewater)	-0,15 <sup>1)</sup>
60 g/L	-0,21 <sup>2)</sup>
120 g/L	-0,26 <sup>2)</sup>
180 g/L	-0,29 <sup>2)</sup>
2. <sup>1)</sup> na Kolthoff (1922) <sup>2)</sup> na Parson en Douglas (1926)
3. Bij het testen van gechloreerd water kan het aanwezige chloorgehalte de kleurreactie van het vloeibare reagens beïnvloeden. Dit wordt voorkomen door een klein kristal natriumthiosulfaat ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{ H}_2\text{O}$ ) aan de monsteroplossing toe te voegen voordat de PHENOL RED-oplossing wordt toegevoegd.

### Literatuurverwijzing

Colorimetric Chemical Analytical Methods, 9th Edition, London

KS4.3 T / 20

方法名称

方法号

用于方法检测的条形码

测量范围  
 $K_{S4.3} T$   
0.1 - 4 mmol/l  $K_{S4.3}$

酸性 /指示剂

20  
S:4.3

屏幕显示: MD 100 /  
MD 110 / MD 200

化学方法 儀器的具體信息

測試可以在以下設備上執行。此外還指出了所需的比色皿和光度計的吸收範圍。

仪器类型	比色皿	$\lambda$	测量范围
MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	$\varnothing 24\text{ mm}$	610 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	$\varnothing 24\text{ mm}$	615 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$

材料

所需材料 (部分可選) :

标题	包装单位	货号
Alka-M-Photometer	片剂 / 100	513210BT
Alka-M-Photometer	片剂 / 250	513211BT

应用列表

- 污水处理
- 饮用水处理
- 原水处理

备注

1. 术语碱度-m、m-值、总碱度和酸容量  $K_{S4.3}$  是相同的。
2. 准确地遵守 10 ml 的样本体积对分析结果的准确度至关重要。

语言代码ISO 639-1

修订状态

CN 方法手册 01/20

KS4.3 T / 20

开始测量

进行测定  $K_{S4.3}$  片剂酸容量

选择设备中的方法。


对于这种方法，在以下设备上不能进行 ZERO 测量：XD 7000, XD 7500




用 10 ml 样本填充 24 mm 比 密封比色杯。  
色杯。



将样本比色杯放入测量轴  
中。注意定位。



加入 ALKA-M-PHOTOMET-  
TER 片剂。



密封比色杯。

CN 方法手册 01/20



T 碱度-m

M30

5 - 200 mg/L CaCO<sub>3</sub>

tA

酸性 /指示剂

## 材料


所需材料 (部分可選) :

ZH

试剂	包装单位	货号
碱度 M 光度计	片剂 / 100	513210BT
碱度 M 光度计	片剂 / 250	513211BT

## 备注

- 术语碱度-m、m-值、总碱度和酸容量 K<sub>S4.3</sub> 是相同的。
- 准确地遵守 10 ml 的样本体积对分析结果的准确度至关重要。





## 进行测定 总碱度 = 碱度 M = 片剂的 m-值


选择设备中的方法。




用 10 mL 样本填充 24 mm 密封比色杯。  
比色杯。




将样本比色杯放入测量轴  
中。注意定位。




按下 ZERO 按钮。




从测量轴上取下比色杯。



加入 ALKA-M-  
PHOTOMETER 片剂。




用轻微的扭转压碎片剂。




密封比色杯。




ZH



通过旋转溶解片剂。



将样本比色杯放入测量轴  
中。注意定位。



按下 TEST (XD: START) 按  
钮。

结果在显示屏上显示为 碱度-m。



## 分析

下表中输出数据也可转换为其他格式表示.

单位	参考表格	因素
mg/l	CaCO <sub>3</sub>	1
	°dH	0.056
	°eH	0.07
	°fH	0.1
	°aH	0.058
	K <sub>S4.3</sub>	0.02

## 化学方法

酸性 /指示剂

## 附錄

源于

EN ISO 9963-1



T 氯

M100

0.01 - 6.0 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>

CL6

DPD

材料

所需材料（部分可選）：

ZH

试剂	包装单位	货号
DPD No.1	片剂 / 100	511050BT
DPD No.1	片剂 / 250	511051BT
DPD No.1	片剂 / 500	511052BT
DPD No.3	片剂 / 100	511080BT
DPD No.3	片剂 / 250	511081BT
DPD No.3	片剂 / 500	511082BT
DPD No.1 高钙 <sup>b)</sup>	片剂 / 100	515740BT
DPD No.1 高钙 <sup>b)</sup>	片剂 / 250	515741BT
DPD No.1 高钙 <sup>b)</sup>	片剂 / 500	515742BT
DPD No.3 高钙 <sup>b)</sup>	片剂 / 100	515730BT
DPD No.3 高钙 <sup>b)</sup>	片剂 / 250	515731BT
DPD No.3 高钙 <sup>b)</sup>	片剂 / 500	515732BT
DPD No.4	片剂 / 100	511220BT
DPD No.4	片剂 / 250	511221BT
DPD No.4	片剂 / 500	511222BT
DPD No.3 Evo	片剂 / 100	511420BT
DPD No.3 Evo	片剂 / 250	511421BT
DPD No.3 Evo	片剂 / 500	511422BT
DPD No.4 Evo	片剂 / 100	511970BT
DPD No.4 Evo	片剂 / 250	511971BT
DPD No.4 Evo	片剂 / 500	511972BT

## 現有標準

标题	包装单位	货号
ValidCheck 氯 1.5 mg/l	1 片	48105510



## 取样

1. 在样本制备中，通过移液和摇动来避免氯的排气。
2. 取样后必须立即进行分析。

## 准备

1. 清洗比色杯：  
由于许多家用清洁剂（例如洗碗用洗涤剂）含有还原剂，所以测定的氯结果可能会不足。为了排除这种测量误差，玻璃器皿应无氯。为此，将玻璃器皿在次氯酸钠溶液（0.1 g/L）下存放1小时，然后用去离子水（软化水）彻底冲洗。
2. 对于游离氯和总氯的单独测定，使用一套相应单独的比色杯是有意义的（参见 EN ISO 7393-2，第 5.3 段）。
3. DPD 显色发生在 pH 值在 6.2 至 6.5 时。因此该试剂含有用于调节 pH 值的缓冲液。但在分析前（用 0.5 mol/L 硫酸或 1 mol/L 氢氧化钠溶液）必须将强碱性或酸性水的 pH 范围调节到 6 和 7 之间。

## 备注

1. Evo片剂可以作为相应标准片剂的替代品（如DPD No.3 Evo代替DPD No.3）。




## 进行测定 余氯 片剂法

选择设备中的方法。


ZH




用 **10 mL** 样本填充 24 mm 比色杯。




密封比色杯。




将样本比色杯放入测量轴中。  
注意定位。




按下 **ZERO** 按钮。




从测量轴上取下比色杯。



将比色杯倒空。




加入 **DPD No. 1** 片剂。




用轻微的扭转压碎片剂。





用样本将比色杯填充至  
**10 mL** 刻度处。



密封比色杯。



通过旋转溶解片剂。

将样本比色杯放入测量轴中。  
注意定位。

按下 TEST (XD: START) 按钮。


结果在显示屏上显示为 mg / l 余氯。

**进行测定 总氯 片剂法**

选择设备中的方法。

用 10 mL 样本填充 24 mm 密封比色杯。  
比色杯。

密封比色杯。

将样本比色杯放入测量轴中。  
注意定位。




# Zero

ZH

按下 ZERO 按钮。

从测量轴上取下比色杯。


将比色杯倒空。



加入 DPD No. 1 片剂。




加入 DPD No. 3 片剂。



作为DPD 1号和3号片剂的替代品，可以添加1个DPD 4号片剂。




用轻微的扭转压碎片剂。




用样本将比色杯填充至  
10 mL 刻度处。



密封比色杯。





通过旋转溶解片剂。



将样本比色杯放入测量轴中。注意定位。

# Test

按下 TEST (XD: START) 按钮。



等待 2 分钟反应时间。

反应时间结束后，自动进行测量。

结果在显示屏上显示为 mg / l 总氯。

ZH



## 化学方法

DPD

## 附錄

ZH

### 干扰说明

#### 持续干扰

- 存在于样本中的所有氧化剂都像氯一样反应，导致多重结果。

#### 可消除干扰

- 铜和铁(III)的干扰必须通过EDTA消除。
- 对于高钙含量<sup>a)</sup>和/或高电导率<sup>b)</sup>的样本，使用试剂片可能会导致样本浑浊和相关的测量误差。在这种情况下，可选用试剂片DPD编号1高钙和试剂片DPD编号3高钙。  
\*不能给出精确值，因为浑浊的形成取决于样本水的类型和组成。
- 在使用片剂时，高于10 mg/L氯的浓度可导致测量范围内的结果高达0 mg/L。氯浓度过高时应用无氯水稀释样本。将10 mL稀释的样本与试剂混合并重复测量(可信度测试)。

干擾	從/ [mg/l]
CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	0.01
MnO <sub>2</sub>	0.01

### 方法验证


检出限	0.02 mg/L
测定下限	0.06 mg/L
测量上限	6 mg/L
灵敏度	2.05 mg/L / Abs
置信范围	0.04 mg/L
标准偏差	0.019 mg/L
变异系数	0.87 %

#### 一致性

EN ISO 7393-2

<sup>a)</sup> 测定余氯，总氯和结合氯 | <sup>b)</sup> 替代试剂，取代DPD No.1/No.3试剂，用于由高浓度钙离子和/或高电导率引起的浑浊水样分析





L 氯

M101

0.02 - 4.0 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>

CL6

DPD

## 材料

所需材料（部分可選）：

ZH

试剂	包装单位	货号
DPD 1 缓冲溶液，蓝瓶	15 mL	471010
DPD 1 缓冲溶液	100 mL	471011
DPD 1 缓冲溶液，6 件装	1 片	471016
DPD 1 试剂溶液，绿瓶	15 mL	471020
DPD 1 试剂溶液	100 mL	471021
DPD 1 试剂溶液，6 件装	1 片	471026
DPD 3 溶液，红瓶	15 mL	471030
DPD 3 溶液	100 mL	471031
DPD 3 溶液，6 件装	1 片	471036
DPD 试剂套件	1 片	471056

## 現有標準


标题	包装单位	货号
ValidCheck 氯 1.5 mg/l	1 片	48105510

## 取样

- 在样本制备中，通过移液和摇动来避免氯的排气。
- 取样后必须立即进行分析。

## 准备

- 清洗比色杯：  
由于许多家用清洁剂（例如洗碗用洗涤剂）含有还原剂，所以测定的氯结果可能会不足。为了排除这种测量误差，玻璃器皿应无氯。为此，将玻璃器皿在次氯酸钠溶液（0.1 g/L）下存放1小时，然后用去离子水（软化水）彻底冲洗。
- 对于游离氯和总氯的单独测定，使用一套相应单独的比色杯是有意义的（参见 EN ISO 7393-2，第 5.3 段）。
- DPD 显色发生在 pH 值在 6.2 至 6.5 时。因此该试剂含有用于调节 pH 值的缓冲液。但在分析前（用 0.5 mol/l 硫酸或 1 mol/l 氢氧化钠溶液）必须将强碱性或酸性水的 pH 范围调节到 6 和 7 之间。



## 备注


1. 使用后滴瓶必须立即用相同颜色的瓶盖重新密封。
2. 将试剂盒冷藏在 +6 °C至 +10 °C。

ZH




## 进行测定 余氯 水剂法

选择设备中的方法。

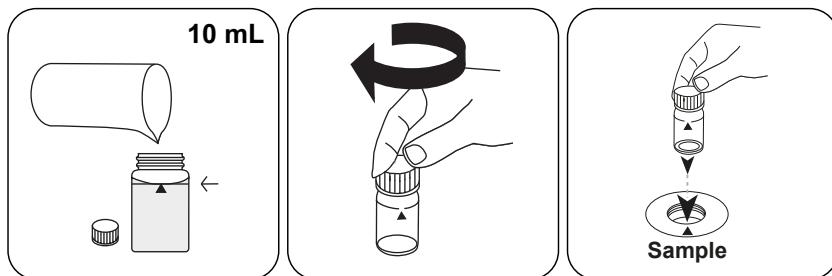

用 10 mL 样本填充 24 mm 密封比色杯。  
比色杯。


将样本比色杯放入测量轴中。  
注意定位。

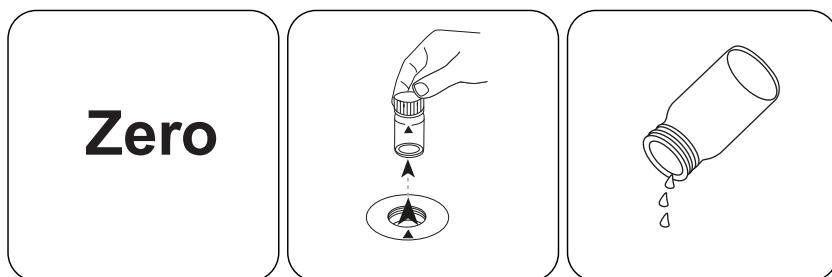

按下 ZERO 按钮。

从测量轴上取下比色杯。

倒空比色杯。

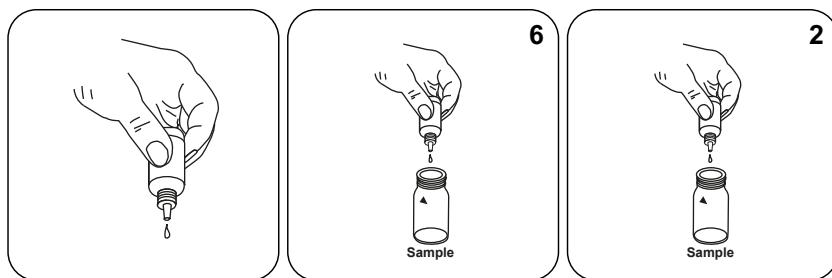


垂直握住滴瓶，慢慢加入相  
同大小的滴剂。

**6**  
将 6 滴 DPD 1 Buffer  
Solution 添加到样本比色杯  
中。


**2**  
将 2 滴 DPD 1 Reagent  
Solution 添加到样本比色杯  
中。




用样本将比色杯填充至  
10 mL 刻度处。




密封比色杯。



通过旋转混合内容物。



将样本比色杯放入测量轴  
中。注意定位。



按下 TEST (XD: START) 按  
钮。

结果在显示屏上显示为 mg / l 余氯。

## 进行测定 总氯 水剂法


选择设备中的方法。




用 10 mL 样本填充 24 mm  
比色杯。



密封比色杯。



将样本比色杯放入测量轴  
中。注意定位。



# Zero

ZH

按下 ZERO 按钮。

从测量轴上取下比色杯。

倒空比色杯。



垂直握住滴瓶，慢慢加入相  
同大小的滴剂。




**将 6 滴 DPD 1 Buffer  
Solution 添加到样本比色杯  
中。**




**将 2 滴 DPD 1 Reagent  
Solution 添加到样本比色杯  
中。**




**将 3 滴 DPD 3 Solution  
添加到样本比色杯中。**




用样本将比色杯填充至  
10 mL 刻度处。



密封比色杯。





通过旋转混合内容物。



将样本比色杯放入测量轴  
中。注意定位。

# Test

按下 TEST (XD: START) 按  
钮。



等待 2 分钟反应时间。

反应时间结束后，自动进行测量。

结果在显示屏上显示为 mg / l 总氯。

ZH



## 化学方法

DPD

## 附錄

ZH

### 干扰说明

#### 持续干扰

- 存在于样本中的所有氧化剂都像氯一样反应，导致多重结果。

#### 可消除干扰

- 铜和铁 ( III ) 的干扰必须通过 EDTA 消除。
- 在使用液剂时，高于 4 mg/L 氯的浓度可导致测量范围内的结果高达 0 mg/L。在这种情况下应用无氯水稀释样本。将 10 ml 稀释的样本与试剂混合并重复测量 ( 可信度测试 )。

干擾	從/ [mg/l]
CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	0,01
MnO <sub>2</sub>	0,01

#### 一致性

EN ISO 7393-2

<sup>a)</sup> 测定余氯，总氯和结合氯



**HR T 氯****M103****0.1 - 10 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>****CL10****DPD****材料**

所需材料（部分可選）：

ZH

试剂	包装单位	货号
DPD No.1 HR	片剂 / 100	511500BT
DPD No.1 HR	片剂 / 250	511501BT
DPD No.1 HR	片剂 / 500	511502BT
DPD No.3 HR Evo	片剂 / 100	511920BT
DPD No.3 HR Evo	片剂 / 250	511921BT
DPD No.3 HR Evo	片剂 / 500	511922BT
DPD No.3 HR	片剂 / 100	511590BT
DPD No.3 HR	片剂 / 250	511591BT
DPD No.3 HR	片剂 / 500	511592BT
套件 DPD No.1 HR/No.3 HR <sup>#</sup>	各100次	517791BT
套件 DPD No.1 HR/No.3 HR <sup>#</sup>	各250次	517792BT
DPD No.1 高钙 <sup>e)</sup>	片剂 / 100	515740BT
DPD No.1 高钙 <sup>e)</sup>	片剂 / 250	515741BT
DPD No.1 高钙 <sup>e)</sup>	片剂 / 500	515742BT
DPD No.3 高钙 <sup>e)</sup>	片剂 / 100	515730BT
DPD No.3 高钙 <sup>e)</sup>	片剂 / 250	515731BT
DPD No.3 高钙 <sup>e)</sup>	片剂 / 500	515732BT

**取样**

- 在样本制备中，通过移液和摇动来避免氯的排气。
- 取样后必须立即进行分析。



## 准备

1. 清洗比色杯：  
由于许多家用清洁剂（例如洗碗用洗涤剂）含有还原剂，所以测定的氯结果可能会不足。为了排除这种测量误差，玻璃器皿应无氯。为此，将玻璃器皿在次氯酸钠溶液（0.1 g/L）下存放1小时，然后用去离子水（软化水）彻底冲洗。
2. 对于游离氯和总氯的单独测定，使用一套相应单独的比色杯是有意义的（参见EN ISO 7393-2，第5.3段）。
3. DPD显色发生在pH值在6.2至6.5时。因此该试剂含有用于调节pH值的缓冲液。但在分析前（用0.5 mol/L硫酸或1 mol/L氢氧化钠溶液）必须将强碱性或酸性水的pH范围调节到6和7之间。

## 备注


1. Evo片剂可以作为相应标准片剂的替代品（如DPD No.3 Evo代替DPD No.3）。



## 进行测定 余氯 HR 片剂法

选择设备中的方法。

**10 mL**



用 **10 mL** 样本填充 24 mm 密封比色杯。  
比色杯。



将样本比色杯放入测量轴中。  
注意定位。

**Zero**



按下 **ZERO** 按钮。

从测量轴上取下比色杯。



将比色杯倒空。




加入 **DPD No. 1 HR** 片剂。




用轻微的扭转压碎片剂。




用样本将比色杯填充至  
**10 mL** 刻度处。




密封比色杯。



通过旋转溶解片剂。



将样本比色杯放入测量轴中。  
注意定位。



按下 TEST (XD: START) 按钮。


结果在显示屏上显示为 mg / l 余氯。

## 进行测定 总氯 HR 片剂法


选择设备中的方法。



用 10 mL 样本填充 24 mm 密封比色杯。  
比色杯。



密封比色杯。




将样本比色杯放入测量轴中。  
注意定位。



# Zero

ZH


按下 ZERO 按钮。




从测量轴上取下比色杯。



将比色杯倒空。



加入 DPD No. 1 HR 片剂。




加入 DPD No. 3 HR 片剂。




$\varnothing 24\text{ mm}$


用轻微的扭转压碎片剂。




用样本将比色杯填充至  
10 mL 刻度处。



密封比色杯。




通过旋转溶解片剂。



将样本比色杯放入测量轴  
中。注意定位。

# Test


按下 TEST (XD: START)  
按钮。



等待 2 分钟反应时间。

反应时间结束后，自动进行测量。

结果在显示屏上显示为 mg / l 总氯。



## 化学方法

DPD

## 附錄

### 干扰说明

ZH

#### 持续干扰

- 存在于样本中的所有氧化剂都像氯一样反应，导致多重结果。

#### 可消除干扰

- 铜和铁（III）的干扰必须通过 EDTA 消除。
- 对于高钙含量<sup>\*</sup>和/或高电导率<sup>\*</sup>的样本，使用试剂片可能会导致样本浑浊和相关的测量误差。在这种情况下，可选用试剂片 DPD 编号1 高钙和试剂片 DPD 编号3 高钙。  
<sup>\*</sup>不能给出精确值，因为浑浊的形成取决于样本水的类型和组成。

#### 一致性

EN ISO 7393-2

<sup>a)</sup> 测定余氯，总氯和结合氯 | <sup>b)</sup> 替代试剂，取代DPD No.1/No.3试剂，用于由高浓度钙离子和/或高电导率引起的浑浊水样分析 | <sup>c)</sup> 含搅拌棒，10cm



T 铜

M150

0.05 - 5 mg/L Cu<sup>a)</sup>

Cu

双喹啉

## 材料

所需材料 (部分可選) :

ZH

试剂	包装单位	货号
铜 No.1	片剂 / 100	513550BT
铜 No.1	片剂 / 250	513551BT
铜 No.2	片剂 / 100	513560BT
铜 No.2	片剂 / 250	513561BT
套件铜 No.1/No.2 <sup>#</sup>	各100次	517691BT
套件铜 No.1/No.2 <sup>#</sup>	各250次	517692BT

## 准备

- 在分析前应将强碱性或酸性水的 pH 从4到6 左右。




## 进行测定 余铜 片剂法

选择设备中的方法。


另外选择测定：余铜




用 10 mL 样本填充 24 mm 比色杯。




密封比色杯。




将样本比色杯放入测量轴中。注意定位。




按下 ZERO 按钮。




从测量轴上取下比色杯。




加入 COPPER No. 1 片剂



用轻微的扭转压碎片剂。




密封比色杯。



ZH


通过旋转溶解片剂。



将样本比色杯放入测量轴中。注意定位。

# Test

按下 TEST (XD: START) 按钮。



等待 2 分钟反应时间。

反应时间结束后，自动进行测量。

结果在显示屏上显示为 mg/l 余铜。


## 进行测定 总铜 片剂法

选择设备中的方法。


另外选择测定：总铜



用 10 mL 样本填充 24 mm 比色杯。



密封比色杯。





将样本比色杯放入测量轴中。  
注意定位。

**Zero**

按下 ZERO 按钮。



从测量轴上取下比色杯。

加入 COPPER No. 1 片剂。  
。


用轻微的扭转压碎片剂并溶解。




加入 COPPER No. 2 片剂。



用轻微的扭转压碎片剂。



密封比色杯。




通过旋转溶解片剂。



将样本比色杯放入测量轴中。注意定位。

**Test**

按下 TEST (XD: START) 按钮。



等待 2 分钟反应时间。

反应时间结束后，自动进行测量。

结果在显示屏上显示为 mg / l 总铜。



ZH



## 化学方法

双喹啉

## 附錄

### 干扰说明

ZH

#### 持续干扰

- 氰化物CN<sup>-</sup>和银Ag<sup>+</sup>会干扰测定。

### 方法验证

检出限	0.05 mg/L
测定下限	0.15 mg/L
测量上限	5 mg/L
灵敏度	3.8 mg/L / Abs
置信范围	0.026 mg/L
标准偏差	0.011 mg/L
变异系数	0.42 %

#### 参考文献

Photometrische Analyse, Lange/Vedjelek, Verlag Chemie 1980

<sup>a)</sup> 测定余氯，总氯和结合氯 | \* i含搅拌棒, 10cm



T 氰

M160

10 - 160 mg/L CyA

CyA

三聚氰胺

## 材料

所需材料（部分可選）：

ZH


试剂	包装单位	货号
CY A 测试	片剂 / 100	511370BT
CY A 测试	片剂 / 250	511371BT
软化水	100 mL	461275
软化水	250 mL	457022

## 备注


1. 氰尿酸引起非常细微的分散浑浊和乳白色的外观。单个颗粒不是由于氰尿酸的存在造成的。

## 进行测定 用片剂进行氰尿酸测试


选择设备中的方法。




用 5 mL 去离子水填充  
24 mm 比色杯中。




添加 5 mL 样本到比色杯  
中。




密封比色杯。




将样本比色杯放入测量轴  
中。注意定位。




按下 ZERO 按钮。




从测量轴上取下比色杯。



加入 CyA-Test 片剂。






用轻微的扭转压碎片剂。



密封比色杯。

ZH



ZH

通过旋转混合内容物 (至少 60 秒, 直到药片完全溶解)。中。注意定位。

将样本比色杯放入测量轴  
按下 TEST (XD: START) 按  
钮。

结果在显示屏上显示为 mg / l 三聚氰酸。



## 化学方法

三聚氰胺

## 干扰说明

### 持续干扰

- 未溶解的颗粒可能会导致结果过高。因此，完全溶解片剂很重要。

ZH



T 铁

M220

0.02 - 1 mg/L Fe

FE

Ferrozine/硫乙酸盐

## 材料

所需材料（部分可选）：

ZH

试剂	包装单位	货号
铁 II LR ( $\text{Fe}^{2+}$ )	片剂 / 100	515420BT
铁 II LR ( $\text{Fe}^{2+}$ )	片剂 / 250	515421BT
铁 LR ( $\text{Fe}^{2+}$ und $\text{Fe}^{3+}$ )	片剂 / 100	515370BT
铁 LR ( $\text{Fe}^{2+}$ und $\text{Fe}^{3+}$ )	片剂 / 250	515371BT


## 准备

- 在必要情况下，已用有机化合物作为腐蚀抑制剂处理的水须被氧化，从而破坏铁复合物。为此，将 100 ml 样本与 1 ml 浓硫酸和 1 ml 浓硝酸混合并蒸发至一半。冷却后进行消解。


## 备注

- 用这种方法测定总溶解的  $\text{Fe}^{2+}$  和  $\text{Fe}^{3+}$ 。
- 为了测定  $\text{Fe}^{2+}$ ，使用 IRON ( II ) LR 片剂代替 IRON LR 片剂。


## 消解




用 100 mL 样本填充合适的样本容器。




加入 1 mL 浓硫酸 ( $\geq 95\%$ )。




将样本加热 10 分钟，或一直加热直到其完全溶解。



将样本冷却到室温。



将样本的 pH 值从 氨溶液 (10-25 %) 调节到 3-5。



将样本用去离子水填充至 100 mL。

使用该样本来分析 总溶解铁。



### 进行测定 铁 (II,III) , 用片剂溶解

选择设备中的方法。

为了测定 溶解和未溶解铁，进行 中所述的消解。



用 10 mL 样本填充 24 mm 密封比色杯。



将样本比色杯放入测量轴中。注意定位。




# Zero

ZH

按下 ZERO 按钮。


从测量轴上取下比色杯。




加入 IRON LR 片剂。




用轻微的扭转压碎片剂。



密封比色杯。




通过旋转溶解片剂。



将样本比色杯放入测量轴中。注意定位。

# Test


按下 TEST (XD: START) 按钮。



等待 5 分钟反应时间。

反应时间结束后，自动进行测量。

结果在显示屏上显示为 mg / l 铁。



## 化学方法

Ferrozine/巯乙酸盐

## 附錄

### 干扰说明

ZH

#### 可消除干扰

- 铜的存在使测量结果增加了 10 %。样本中铜浓度为 10 mg/L 时，测量结果增加 1 mg/L 铁。  
干扰可以通过添加硫脲来消除

### 方法验证

检出限	0.01 mg/L
测定下限	0.016 mg/L
测量上限	1 mg/L
灵敏度	0.92 mg/L / Abs
置信范围	0.013 mg/L
标准偏差	0.005 mg/L
变异系数	1.23 %

#### 参考文献

Photometrische Analyse, Lange/ Vjedelek, Verlag Chemie 1980, S. 102



T pH 值

M330

6.5 - 8.4 pH

PH

苯酚红

## 材料


所需材料（部分可選）：

ZH

试剂	包装单位	货号
酚红光度计	片剂 / 100	511770BT
酚红光度计	片剂 / 250	511771BT
酚红光度计	片剂 / 500	511772BT

## 备注

- 对于光度 pH 值测定，只应使用标有 PHOTOMETER 的带有黑色烫印的 PHENOL RED 片剂。





## 进行测定 pH 值片剂


选择设备中的方法。




用 10 mL 样本填充 24 mm 密封比色杯。  
比色杯。




将样本比色杯放入测量轴  
中。注意定位。




按下 ZERO 按钮。




从测量轴上取下比色杯。



加入 PHENOL RED  
PHOTOMETER 片剂。




用轻微的扭转压碎片剂。




密封比色杯。




ZH



通过旋转溶解片剂。




将样本比色杯放入测量轴  
中。注意定位。



按下 TEST (XD: START) 按  
钮。

结果在显示屏上显示为 pH 值。



## 化学方法

苯酚红

## 附錄

### 干扰说明

ZH

#### 持续干扰

- 碳酸盐硬度\*低的水样可能会得出错误的 pH 值。  
 $K_{S4,3} < 0,7 \text{ mmol/l} \leq \text{总碱度} < 35 \text{ mg/L CaCO}_3.$

#### 可消除干扰

- pH 值低于 6.5 和高于 8.4 可导致测量范围内的结果。建议使用可信度测试 ( pH 计 )。
- 盐误差：  
对于盐含量高达 2 g/L，试剂片的盐含量不会引起明显的盐误差。对于较高的盐含量，测量值应进行如下校正：

样本的盐 含量以 g/ L 为单位	30 ( 海 水 )	60	120	180
校正	-0,15 <sup>1)</sup>	-0,21 <sup>2)</sup>	-0,26 <sup>2)</sup>	-0,29 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> 根据 Kolthoff (1922)

<sup>2)</sup> 根据 Parson 和 Douglas (1926)

#### 参考文献

Colorimetric Chemical Analytical Methods, 9th Edition, London



L pH 值

M331

6.5 - 8.4 pH

PH

苯酚红

## 材料

所需材料 (部分可選) :

ZH


试剂	包装单位	货号
酚红溶液	15 mL	471040
酚红溶液	100 mL	471041
酚红溶液 6 件装	1 片	471046

## 准备

- 由于液滴大小不同，测量结果可能会比使用片剂时有更大的偏差。  
使用移液管 (0.18 ml 相当于 6 滴) 时这种偏差可以最小化。

## 备注

- 使用后滴瓶必须立即用相同颜色的瓶盖重新密封。
- 将试剂冷藏在 +6 °C 至 +10 °C。





## 进行测定 pH 值液剂


选择设备中的方法。




用 10 mL 样本填充 24 mm 密封比色杯。  
比色杯。




将样本比色杯放入测量轴  
中。注意定位。




按下 ZERO 按钮。




从测量轴上取下比色杯。



垂直握住滴瓶，慢慢加入相  
同大小的滴剂。




将 6 滴 PHENOL Red-  
Lösung 添加到样本比色杯  
中。




密封比色杯。




ZH



通过旋转混合内容物。




将样本比色杯放入测量轴  
中。注意定位。



按下 TEST (XD: START) 按  
钮。

结果在显示屏上显示为 pH 值。



## 化学方法

苯酚红

## 附錄

### 干扰说明

ZH

#### 可消除干扰

1. 盐误差：通过盐含量校正样本的测量值（平均值）：

样本盐含量	校正
30 g/L (海水)	-0.15 <sup>1)</sup>
60 g/L	-0.21 <sup>2)</sup>
120 g/L	-0.26 <sup>2)</sup>
180 g/L	-0.29 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>根据 Kolthoff (1922)

<sup>2)</sup>根据 Parson 和 Douglas (1926)

3. 分析氯化水时存在的残余氯含量会影响液体试剂的显色反应。在添加 PHENOL RED 溶液之前，向样本溶液中加入一小块硫代硫酸钠晶体 ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$ ) 来防止这种情况。

#### 参考文献

Colorimetric Chemical Analytical Methods, 9th Edition, London









**Tintometer GmbH**  
Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germany

**The Tintometer Limited**  
Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
UK

**Tintometer China**  
9F, SOHO II C.  
No.9 GuanghuaLu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

**Tintometer South East Asia**  
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

**Tintometer Brazil**  
Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brazil

**Tintometer Inc.**  
6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
USA

**Tintometer India Pvt. Ltd.**  
Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

**Tintometer Spain**  
Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spain

Technical changes without notice  
Printed in Germany 08/24  
No.: 00386479  
Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of  
the Tintometer Group of Companies

